

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：浙江省科学器材进出口有限责任公司

地址：杭州市天目山路 97 号 邮编：310007

联系人：邬栋栋 联系电话：0571-87967099

授权代表：邬栋栋

联系电话：13857147440

地址：杭州市天目山路 97 号 邮编：310007

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：超低温冰箱采购

质疑项目的编号：0625-25217326 包号：/

采购人名称：浙江省疾病预防控制中心

采购文件获取日期：2025 年 5 月 23 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：海信容声（广东）冷柜有限公司在投标过程中可能存在虚假应标，其多投标产品多条参数不符合招标文件规定，特别是多条实质性参数存在负偏离的情况。

事实依据：

问题一、招标文件第四章第二部分第二款产品技术要求第一条（▲1、单台占地面积≤1.04 平米，适合多台摆放。）海信容声（广东）冷柜有限公司所投产品 HD-86L830 系列冰箱，

外形尺寸为 1140x980x1980mm（宽 x 深 x 高），占地面积为 1140x980=1.117 平方米，无法响应单台占地面积 ≤ 1.04 平方米的实质性指标，不符合招标参数要求。

若海信容声（广东）冷柜有限公司在标书中对该条参数响应的话，则是虚假应标，该行为严重影响采购公平公正，根据评分标准，应判定为负偏离，根据招标文件“未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的”，该投标文件将被视为无效，则海信容声（广东）冷柜有限公司的投标文件应被判定为无效招标文件。

具体证据如下：

A. 官网截图：

Hisense 海信生命科学冷链

HD-86L830 海信生命科学冷链 海信超低温冰箱


型号：HD-86L830
有效容积(升)：650
温度范围(℃)：-40℃~-86℃
净重(kg)(不含包装)：1140x980x1980
包装尺寸(mm)(长x宽x高)：1175x1044x2107
重量(kg)：370
门体数量：3

产品介绍 详细参数

应用领域：
超低温保存用于保存病毒、细胞样本、疫苗、生物组织及器官、特殊食品、药品、制剂、材料等，适用于科研领域、生物医疗、电子、化工及加工行业、医药冷链等。

温控系统：
微电脑智能控制，超大屏幕数字显示，箱内温度-40℃~-86℃范围内可调。

制冷系统：
双压缩机变频制冷技术，行业领先，制冷环保可靠。



应用领域：
广泛应用于医药用于保存病毒、细胞样本、疫苗、生物组织及疫苗、特殊食品、药品、试剂、材料等。适用于科研领域、生物医药、电子、化工及医疗卫生、军事工业等。

温度控制：
锂电池模拟测试，超大屏幕数字显示，箱内温度-40℃~+56℃范围内可调。

制冷系统：
采用自主研发制冷技术，行业领先，制冷环保可靠；
国际知名品牌压缩机和风机；
双制冷回路设计，提供稳定超低温环境；
独特真空隔热系统设计，实现高效隔热。



3

产品参数



产品型号	HD-86L830BP	HD-86L830	HD-86L630
电压范围(V)	187~242	187~242	187~242
储藏温度(℃)	-40~-86	-40~-86	-40~-86
宽x深x高(外形)(mm)	1145×980×1980	1145×980×1980	1015×900×1980
有效容积(L)	830	830	630
净重(Kg)	350	350	300
隔层数量	4	4	4
标本装载量	2英寸标准冻存盒600个 2ml标准冻存管60000份样本	2英寸标准冻存盒600个 2ml标准冻存管60000份样本	2英寸标准冻存盒400个 2ml标准冻存管40000份样本





产品型号	HD-86L588BP	HD-86L588BPS	HD-86L390A
电压范围(V)	187~242	187~242	187~242
储藏温度(℃)	-40~-86	-40~-86	-40~-86
宽x深x高(外形)(mm)	870×980×1980	870×980×1980	735×900×1980
有效容积(L)	578	578	390
净重(Kg)	300	300	265
层架(或筐器)数量	3	3	3
标本装载量	2英寸标准冻存盒400个 2ml标准冻存管40000份样本	2英寸标准冻存盒400个 2ml标准冻存管40000份样本	2英寸标准冻存盒240个 2ml标准冻存管24000份样本



实际销售联系海信容声(广东)冷柜有限公司

-86℃超低温冰箱

智能变频 宽幅运行 静音节能

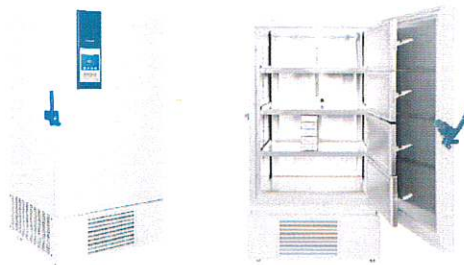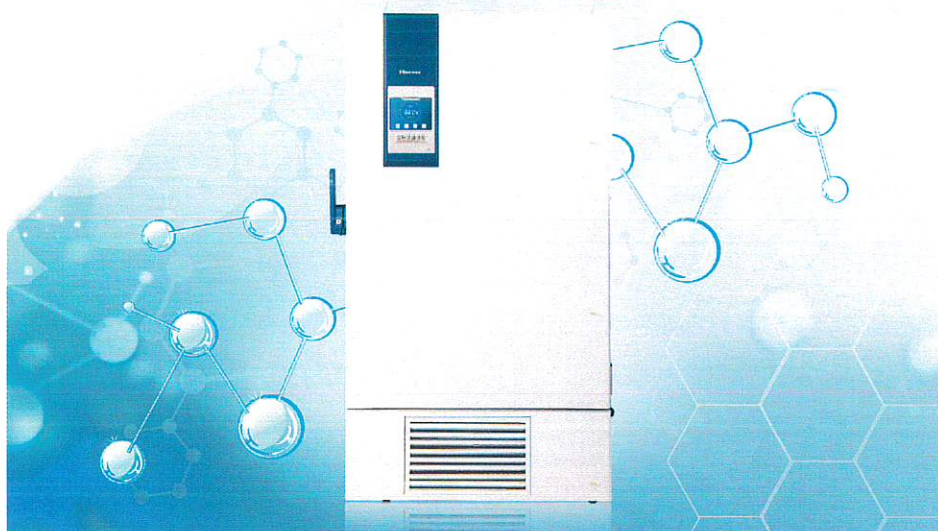

技术参数

型号	HD-8GL830BP	外形尺寸(mm)(宽x深x高)	1145 × 980 × 1980
容积 (L)	830	制冷方式	直冷
气候类型	N	显示精度 (℃)	0.1
储藏温度 (℃)	-40 ~ -86	外壳材质	喷涂镀锌钢板
输入功率 (W)	800	内胆材质	304不锈钢
电压范围 (V)	187~242	标本装载量	2英寸标准冻存盒600 2ml标准冻存管60000份样本
毛重 (Kg) /净重 (Kg)	375/350		

资质证书



海信集团·海信容声(广东)冷柜有限公司·青岛海信商用冷链股份有限公司
全国统一服务热线: 400-887-0003

·产品技术、规格及尺寸有改动,恕不另行通知,本公司保留资料内有关内容的最终解释权。

问题二、招标文件第四章第二部分第二款产品技术要求第二十四条（▲24、箱体采用“斜切设计”，机体前部具有斜切边，防止外门在门开/关时相互接触，可减少安装空间。）海信容声（广东）冷柜有限公司所投产品 HD-86L830 系列冰箱，采用外门微圆弧设计，完全不符合“斜切设计”，圆弧设计也无法满足“防止外门在门开/关时相互接触，可减少安装空间。”的使用功能需求。此条参数对斜切设计和斜切设计能达到的功能均做了明确定义，斜切设计通过优化外门形状，在冰箱开门时门铰链一侧不会碰到并排摆放的超低温冰箱，以达到缩小冰箱摆放间距，节省设备占用空间的效果。圆弧设计产品无法达到该效果。海信容声（广东）冷柜有限公司所投产品不符合招标参数要求。

若海信容声（广东）冷柜有限公司在标书中对该条参数响应的话，则是虚假应标，该行为严重影响采购公平公正，根据评分标准，应判定为负偏离，根据招标文件“未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的”，该投标文件将被视为无效，则海信容声（广东）冷柜有限公司的投标文件应被判定为无效招标文件。

具体证据如下：

实物图：





宣传图:



法律依据：《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，
《中华人民共和国政府采购法》

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：中标方产品存在实质性偏离，不排除虚假应标的可能性，我方恳请浙江省国际技术设备招标有限公司及浙江省疾病预防控制中心核实，严肃处理此类虚假应标，以次充好，损害其他投标方和业主的行为。希望能依法取消海信容声（广东）冷柜有限公司中标资格。



签字(签章): 邵林松.



日期: 2025.6.23.

2025.6.23

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：莱亿（杭州）生物科技有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 504 室杭州市信息安全产业园 245

邮编：311200

联系人：周著嗣

联系电话：18915941729

授权代表：周著嗣

联系电话：18915941729

地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 504 室杭州市信息安全产业园 245

邮编：311200

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：超低温冰箱采购

质疑项目的编号：0625-25217326 包号：1

采购人名称：浙江省疾病预防控制中心

采购文件获取日期：2024 年 6 月 25 日

三、质疑事项具体内容

根据贵方于2025年6月23日公布的中中标结果：

品牌：海信容声（广东）冷柜有限公司/佛山/海信

规格型号：HD-86L830A

我公司针对中标结果做出以下质疑事项：

质疑事项 1：参数 1 要求：“▲1、单台占地面积≤1.04 平米，适合多台摆放。”

事实依据：通过对青岛海信商用冷链股份有限公司及国家药品监督管理局的网站公开资料查阅，HD-86L830A 具有第二类医疗器械注册证；公开资料注明其占地宽为 1145mm，深为 980mm，由此可计算占地面积为 1145*980=1122100m

$m^2=1.1221\text{ m}^2>1.04\text{ 平方米}$ 。中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。

青 岛 海 信 商 用 冷 链 股 份 有 限 公 司 网 站 链 接 及 截 图：

<http://www.hisense-science.com/Products-37962937.html>



青 岛 海 信 商 用 冷 链 股 份 有 限 公 司 与 海 信 容 声 (广 东) 冷 柜 有 限 公 司 关 系 证 明

链 接 及 截 图：<https://coldchain-hisense.com/gywm.html>



海 信 容 声 (广 东) 冷 柜 有 限 公 司 HD-86L830A 境 内 医 疗 器 械 (注 册) 证 明 链

接 及 截 图：

<https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-info.html?nmpa=aWQ9YTU3YWY3>

OTUzODVhYmU1N2NhYzdmM2YyOWEzZmYzMmYmaXR1bUlkPWZmODh4MDgxODNjYWQ3NTAwM
TgzY2I2NmZlNjkwMjg1

国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

数据查询

首页

政府服务门户

国内医疗器械（注册）

“粤械注准20242221015” 基本信息

注册证编号	粤械注准20242221015
注册人名称	海康普康（广东）冷柜有限公司
注册人住所	佛山市顺德区容桂街道文丰北路46号
生产地址	佛山市顺德区容桂街道文丰北路46号
产品名称	医用低温冰箱
管理类别	第二类
型号规格	HD-86L630A、HD-86L830A、HD-86L4288P、HD-86L5888PS、HD-86L8388P、HD-86L8388PS、HD-86L8308P、HD-86L5888P、HD-86L390、HD-86L390A、HD-86L108、HD-40L3508P、HD-40L2908P、HD-40L100A、HD-30L5808P、HD-30L2908P、HD-25W520A、HD-25W310A、HD-25W203A、HD-25L278、HD-25L100
结构及组成/主要组成成分	由箱体、制冷系统、控制系统、数据记录系统及机械组成。 由箱体、制冷系统、控制系统及机械组成（仅型号HD-25L278）。
适用范围/预期用途	供医疗机构在低温环境下储存样本、药物、试剂用
产品储存条件及有效期	无
附件	产品技术要求
其他内容	1、 备注 本文件与“粤械注准20242221015”注册证共同使用。
审批部门	广东省药品监督管理局
批准日期	2024-07-31
生效日期	2024-07-31
有效期至	2029-07-30
变更情况	2024-11-11: 1. 型号、规格由“HD-86L630A、HD-86L830A、HD-86L4288P、HD-86L5888PS、HD-86L8388P”变更为“HD-86L630A、HD-86L830A、HD-86L830A、HD-86L4288P、HD-86L5888PS、HD-86L8388P、HD-86L8308P、HD-86L5888P、HD-86L390、HD-86L390A、HD-86L108、HD-40L3508P、HD-40L2908P、HD-40L100A、HD-30L5808P、HD-30L2908P、HD-25W520A、HD-25W310A、HD-25W203A、HD-25L278、HD-25L100”； 2. 结构及组成由“由箱体、制冷系统、控制系统、数据记录系统及机械组成。”变更为“由箱体、制冷系统、控制系统、数据记录系统及机械组成。由箱体、制冷系统、控制系统及机械组成（仅型号HD-25L278）。”； 3. 适用范围由“供医疗机构冷藏样本、药物、试剂用。”变更为“供医疗机构在低温环境下储存样本、药物、试剂用。”； 4. 注册证附件“产品技术要求”变更为附件附录A（共14页）。
备注	详细

法律依据： 1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

2、《医疗器械注册与备案管理办法》第五章变更注册与延续注册 第一节变更注册 第七十九条 注册人应当主动开展医疗器械上市后研究，对医疗器械的安全性、有效性和质量可控性进行进一步确认，加强对已上市医疗器械的持续管理。

已注册的第二类、第三类医疗器械产品，其设计、原材料、生产工艺、适用范围、使用方法等发生实质性变化，有可能影响该医疗器械安全、有效的，注册人应当向原注册部门申请办理变更注册手续；发生其他变化的，应当在变化之

日起 30 日内向原注册部门备案。

注册证载明的产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械的生产地址等，属于前款规定的需要办理变更注册的事项。注册人名称和住所、代理人名称和住所等，属于前款规定的需要备案的事项。境内医疗器械生产地址变更的，注册人应当在办理相应的生产许可变更后办理备案。发生其他变化的，注册人应当按照质量管理体系要求做好相关工作，并按照规定向药品监督管理部门报告。

质疑事项 2：参数 24 要求“▲24、箱体采用“斜切设计”，机体前部具有斜切边，防止外门在门开/关时相互接触，可减少安装空间。

事实依据：通过对青岛海信商用冷链股份有限公司网站及海信容声（广东）冷柜有限公司网站查看。HD-86L830A 从产品图片上均未体现“斜切设计”，且未出现针对“斜切设计”的描述。中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。

海信容声（广东）冷柜有限公司网站链接及截图：
<https://coldchain-hisense.com/cdw.html>



青岛海信商用冷链股份有限公司网站链接及截图：
<http://www.hisense-science.com/Products-37962937.html>



法律依据: 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 财库〔2020〕46号 第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 2、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)提供虚假材料谋取中标、成交的; (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的; (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的; (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的; (五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的; (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的,中标、成交无效。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：标书中明确注明“▲”系指实质性要求条款，且未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的投标文件将被视为无效。

1. 对海信容声（广东）冷柜有限公司投标文件按照无效文件处理，
2. 剩余投标商满足大于等于三家要求，重新进行评标工作。

质疑单位：莱亿（杭州）生物科技有限公司

日期：2025 年 6 月 25 日



关于浙江省疾病预防控制中心超低温冰箱采购项目

采购结果质疑的答复

浙江省科学器材进出口有限责任公司：

贵公司就浙江省疾病预防控制中心超低温冰箱采购项目（项目编号：0625-25217326）采购结果递交的质疑函已于2025年6月24日收悉。针对贵公司提出的质疑内容，我公司要求海信容声（广东）冷柜有限公司作出书面说明并提供相关证据；并于2025年7月1日组织原评标委员会进行复核，根据复核意见，答复如下：

问题一：招标文件第四章第二部分第二款产品技术要求第一条（▲1、单台占地面积 ≤ 1.04 平方米，适合多台摆放。）海信容声（广东）冷柜有限公司所投产品HD-86L830系列冰箱，外形尺寸为1140x980x1980mm（宽x深x高），占地面积为1140x980=1.117平方米，无法响应单台占地面积 ≤ 1.04 平方米的实质性指标，不符合招标参数要求。

若海信容声（广东）冷柜有限公司在标书中对该条参数响应的话，则是虚假应标，该行为严重影响采购公平公正，根据评分标准，应判定为负偏离，根据招标文件“未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的”，该投标文件将被视为无效，则海信容声（广东）冷柜有限公司的投标文件应被判定为无效招标文件。（具体内容详见质疑函）

答复：经评标委员会复核，根据海信容声（广东）冷柜有限公司投标文件中提供的产品外形尺寸（mm）（宽×深×高）为1145×980×1980，计算单台占地面积=1145mm×980mm=1.1221平方米。

不符合招标文件“第四章 招标内容及需求”“二、产品技术要求”中“▲1、单台占地面积 ≤ 1.04 平方米，适合多台摆放。”的要求，评标委员会一致认为海信容声（广东）冷柜有限公司未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的，投标文件无效。质疑事项成立。

问题二：招标文件第四章第二部分第二款产品技术要求第二十四条（▲24、箱体采用“斜切设计”，机体前部具有斜切边，防止外门在门开/关时相互接触，可

减少安装空间。)海信容声(广东)冷柜有限公司所投产品 HD-861830 系列冰箱, 采用外门微圆弧设计, 完全不符合“斜切设计”, 圆弧设计也无法满足“防止外门在门开/关时相互接触, 可减少安装空间。”的使用功能需求。此条参数对斜切设计和斜切设计能达到的功能均做了明确定义, 斜切设计通过优化外门形状, 在冰箱开门时门铰链一侧不会碰到并排摆放的超低温冰箱, 以达到缩小冰箱摆放间距, 节省设备占用空间的效果。圆弧设计产品无法达到该效果。海信容声(广东)冷柜有限公司所投产品不符合招标参数要求。

若海信容声(广东)冷柜有限公司在标书中对该条参数响应的话, 则是虚假应标, 该行为严重影响采购公平公正, 根据评分标准, 应判定为负偏离, 根据招标文件“未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的”, 该投标文件将被视为无效, 则海信容声(广东)冷柜有限公司的投标文件应被判定为无效招标文件。(具体内容详见质疑函)

答复: 海信容声(广东)冷柜有限公司投标文件中承诺“产品体采用斜切设计机体前部具有斜切边, 防止外门在门开/关时相互接触, 可减少安装空间”, 评标委员会一致维持原评审意见, 认为满足招标文件“第四章 招标内容及需求”“二、产品技术要求”中第 24 条的要求。质疑事项不成立。

根据评标委员会对质疑内容的复核, 部分质疑事项成立。

特此函复。

如你公司对本答复不满意, 可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人提起投诉。

联系人: 于迪迪

联系方式: 0571-87115301



浙江省疾病预防控制中心
浙江省国际技术设备招标有限公司
2025 年 7 月 2 日

关于浙江省疾病预防控制中心超低温冰箱采购项目

采购结果质疑的答复

莱亿（杭州）生物科技有限公司：

贵公司就浙江省疾病预防控制中心超低温冰箱采购项目（项目编号：0625-25217326）采购结果递交的质疑函已于 2025 年 6 月 27 日收悉。针对贵公司提出的质疑内容，我公司要求海信容声（广东）冷柜有限公司作出书面说明并提供相关证据；并于 2025 年 7 月 1 日组织原评标委员会进行复核，根据复核意见，答复如下：

质疑事项1：参数1 要求：“▲1、单台占地面积 ≤ 1.04 平米，适合多台摆放。”

通过对青岛海信商用冷链股份有限公司及国家药品监督管理局的网站公开资料查阅，HD-86L830A 具有第二类医疗器械注册证；公开资料注明其占地宽为 1145mm，深为980mm，由此可计算占地面积为 $1145 \times 980 = 1122100\text{mm}^2 = 1.1221\text{m}^2 > 1.04$ 平方米。中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。（具体内容详见质疑函）

答复：经评标委员会复核，根据海信容声（广东）冷柜有限公司投标文件中提供的产品外形尺寸(mm)(宽 $\times$ 深 $\times$ 高)为 $1145 \times 980 \times 1980$ ，计算单台占地面积 $= 1145\text{mm} \times 980\text{mm} = 1.1221$ 平方米。

不符合招标文件“第四章 招标内容及需求”“二、产品技术要求”中“▲1、单台占地面积 ≤ 1.04 平米，适合多台摆放。”的要求，评标委员会一致认为海信容声（广东）冷柜有限公司未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的，投标文件无效。质疑事项成立。

质疑事项 2：参数 24 要求“▲24、箱体采用“斜切设计”，机体前部具有斜切边，防止外门在门开/关时相互接触，可减少安装空间。

通过对青岛海信商用冷链股份有限公司网站及海信容声（广东）冷柜有限公司网站查看。HD-86L830A 从产品图片上均未体现“斜切设计”，且未出现针对“斜切设计”的描述。中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。（具体内容详见质疑函）

答复：海信容声（广东）冷柜有限公司投标文件中承诺“产品体采用斜切设计

机体前部具有斜切边，防止外门在门开/关时相互接触，可减少安装空间”，评标委员会一致维持原评审意见，认为满足招标文件“第四章 招标内容及需求”“二、产品技术要求”中第 24 条的要求。质疑事项不成立。

根据评标委员会对质疑内容的复核，部分质疑事项成立。

特此函复。

如你公司对本答复不满意，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人提起投诉。

联系人：于迪迪

联系方式：0571-87115301



浙江省疾病预防控制中心
浙江省国际技术设备招标有限公司

2025 年 7 月 2 日

