

# 一、广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2020-G1-001403-JDZB

采购计划编号: 广西政采[2020]7635 号-001

采购单位(甲方): 广西中医药大学

乙方(乙方): 上海琼弘生物科技有限公司

项目名称和编号: 2020 年一流学科建设科研设备采购项目 GXZC2020-G1-001403-JDZB

签订地点: 南宁市

签订时间: 2020 年 6 月 24 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称       | 制造商或服务商    | 规格型号             | 单位及数量 | 单价     | 金额     |
|----|------------|------------|------------------|-------|--------|--------|
| 1  | 氮气发生器      | 英国毕克       | Genius XE 35     | 1 台   | 160000 | 160000 |
| 2  | 氮气发生器      | 上海析维       | bio 系列           | 1 台   | 57000  | 57000  |
| 3  | 冷冻切片机      | 德国徕卡       | CM1520           | 1 台   | 280000 | 280000 |
| 4  | 生物安全柜      | 苏州安泰       | BSC-1000IIA2     | 2 台   | 25000  | 50000  |
| 5  | 智能全自动鞋套机   | 第梵缇        | LM-100C          | 4 台   | 400    | 1600   |
| 6  | 超微粉碎机      | 雷迈机械       | ZD-6L            | 1 台   | 13000  | 13000  |
| 7  | 全自动小型中药制丸机 | 长沙卓成       | LYSW-18          | 1 台   | 28000  | 28000  |
| 8  | 植物精油提取器    | 国产         | 定制               | 2 台   | 2000   | 4000   |
| 9  | 数码相机       | 佳能         | Canon EOS 70D 套机 | 1 台   | 8000   | 8000   |
| 10 | 彩色打印机      | 爱普生        | L3118            | 1 台   | 1200   | 1200   |
| 11 | 实验床        | 深圳 My Side | MRC001           | 2 张   | 500    | 1000   |
| 12 | 三气培养箱      | 德国 BINDER  | CB60             | 1 台   | 120000 | 120000 |
| 13 | 研究级体式显微镜   | 德国徕卡       | M125C            | 1 台   | 220000 | 220000 |
| 14 | 低温冷却液循环泵   | 郑州长城       | DLSB-10          | 1 台   | 5200   | 5200   |

|    |               |                  |                  |       |        |         |
|----|---------------|------------------|------------------|-------|--------|---------|
| 15 | 全电动倒置荧光光切成像系统 | 蔡司 ZEISS         | Axio Observer 7  | 1 套   | 955000 | 955000  |
| 16 | 荧光定量基因扩增仪     | 德国 AnalytikJena  | qTOWER 3G        | 1 台   | 280000 | 280000  |
| 17 | 体视显微镜         | 蔡司 ZEISS         | Stemi 305        | 1 台   | 15000  | 15000   |
| 18 | 二级生物安全柜       | 苏净安泰             | BSC-1304 II A2   | 1 台   | 30000  | 30000   |
| 19 | 多功能台式离心机      | 美国贝克曼            | Allegra X-30     | 1 台   | 120000 | 120000  |
| 20 | 小型旋转蒸发仪       | EYELA            | N-1300V-WB       | 2 套   | 18500  | 37000   |
| 21 | 隔膜真空泵         | 德国普兰德            | MZ 2C NT + AK+EK | 2 台   | 27000  | 54000   |
| 22 | 真空控制器         | 大连爱科             | VC4000           | 2 台   | 4000   | 8000    |
| 23 | 低温冷却循环泵       | 郑州长城             | DLSB-10/20       | 1 台   | 12000  | 12000   |
| 24 | 干式潜水服         | 英国 fouth element | Argonaut V2.0    | 1 套   | 22000  | 22000   |
| 25 | 水下推进器         | 意大利 Suex         | Xjoy             | 1 台   | 37000  | 37000   |
| 26 | 磁力搅拌油浴槽       | 日本东京理化（上海）       | PLS-1820         | 1 台   | 71500  | 71500   |
| 27 | 多功能酶标仪        | 美国 PerkinElmer   | Victor Nivo      | 1 台   | 310000 | 310000  |
| 28 | 倒置荧光显微镜       | 德国 Leica         | DMI8             | 1 台   | 397000 | 397000  |
| 29 | 其它用具 I（定制）    | 广西定制             | 定制               | 728 位 | 2690   | 1958320 |
| 30 | 其它用具 II（定制）   | 广西定制             | 定制               | 46 位  | 1750   | 80500   |
| 31 | 其它用具 III（定制）  | 广西定制             | 定制               | 2 张   | 2100   | 4200    |
| 32 | 其它用具 IV（定制）   | 广西定制             | 定制               | 2 组   | 1100   | 2200    |
| 33 | 其它用具 V（定制）    | 广西定制             | 定制               | 2 张   | 900    | 1800    |

|    |                                           |            |                             |       |        |        |
|----|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------|--------|
| 34 | 其它用具VI<br>(定制)                            | 广西定制       | 定制                          | 776 张 | 170    | 131920 |
| 35 | 大鼠 IVC 笼具                                 | 苏州冯氏       | IR30 笼一拖二                   | 4 个   | 90000  | 360000 |
| 36 | 不锈钢豚鼠<br>笼架                               | 苏州君圣       | 冲洗式                         | 4 架   | 10000  | 40000  |
| 37 | 不锈钢移动式<br>踏台                              | 苏州冯氏       | TT-50                       | 5 台   | 2400   | 12000  |
| 38 | 二氧化碳安乐<br>死自动仪                            | 苏州冯氏       | FSZZ-2A                     | 2 台   | 20000  | 40000  |
| 39 | 过氧化氢空间<br>消毒灭菌器                           | 杭州美卓       | MZ-V200                     | 1 台   | 400000 | 400000 |
| 40 | 大鼠代谢笼                                     | 苏州冯氏       | DXL-D                       | 30 个  | 3000   | 90000  |
| 41 | 小鼠代谢笼                                     | 苏州冯氏       | DXL-XS                      | 30 个  | 2000   | 60000  |
| 42 | 饮水瓶灌装机                                    | 苏州君圣       | S-GZJ-2                     | 1 台   | 50000  | 50000  |
| 43 | 大动物脑<br>定位仪                               | 上海软隆       | BW-SGA905                   | 1 台   | 20000  | 20000  |
| 44 | 干衣机                                       | 广东天骏       | TJ-HL01A                    | 3 台   | 10000  | 30000  |
| 45 | 洗衣机                                       | 松下         | XQG100-SD139                | 3 台   | 10000  | 30000  |
| 46 | 光触媒空气消<br>毒除氨机                            | 日本 ADNES   | bm-s801c                    | 2 台   | 109000 | 218000 |
| 47 | 小动物连续葡<br>萄糖记录系统                          | Pinnacle   | 8100                        | 1 台   | 90000  | 90000  |
| 48 | 微波消解仪                                     | 奥地利安东帕     | Multiwave 5000              | 1 台   | 350000 | 350000 |
| 49 | 紫外分光光度<br>仪                               | 日本岛津       | UV2600                      | 2 台   | 160000 | 320000 |
| 50 | 超声波细胞粉<br>碎机                              | 宁波新芝       | JY92-IIN                    | 1 台   | 22000  | 22000  |
| 51 | 垂直流超净工<br>作台                              | 上海 ESCO    | ACB-4E1-CN                  | 1 台   | 60000  | 60000  |
| 52 | 恒温水浴锅                                     | 常州天瑞       | HH-2                        | 2 台   | 1000   | 2000   |
| 53 | 湿式转印槽                                     | 美国 BIO-RAD | Griterion blotter           | 1 台   | 35000  | 35000  |
| 54 | 通用电泳仪 (通<br>用电源)                          | 美国 BIO-RAD | PowerPac Universal          | 3 台   | 40000  | 120000 |
| 55 | 奥林巴斯显微<br>镜用 5G WiFi<br>(11ac) 数字共<br>览相机 | 上海奥林巴斯     | MC1210-W, 1200 万<br>像素 (定制) | 2 台   | 23000  | 46000  |

|    |               |                 |                         |     |        |        |
|----|---------------|-----------------|-------------------------|-----|--------|--------|
| 56 | 细胞离心涂片机       | 美国 ThermoFisher | Cytospin 4              | 1 台 | 260000 | 260000 |
| 57 | 冰箱            | 美的              | BCD-501WKGPM(E)         | 2 台 | 5000   | 10000  |
| 58 | 垂直电泳仪         | 美国 GE           | SE250                   | 1 台 | 8000   | 8000   |
| 59 | 垂直电泳仪         | 美国 GE           | SE260                   | 1 台 | 10000  | 10000  |
| 60 | 电转印仪 (湿转)     | 美国 GE           | TE22                    | 1 台 | 8000   | 8000   |
| 61 | 梯度 PCR 仪      | 北京天根            | TGreat (OSE-GP-01)      | 1 台 | 60000  | 60000  |
| 62 | 电泳电源          | 美国 GE           | EPS301                  | 1 台 | 8000   | 8000   |
| 63 | 小型潜水电泳仪       | 美国 GE           | HE33                    | 1 台 | 10000  | 10000  |
| 64 | 垂直电泳系统        | 美国 GE           | MiniVE                  | 1 台 | 20000  | 20000  |
| 65 | 电动吸液器         | 美国瑞宁            | Pipet-X                 | 1 支 | 10000  | 10000  |
| 66 | 单道移液器         | 美国瑞宁            | Pipet-liteXLS+          | 1 套 | 14000  | 14000  |
| 67 | 漩涡混合器         | 上海沪析            | Vortex-1\2              | 1 台 | 1000   | 1000   |
| 68 | 单孔数显电子恒温水浴锅   | 郑州长城            | HH-S                    | 5 台 | 1700   | 8500   |
| 69 | 磁力搅拌器         | 北京 Thmorgan     | TM200                   | 1 台 | 2000   | 2000   |
| 70 | 万分之一天平        | 上海赛多利斯          | GL224-1SCN              | 1 台 | 16000  | 16000  |
| 71 | 百分之一天平        | 上海赛多利斯          | GL2202-1SCN             | 1 台 | 8000   | 8000   |
| 72 | 医用冷藏箱         | 赛默飞 (国产)        | FYC-1030                | 1 台 | 40000  | 40000  |
| 73 | 医用冷藏箱         | 赛默飞 (国产)        | FYC-335                 | 2 台 | 15000  | 30000  |
| 74 | 二氧化碳培养箱       | 赛默飞 (国产)        | 371                     | 1 台 | 95000  | 95000  |
| 75 | 电子防潮柜         | 锐玛              | MRD-45                  | 2 台 | 4000   | 8000   |
| 76 | 体视显微镜         | 德国徕卡            | S9D                     | 1 台 | 35000  | 35000  |
| 77 | 恒温培养箱         | 日本普和希 PHCbi     | MIR-154L-PC             | 1 台 | 40000  | 40000  |
| 78 | 低温 (恒温) 搅拌反应浴 | 郑州长城            | DHJF-4010               | 1 台 | 20000  | 20000  |
| 79 | 小型垂直电泳槽       | 美国 Bio-rad      | Mini-PROTEAN Tetra Cell | 5 套 | 10000  | 50000  |

|    |                 |                         |                                                      |     |        |        |
|----|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 80 | 小型转印槽           | 美国 Bio-rad              | Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell        | 1 套 | 12000  | 12000  |
| 81 | 半干转印槽           | 美国 Bio-rad              | Trans-Blot SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell | 1 套 | 35000  | 35000  |
| 82 | 全能型半干蛋白转印仪      | 美国 Bio-rad              | Trans-Blot Turbo                                     | 1 套 | 70000  | 70000  |
| 83 | 杂交洗涤工作站         | 美国 Cellagen Technology  | FlexiWash FW400                                      | 1 台 | 240000 | 240000 |
| 84 | 无冰冰盒            | 无锡耐思                    | 标准版                                                  | 2 台 | 1500   | 3000   |
| 85 | 预制胶电泳槽          | 美国 Bio-rad              | Wide Mini-Sub Cell GT                                | 2 台 | 10000  | 20000  |
| 86 | 微波炉             | 格兰仕                     | G80F23CN3L-Q6 (P0)                                   | 1 台 | 500    | 500    |
| 87 | 二氧化碳培养箱         | 上海 ESCO                 | CCL-170B-8                                           | 1 台 | 75000  | 75000  |
| 88 | 超低温冰箱           | 美国赛默飞                   | RDE30086FV                                           | 1 台 | 120000 | 120000 |
| 89 | 超灵敏多功能成像仪       | 美国 GE                   | Amersham Imager 800 Fluor                            | 1 台 | 580000 | 580000 |
| 90 | 毒麻药品柜           | 万度                      | ZYC2004-ZYC2090                                      | 1 台 | 2000   | 2000   |
| 91 | 防爆冰箱            | 海尔                      | HLR-310FL                                            | 1 台 | 29000  | 29000  |
| 92 | 非接触式全自动超声波细胞破碎仪 | 宁波新芝                    | SCIENTZ08-III                                        | 1 台 | 70000  | 70000  |
| 93 | 低温恒温培养箱         | 日本普和希 PHCbi             | MIR-154L-PC                                          | 1 台 | 40000  | 40000  |
| 94 | 十万分之一天平         | 瑞士梅特勒                   | XSR205DU                                             | 1 台 | 67000  | 67000  |
| 95 | 多功能酶标仪          | 美国 PerkinElmer          | VICTOR Nivo                                          | 1 台 | 545000 | 545000 |
| 96 | 抽湿机             | 美国(深圳)森井                | CH950B                                               | 4 台 | 6500   | 26000  |
| 97 | 冷冻研磨仪           | 上海净信科技                  | JXFSTPRP-CL                                          | 1 台 | 92000  | 92000  |
| 98 | 全自动蛋白免疫印迹杂交系统   | 美国 Precision Biosystems | Blotcyler                                            | 1 台 | 230000 | 230000 |

|                                   |               |             |                      |     |        |        |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-----|--------|--------|
| 99                                | 实时无标记细胞功能分析系统 | 美国 ACEA/安捷伦 | xCELLigence® RTCA DP | 1 台 | 770000 | 770000 |
| 合同总价：壹仟壹佰陆拾陆万玖仟肆佰肆拾元整 （¥11669440） |               |             |                      |     |        |        |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

## 第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

## 第五条 交付和验收

1.交付使用时间：自签订合同之日起 1 个月内全部货物交货完毕，如是进口设备 3 个月内全部货物交货完毕；地点：广西中医药大学，由甲方指定院区（南宁市）。

2.乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

## 第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

## 第七条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：硬件保修：对投标货物硬件的免费质保期为 1 年（部分产品质保期为超 1 年以上，具体以技术偏离表为准。人为损坏和使用不当除外）免费质保期满后，仅收取更换器件的材料成本费，

不收取修理费、工时费。保证用户能够及时买到货物所需的备品备件和易损件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

#### 第八条 付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质: 财政性资金。

3.付款方式:

签订合同后 10 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额 30%的预付款,待货物安装调试完毕并最终验收合格后,甲方在 20 个工作日内凭乙方开具的全额发票付清乙方剩余的 70%合同款。(无质保金、无息)。

乙方在办理进口相关手续时,甲方有义务协助乙方办理。从合同签订之日起,如果因国家政策而导致进口设备需额外支付相关关税,该费用由甲方承担。

#### 第九条 质量保证金及履约保证金

(无)。

#### 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计(期限: 硬件保修:对投标货物硬件的免费质保期为 1 年(部分产品质保期为超 1 年以上,具体以技术偏离表为准。人为损坏和使用不当除外)免费质保期满后,仅收取更换器件的材料成本费,不收取修理费、工时费。保证用户能够及时买到货物所需的备品备件和易损件)。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物,质保期从安装、调试完成之日起计算,或者从项目整体最终验收之日起质保期满后延长 1 年,以先到时间为准。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2.如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在 30 分钟内响应,1 小时内赶到现场,非系统性故障 2 小时内解决问题,对于 1 个工作日以上不能修复的设备,免费提供备用机。设备在 6 个月内因质量问题发生故障无条件免费更换的。

3.在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

#### 第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付,乙方同时需

通知甲方货物已送达。

### 第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收, 甲方无故不进行最终验收工作并己使用货物的, 视同己安装调试完成并最终验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物, 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场, 验收完毕后作出验收结果报告 (验收书)。

6. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。

### 第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的, 每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金, 超过 17 天对方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成经济损失; 甲方延期付货款的, 每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责修复, 如无法修复的乙方负责更换全新货物, 或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

8. 上述违约金支付合计不应超过合同金额的 20%。

### 第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

### 第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合国家标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

### 第十七条 合同生效及其它

1. 本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

### 第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

### 第十九条 签订本合同依据

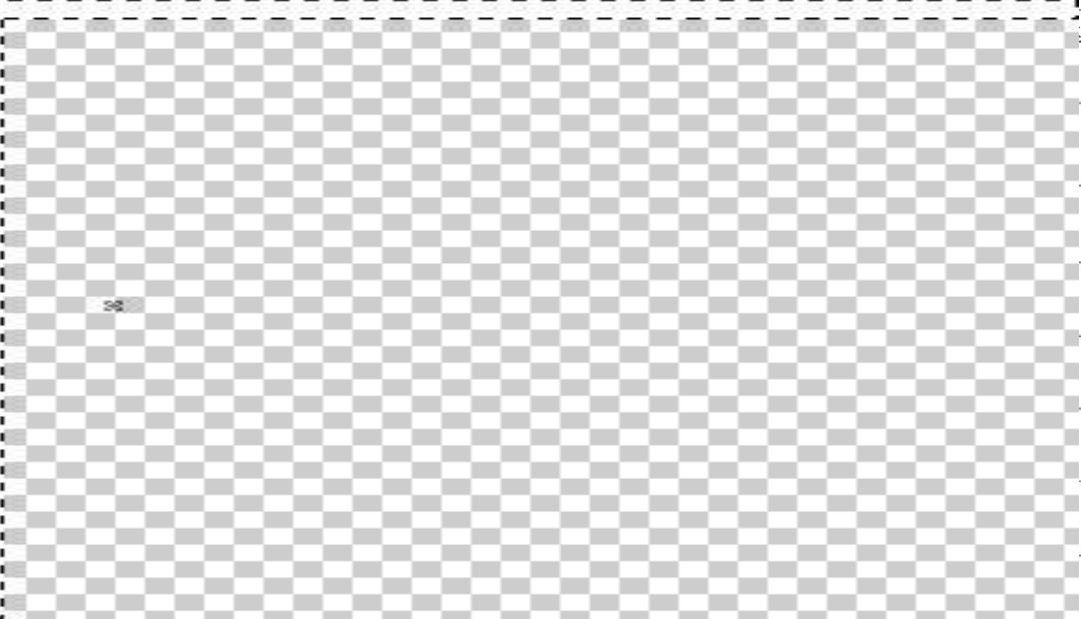
1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

**第二十条** 本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方一份、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份。自签订之日起2个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

|                                                                                                    |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方（章）广西中医药大学<br> | 乙方（章）上海琼弘生物科技有限公司<br> |
| 单                                                                                                  |                       |
| 法                                                                                                  |                                                                                                           |
| 委                                                                                                  |                                                                                                           |
| 电                                                                                                  |                                                                                                           |
| 电                                                                                                  |                                                                                                           |
| 开                                                                                                  |                                                                                                           |
| 账                                                                                                  |                                                                                                           |
| 邮                                                                                                  |                                                                                                           |

联系人：黄松

合同附件

1、乙方承诺具体事项:

①第 16 项荧光定量基因扩增仪: 仪器整机质保 2 年, 光学元件 (含光源组、光纤组、检测通道组) 质保 5 年;

②第 45 项洗衣机: 保修期 36 个月;

③第 88 项超低温冰箱: 整机零部件 5 年保修;

④第 89 项超灵敏多功能成像仪: 设备验收合格后保修 2 年。

2、质保期责任: 详见技术响应表。

3、其他具体事项: 详见技术响应表。

甲方(章)



2020 年 6 月 24 日

乙方(章)



2020 年 6 月 24 日

注: 填不下时可另加附页。