

关于绍兴市人民医院镜湖总院除颤仪采购项目复评结果复核报告

项目名称	绍兴市人民医院镜湖总院除颤仪采购项目
复核内容	收到结果质疑书，组织原评委进行结果复核
复核日期	2024年10月20日 14:30
复核地点	浙江翔实建设项目管理有限公司一楼评标室
	<p>质疑事项1: ★3.1.1 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)(AED支持8岁以下儿童)、起搏功能。该条参数科曼除颤监护仪，型号：S1，不具备(AED支持8岁以下儿童)。</p> <p>事实依据：下图为科曼使用说明书，不能明确说明AED支持8岁以下儿童</p> <p>法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第六章 质疑与投诉第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。</p> <p>专家意见：经复核，绍兴溢锦医疗科技有限公司在投标文件中响应此条参数，故在原评审时予以赋分，现根据质疑其提供答疑文件中也承诺此事项。此项质疑不成立。</p>
复核结果	<p>质疑事项2: 3.1.4 体外电极板支持病人接触状态显示：具备以及3.1.10成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片，体外板支持阻抗指示。该2条参数科曼除颤监护仪，型号：S1，不具备病人接触状态显示以及体外板支持阻抗显示。</p> <p>事实依据：其说明书中如下图所示，体外电极板明显不具备病人接触状态显示以及不能体现阻抗显示</p> <p>法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第六章质疑与投诉第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。</p> <p>专家意见：经复核，评标委员会按招标文件3.1.4要求“体外电极板要支持病人接触状态显示”进行评审，其投标文件自定义为无偏离故原评审时予以赋分。</p>

现因质疑，向绍兴溢锦医疗科技有限公司搜集佐证材料上，其提供的佐证材料所示为在显示器上显示，经代理机构询问后证实其无法在电极板上显示，与设置参数的要求不相符，故现对其扣除 1 分；评标委员会按 3.1.10 要求“成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片，体外板支持阻抗指示。该 2 条参数科曼除颤监护仪，型号：S1，不具备病人接触状态显示以及体外板支持阻抗显示。”向绍兴溢锦医疗科技有限公司搜集佐证材料上，其提供的佐证材料所示为在显示器上显示，经代理机构询问后证实其无法在电极板上显示（该材料所示为在显示器上显示，经代理机构询问后证实其无法在电极板上显示（该公司对招标文件此条理解存在偏差），与设置参数的要求不相符，故现对其扣除 1 分。

质疑事项 3：▲3.1.6 CPR 辅助功能：具备支持 CPR 传感器，提供即时的按压反馈，可指导 CPR 操作。该条参数要求原产配备的 CPR 传感器能够显示即时的按压反馈并指导 CPR 操作。科曼 S1 原产说明书中只提供了 CPR 节拍器，并且不能指导 CPR 操作

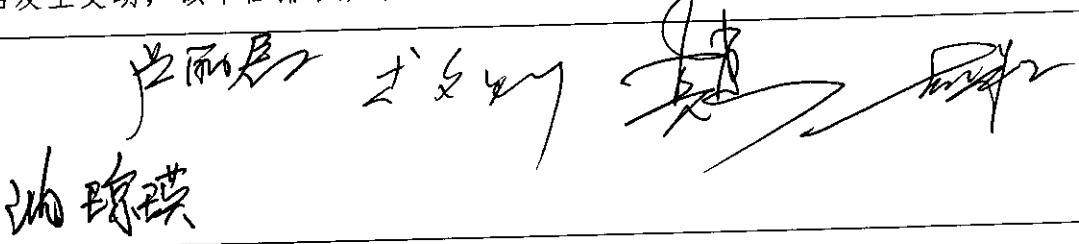
事实依据：科曼 S1 说明书中明确表示其配备的原产为节拍器，非传感器，不能反映病人的实时按压情况

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第六章质疑与投诉第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益授权损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

专家意见：经复核，根据绍兴溢锦医疗科技有限公司提供的佐证材料（深圳市医疗器械检验中心检验报告）显示具有具备支持配置 CPR 心肺复苏传感器。此项质疑不成立。

质疑事项 4：▲3.1.20 支持 ≥ 3 种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。该条参数科曼除颤监护仪，型号：S1，在注册证和使用书上只有两种体内电极板。
事实依据：附上科曼 S1 注册证以及使用说明书只显示两种型号体内电极板

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第六章质疑与投诉第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益授权损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提

	<p>出质疑。</p> <p>专家意见：经复核，根据绍兴溢锦医疗科技有限公司投标文件中 P45 页中配置清单序号 6、序号 7 显示有 3 个体内电极板，P189 页医疗器械注册证所示为 2 种型号体内除颤电极板，投标文件前后不一致，询标后其提供三种尺寸的图片，图片无法作为有效资料，且其无法提供图片中三种尺寸电极板的佐证资料证明其符合招标文件要求，现对绍兴溢锦医疗科技有限公司扣除 2 分。</p> <p>专家意见总结：综上，绍兴溢锦医疗科技有限公司商务技术得分由原先的 48.9 分变更为 44.9 分，总得分由原先的 67.65 分变更为 63.65 分，重新排序后，排名发生变动，该单位排名从第 1 名变成第 2 名。</p>
专家签字	

2024. 10. 20

绍兴市人民医院镜湖总院除颤仪采购项目复评评审专家签到表

采购人：绍兴市人民医院

论证内容：绍兴市人民医院镜湖总院除颤仪采购项目结果复评

时间：2024年10月20日14:30

序号	姓名	单 位	职 称	联系 电 话	签 到 时 间
1	王建	18岁华第五医院	主治医师	13567216774	2024.10.20
2	王之云	绍兴文理学院附属医院	主任医师	13867551860	2024.10.20
3	卢丽君	华山医院	副主任医师	13989553077	2024.10.20
4	浦琼瑛	越城区斗门街道社区卫生服务中心	副主任医师	18258501539	2024.10.20
5	翁中江	绍兴市人民医院	主任医师	13735257651	2024.10.20