

第2章. 投标分项报价表 1（动脉硬化检测仪）

项目名称：项目名称：动脉硬化检测仪及免散瞳眼底相机采购

招标编号：CTZB-H191230CWZ-1

（价格单位：元人民币）

序号	设备名称	品牌型号规格、 产地	制造厂商名称	数量	出厂单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期
1	动脉硬化 检测仪	欧姆龙 BP-203RPEIII、 辽宁	欧姆龙（大连 有限公司）	1套	289000.00	289000.00	1年
设备价格（小计）			289000.00				
序号	费用名称		金额			备注	
/	/		/			/	
费用价格（小计）			0.00				
设备总价（设备价格+费用价格） （合计）			¥289000.00（贰拾捌万玖仟元整）				


注：

- 1、▲动脉硬化检测仪采购预算为人民币30万元整；如投标人设备总价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。
- 2、▲不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝；
- 3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2020年1月20日

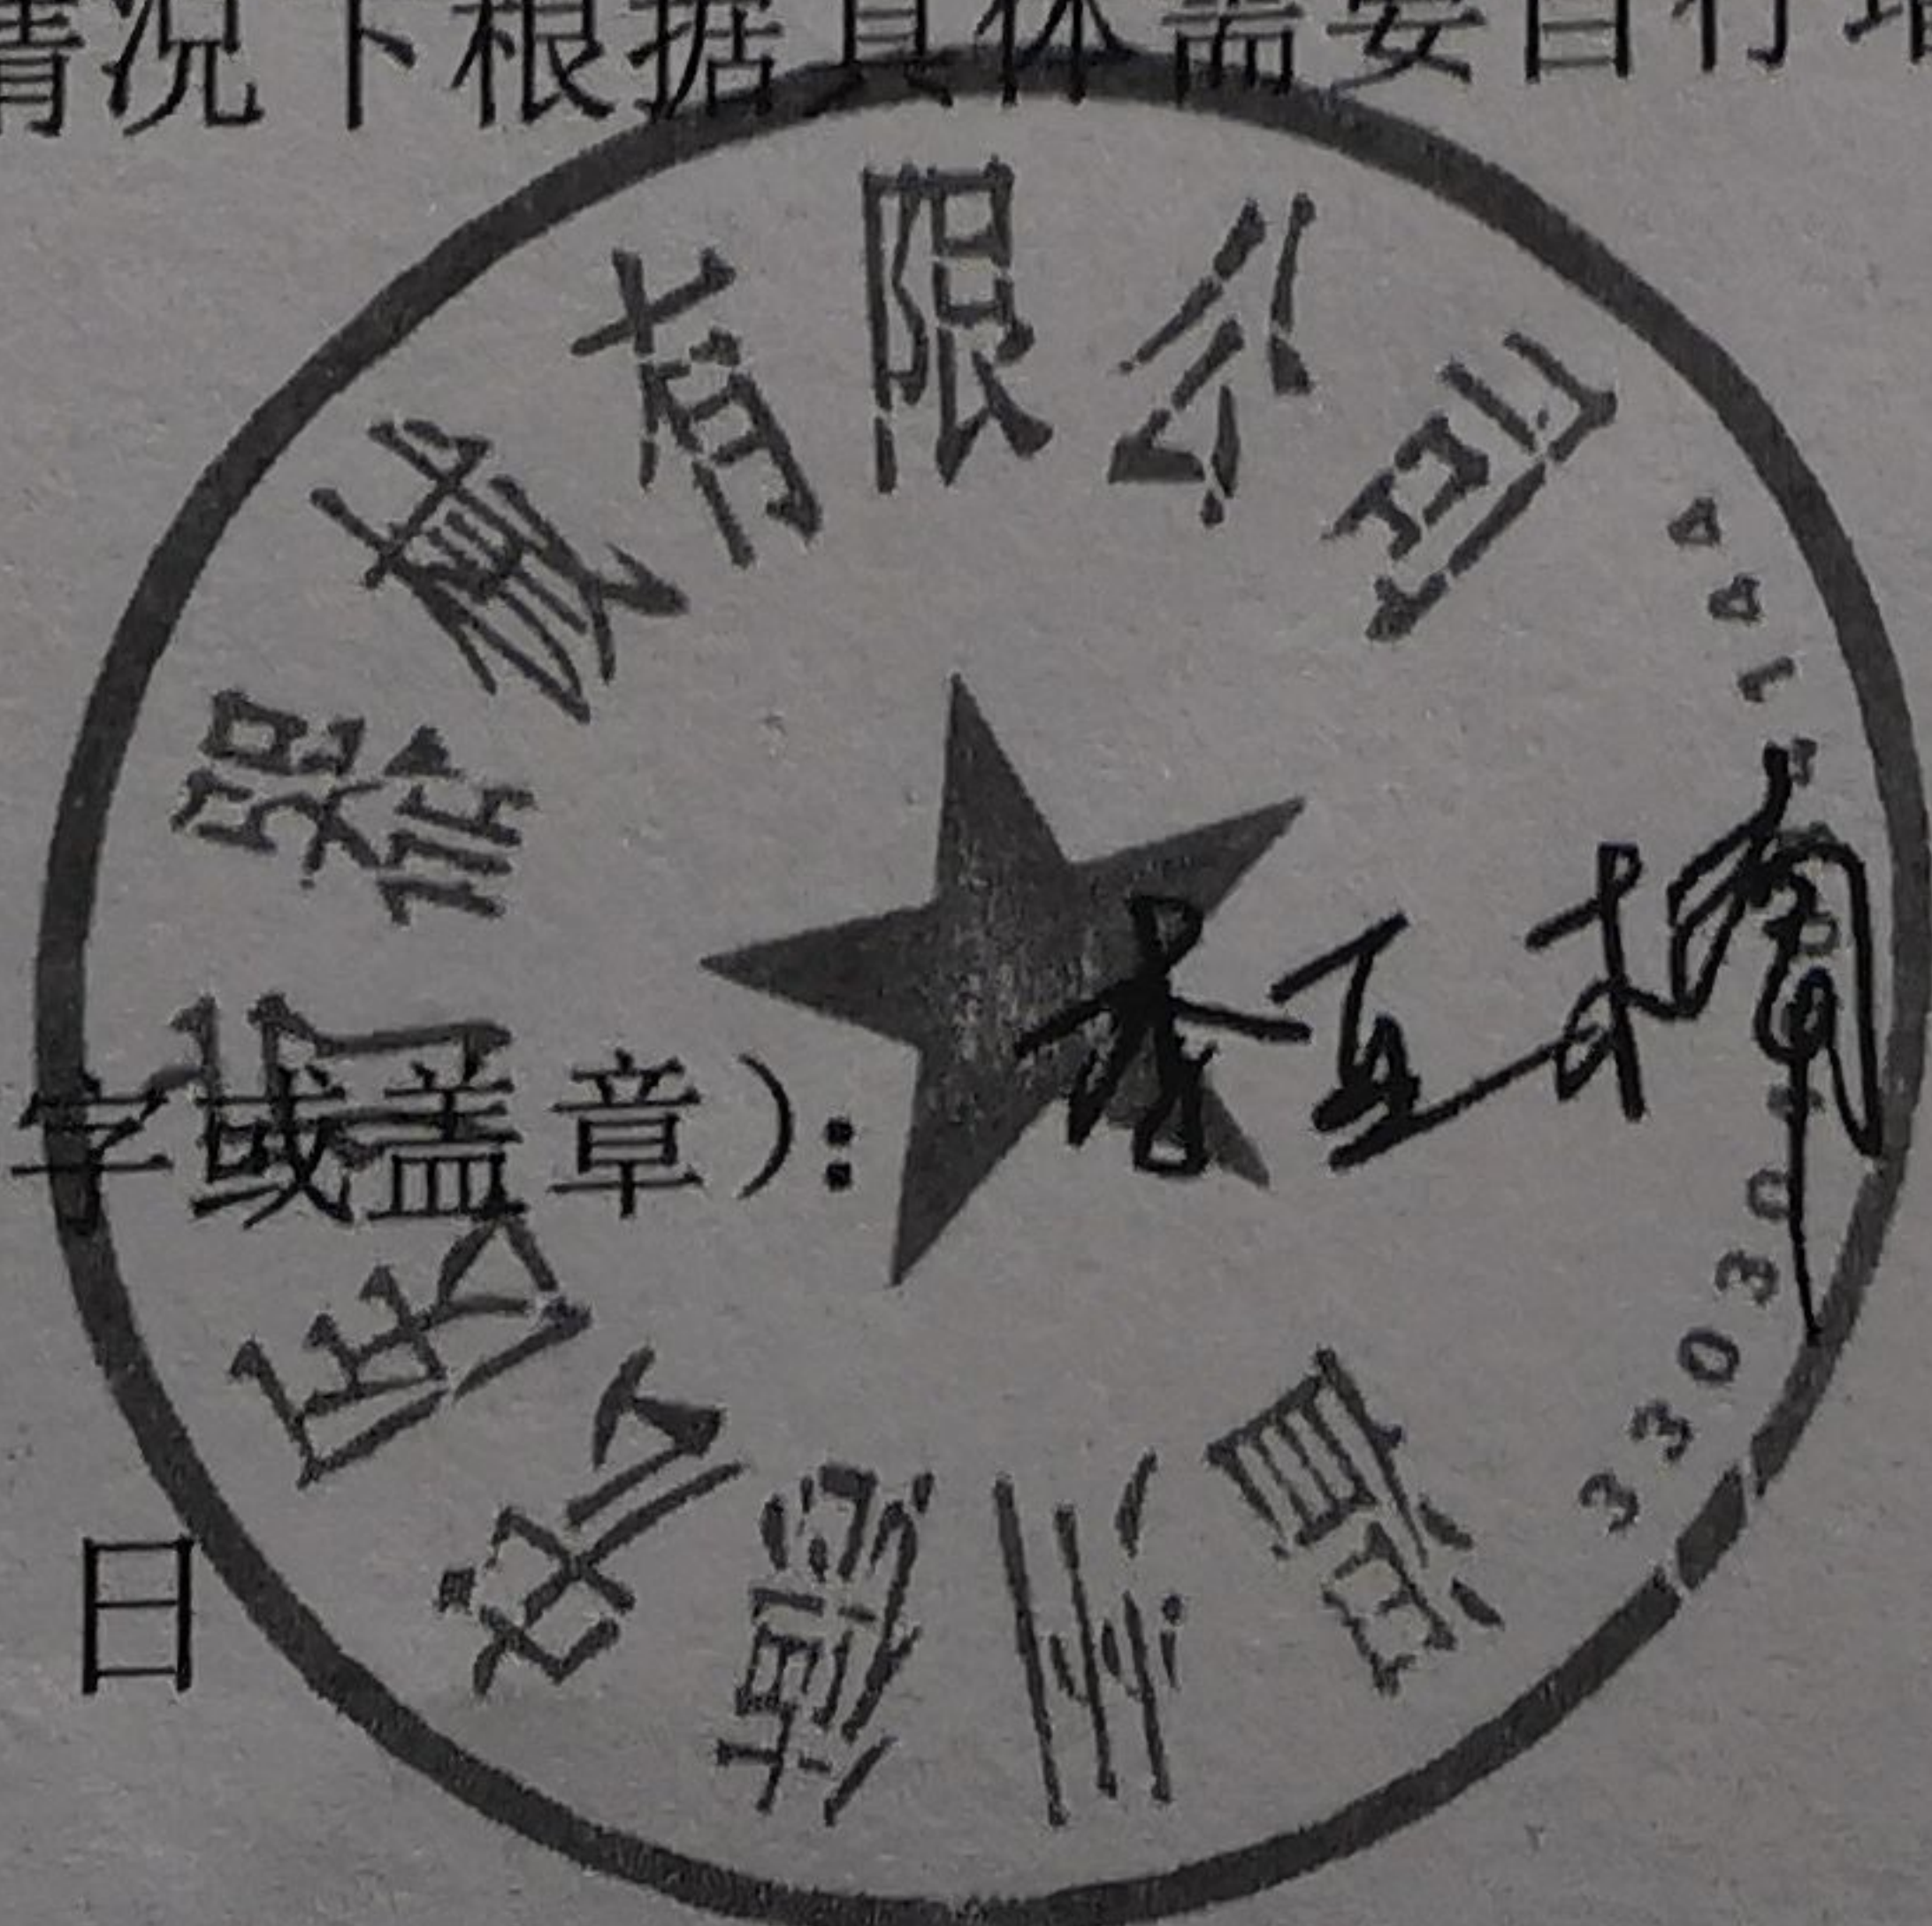

第3章. 投标分项报价表2（免散瞳眼底相机）

项目名称：项目名称：动脉硬化检测仪及免散瞳眼底相机采购

招标编号：CTZB-H191230CWZ-1

（价格单位：元人民币）

序号	设备名称	品牌型号规格、 产地	制造厂商名称	数量	出厂单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期
2	免散瞳眼 底相机	晋弘 MiiS Horus+ Scope DSC 200、台湾	晋弘科技股份 有限公司	1套	147000.00	147000.00	1年
设备价格（小计）			147000.00				
序号	费用名称		金额			备注	
/	/		/			/	
费用价格（小计）			0.00				
设备总价（设备价格+费用价格） （合计）			¥147000.00（壹拾肆万柒仟元 整）				

注：

- 1、▲免散瞳眼底相机采购预算为人民币15万元整；如投标人设备总价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。
- 2、▲不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝；
- 3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2020年1月20日

