

1、开标一览表


项目编号： LBWXZC2020-G1-00913-GXTZ

采购计划文号： WXZC2020-G1-01723-001

投标人名称： 广西柳州医药股份有限公司


单位：元

项号	货物名称	数量	品牌型号、生产厂家	技术参数及性能、配置	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	医用外科口罩	50000	DW1-S 挂耳 17.5*9.5cm 广西德福莱医疗器械有限公司	1、口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；平面型大号挂耳式； 2、组成：由非织造布及熔喷布及口罩带、鼻夹组成； 3、口罩两侧面进行气体交换的压力差应 $\leq 49\text{pa}/\text{cm}^2$ ； 4、包装：A型：100个/大包，1个/小包；E型：50个/盒，1个/小包； 5、经环氧乙烷灭菌的口罩，出厂时其环氧乙烷残留量不大于 $10\mu\text{g}/\text{g}$ 6、2ML合成血液以 16.0KPa （ 120MMHG ）压力喷向口罩外侧后口罩内侧面不出现渗透； 7、每根口罩带与口罩体连接点断裂强力不小于 10N ； 8、材料应使用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于5秒。 9、非油性颗粒物过滤85%；	0.28	14000	

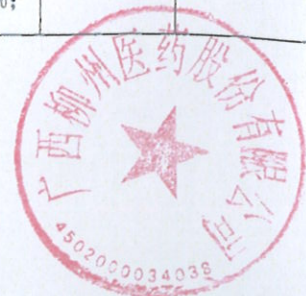

备注

1	医用外科口罩	50000	DW1-S 挂耳 17.5*9.5cm 广西德福莱医疗器械有限公司	<p>10、细菌过滤效率 95%;</p> <p>11、微生物指标非无菌口罩的须达到 YY0469-2011 中华人民共和国医药行业标准。</p> <p>12、口罩材料原发性刺激指数 0.4(小于 0.4 为正偏离);</p> <p>无过敏反应。</p> <p>13、口罩的细胞毒性 2 级(小于 2 级为正偏离)。</p> <p>14、产品有效期≥2 年;</p> <p>15、投标时须同时提供有资质的第三方检测报告出具的检验报告复印件;</p>	0.28	14000
2	一次性口罩	2912500	平面耳挂 175*95mm 桂林合兴医疗器械有限公司	<p>1、口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；挂耳型；规格：17cm×9.5cm(±1cm)；鼻夹长度不小于 8cm；</p> <p>2、组成：由至少三层非织造布和口罩带、鼻夹组成；口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应≤49pa/cm²；</p> <p>3、包装：200 个/大包个装，10 个/小包个装；</p> <p>4、细菌过滤效率 70%；</p> <p>5、吸气阻力 84pa，呼气阻力 75pa</p> <p>6、无皮肤刺激性；</p> <p>7、耳带断裂拉力 10N；(大于 10N 为正偏离)</p> <p>8、抗湿性等级 3 级；(大于 3 级为正偏离)</p> <p>9、产品有效期≥2 年；</p> <p>10、执行标准：GB/T 32610-</p>	0.25	728125

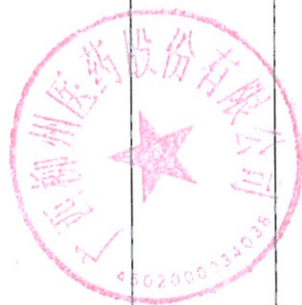


2	一次性口罩	29125 00	平面耳挂 175*95mm 桂林合兴 医疗器械 有限公司	2016 日常防护型口罩技术规范 11、投标时须提供有资质的 第三方检测报告出具的检 验报告复印件；	0.25	728125
3	N95 医用防护 口罩	21000	DF1-S 挂 耳 式 11*15cm 广西德福 莱医疗器 械有限公 司	1、挂耳式，折叠型；鼻夹 应具有可调节性； 2、经环氧乙烷灭菌的口罩， 出厂时其环氧乙烷残留量 不超过 10ug/g； 3、包装：50 个/盒，1 个/ 小包 4、非油性颗粒物过滤 95%； 5、产品有效期≥2 年； 6、将 2ml 合成血液以 10.7KPa（80mmHg）压力喷 向口罩，口罩内侧面无渗 透。 7、在气流量为 85L/min 情 况下，口罩的吸气阻力不超 过 343.2pa/cm ² ； 8、细菌过滤效率 95%； 9、表面抗湿性 3 级； 10、阻燃性：虚燃时间 5 秒； 11、符合 GB19083-2010 标 准《医用防护口罩技术要 求》； 12、投标时须同时提供有资 质的第三方检验报告复印 件；	4.00	84000
4	防护服	7000	连体式	1、自灭菌之日起有效期≥2 年； 2、符合 GB19082-2009 标准； 3、型号规格根据采购人要	35.00	245000



4	防护服	7000	南宁腾科 宝迪生物 科技有限 公司	求选择; 4、包装: 30套/箱, 1套/ 小包; 5、抗渗水性: 防护服关键 部位静水压 1.67kPa(17cm H20); 6、透湿量 2500g/(m ² ·d); 7、抗合成血液穿透性 2级; 8、防护服外侧面沾水等级 3 级; 9、关键部位材料及接缝处 对非油性颗粒的过滤效率 95%; 10、经环氧乙烷灭菌的口 罩, 出厂时其环氧乙烷残留 量不超过 10ug/g;	35.00	245000
5	一次性医用隔 离衣	20000	(全连身 式) 南宁腾科 宝迪生物 科技有限 公司	1、产品规格: 连体式: 40 套/箱, 1套/小包; 2、产品干燥、清洁、无霉 斑、表面不允许用黏连、裂 缝、孔洞等缺。装有拉链的 隔离服不能外露, 缝制则要 求: 针次均匀、平直、不得 有跳针; 3、断裂强力: 纵向≥61N, 横向≥34N; 4、断裂伸长率: 纵向≥31%, 横向≥18%。 5、用于医疗机构门诊、病 房、检查室等作普通隔离 6、执行标准: YY/T 0506.1-2005《病人、医护 人员和器械用手术单、手术 衣和洁净服第1部分:制衣	12.00	240000




5	一次性医用隔离衣			厂、处理厂和产品的通用要求》		
6	护目镜	10000	防雾封闭型 TKBD1001 南宁腾科宝迪生物科技有限公司	1、规格：通用型：：1个/袋，200个/箱； 2、适用范围：用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅； ▲3、执行标准：中华人民共和国国家标准（GB14866-2006 个人用眼护具技术要求）； ▲4、与佩戴者接触的头箍宽度≥10mm，可调节，材料柔软；	9.00	90000
7	一次性隔离面屏	10000	防雾型 TKBD2001 南宁腾科宝迪生物科技有限公司	1、适用范围：适用于医疗机构中检查治疗时起防护作用、阻隔体液、血液飞溅或泼溅； 2、产品结构：由高分子材料制成的防护罩，泡沫条和固定；装置组成。非无菌提供，一次性使用 ▲3、执行标准：中华人民共和国国家标准（GB14866-2006 个人用眼护具技术要求）； 4、包装规格/型号：L32，10个/袋，20袋/箱；	5.00	50000
8	一次性医帽	20000	A型灭菌非独立包装	1.条形装帽子； 2.直径不小于25cm，帽深不小于15cm； 3.适用范围：供临床医务人员一次性佩戴适用，覆盖适	0.50	10000

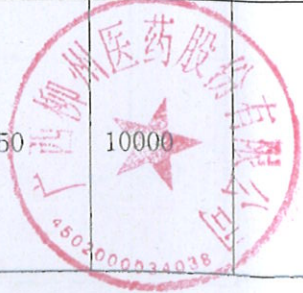

12	靴套	10000	高筒形 南宁腾科 宝迪生物 科技有限 公司	<p>1. 规格型号: 50 个/袋, 500 只/箱; 38×48cm (± 1.5cm);</p> <p>2. 外观: 表面没有损伤烫伤热合缝处无明显焦印, 穿孔, 焊缝基础本直收口松紧均匀, 富有弹性;</p> <p>3. 产品有足够的强度和阻隔性能;</p>	6.00	60000	
13	手消毒液	15000	150ml 广西庆荣 卫生消毒 制品有限 公司	<p>▲1、有效成分含量与范围: 醋酸洗必泰 0.45%-0.55%(w/w) 乙醇 63%-77%(v/v);</p> <p>▲2、杀微生物类别: 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌及致病性酵母菌;</p> <p>▲3、使用范围: 适用于外科手消毒和卫生手消毒;</p> <p>4、复配配方, 不添加香精;</p> <p>▲5、快速易干、无皮肤刺激性, 长期使用不过敏、不开裂;</p> <p>6、长嘴喷雾型, 方便使用;</p> <p>▲7、产品有效期≥2 年;</p> <p>8、规格: 150ml;</p> <p>9、投标时须提供有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件;</p>	8.70	130500	
14	手消毒液	10000	500ml	<p>1、外观: 透明液体, 无异物, 无沉淀或分层现象;</p> <p>2、PH 值: 6.5—7.5;</p> <p>3、微生物污染指标 完整皮肤消毒剂菌落总数≤10C</p>	25.30	253000	




14	手消毒液	10000	上海利康消毒高科技有限公司	FU/mL, 霉菌和酵母菌≤10CFU/mL, 不得检出致病菌; 破损皮肤的消毒剂应无菌; 4、规格: 500ml; 5、投标时须提供有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件;	25.30	253000	
15	二氯异氰尿酸钠(优虑净)	6000	10g*10袋 河北冀衡化学股份有限公司	有效氯含量 58-62%; 规格: 泡腾消毒片 100g/包	4.00	24000	
16	84 消毒液	15000	桂林漓峰医药用品有限责任公司	1、作用: 可杀灭肠道致病菌, 化脓性球菌, 致病性酵母菌。适用于地面、桌面等一般物体表面的消毒; 2、成份: 主要成分为次氯酸钠, 有效氯含量为 60g/L~70g/L (或 4.0%~7.0%); 3、用法用量: 一般物体表面及地面按 1:65 的比例配制, 浸泡、喷洒、擦拭, 作用 10 分钟。稀释 84 消毒液时, 请使用自来水, 并搅拌均匀。(如 1 毫升消毒液, 用 65 毫升自来水稀释, 有效氯浓度为 900mg/L); 4、有效期: 10 个月; 5、执行标准: 一般为企业标准, 符合国家相关规定; 6、规格: 500ml;	2.5	37500	

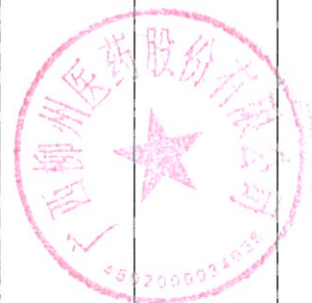


17	体温枪	2000	DPT-IFT100 广西开蒙 医疗科技 有限公司	<p>▲1、精确：测量误差$\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$；</p> <p>▲2、检测时间：测量响应时间小于1秒；</p> <p>▲3、使用次数：按键10万次；</p> <p>4、自动关机：$< 30\text{s}$；</p> <p>5、主要由红外线探头组件、主线路板组件、LCD显示组件和外壳组件组成；</p>	60.00	120000
18	新型冠状病毒 2019-nCoV核 酸检测试剂盒 (荧光PCR法)	26000	50人份/ 盒 上海伯杰 医疗科技 有限公司	<p>1、预期用途：本试剂盒用于体外定性检测新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的口咽拭子、鼻咽拭子和痰液样本中，新型冠状病毒(2019-nCoV)ORF1ab和N基因；</p> <p>2.包装规格：20人份/盒，50人份/盒；</p> <p>▲3.检验原理：荧光PCR法；</p> <p>▲4.检测靶点：新型冠状病毒(2019-nCoV)ORF1ab和N基因；</p> <p>▲5.样本类型：样本类型全面：包括人口咽拭子、鼻咽拭子和痰液；</p> <p>▲6.内源性内标：产品带内源性内标检测系统，可以监测样本采集、核酸提取及PCR扩增过程，避免假阴性</p>	13.00	338000



18	新型冠状病毒 2019-nCoV 核 酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	26000	50 人份 / 盒 上海伯杰 医疗科技 有限公司	<p>结果的出现;</p> <p>7.阳性质控和阴性质控: 阴性质控品和阳性质控品均参与提取, 用于对环境进行监控和 PCR 检测试剂的质控;</p> <p>8.储存条件: 避光-20±5℃ 储存;</p> <p>9.有效期: 稳定性好, 有效期不低于 6 个月;</p> <p>▲10.灵敏度: 最低检测限: 1×10³ copies/mL;</p> <p>▲11.特异性: 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应;</p> <p>▲12.阴性符合率: 100%;</p> <p>▲产品为广西药品集团采购服务平台要求执行的《广东省牵头的新冠病毒检测试剂采购区域联盟入选品种》。</p>	13.00	338000
19	病毒 RNA 提取 试剂 (县医院)	17000	48 人份 /96 人份 上海伯杰 医疗科技 有限公司	<p>1. 样品种类: 适用于血液、血清、血浆、尿液、鼻咽拭子、细胞培养物等样本, 从样本中提取高纯度的核酸 (DNA/RNA) 可直接用于荧光定量 PCR、RT-PCR、生物芯片分析、二代测序等相关实验;</p> <p>2. 适用机型: 试剂使用仪器为开放性机型, 适用伯杰、ABI、Thermo、天隆等;</p> <p>3. 样品量: 100-200ul;</p>	10.00	170000

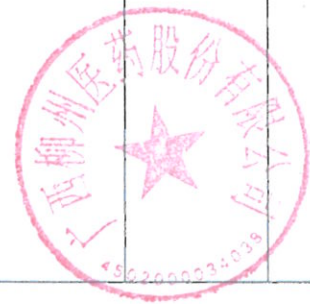


19	病毒 RNA 提取试剂 (县医院)	17000	48 人份 /96 人份 上海伯杰 医疗科技 有限公司	<p>4. 洗脱体积: 50-100ul;</p> <p>▲5. 时间: 抽提试剂有 15 与 35 分钟两种试剂可供选择;</p> <p>6. 规格: 96 人份/盒;</p> <p>▲7. 反应原理: 利用预填充的胍盐去除蛋白, 无需添加蛋白酶 K, 直接加样上机;</p> <p>8. 拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构 (医学检验实验室) 执业许可及测序服务平台, 能对所投标产品提供技术支持;</p> <p>▲9. 质量控制: 生产厂家通过 ISO13485 认证、ISO9001 认证、获得注册证批号;</p> <p>▲10. 保存条件: 室温保存, 有效期 12 个月;</p>	10.00	170000
20	病毒 RNA 提取试剂 (疾控中心)	9000	Ex-DNA/RN A 病毒 (CDC) 西安天隆 科技有限 公司	<p>1. 提取原理: 基于磁珠吸附技术, 通过特制磁棒吸附、移动、释放磁珠, 实现磁珠/标本的转移, 得到高纯度核酸。</p> <p>2. 样本适用性: 血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等;</p> <p>3. 包装形式: 试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内, 高温热封贴膜后抽真空包装;</p> <p>▲4. 仪器匹配性: 能够匹配 NP968 系列全自动核酸提取仪;</p> <p>5. 单次提取时间: ≤30 分</p>	22.00	198000

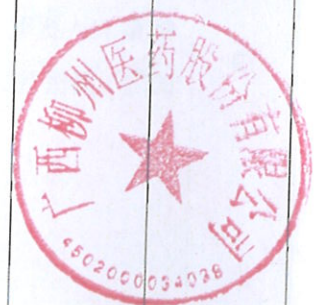

20	病毒 RNA 提取试剂 (疾控中心)	9000	Ex-DNA/RNA 病毒 (CDC) 西安天隆科技有限公司	<p>钟;</p> <p>▲6、规格齐全: 至少具有 64T/盒 (预封装) 16T/板 × 4 板; 40T/盒 (预封装) 10T/板 × 4 板; 20T/盒 (预封装) 5T/板 × 4 板; 20T/盒 (DT6) 1T/条 × 20 条) 四种包装规格;</p> <p>▲7、扫码功能: 试剂盒内每板试剂均带有唯一性二维码, 扫描后仪器可直接调用二维码内包含的程序信息, 无需人工编辑、查找程序;</p> <p>8、储存及有效期: 室温保存条件下, 有限期为 12 个月;</p> <p>9、配套耗材: 96 孔预封装深孔板+搅拌套; 单条预封装+搅拌套</p> <p>▲10、需提供试剂的第一类医疗器械备案凭证复印件。</p>	22.00	198000
21	病毒采样管	26000	灭活型 -5ml-1 非灭活型 重庆中元汇吉生物技术有限公司	<p>1、适用范围: 用于样本的收集、运输和储存等;</p> <p>2、主要结构组成: 由拭子和含保存液的杯、管等组成。非无菌提供;</p> <p>3、型号: I 型 (含灭活剂)、II 型 (不含灭活剂), 1mL、1.5mL、2mL、2.5mL、3mL、3.5mL、4mL、5mL、6mL、8mL、10mL、12mL;</p> <p>4、规格: 1 测试/包, 20 测试/盒, 50 测试/盒, 80</p>	3.00	78000



21	病毒采样管	26000	灭活型 -5ml-1 非灭活型 重庆中元 汇吉生物 技术有限 公司	测试/盒, 100 测试/ 盒; 5、产品性能: 1. 外观 1) 采样管管体应透明并易观察内装物, 不应有杂质、异物、油污等缺陷, 无毛刺、破裂、锐边等注塑缺陷; 管帽旋合紧密, 配合良好, 无歪盖现象。 2) 保存液应无色或特定颜色的透明液体, 不得出现浑浊, 无杂质、无异物、色变等缺陷。 3) 拭子应整洁, 不应有毛刺、污渍、异物等缺陷, 拭子杆表面应光洁、有弹性, 拭子头(吸水性纤维部分)应饱满而松软。 2. 净含量: 采样管内保存液的净含量应不少于瓶贴上的标示值。 3. 保存液 PH 值: 应为 7.2~7.6。	3.00	78000
22	采样吸头 (100ul 带滤芯)	13000	100UL 南通品程实验器材有限公司	规格: 100ul 带滤芯	0.30	3900
23	采样吸头 (1000ul 带滤芯)	13000	1000UL 南通品程实验器材有限公司	规格: 1000ul 带滤芯	0.30	3900

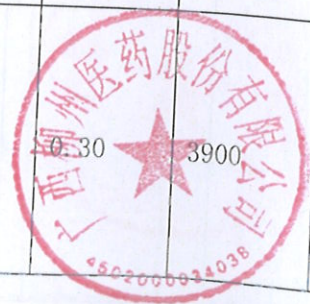

武宣县应急医疗物资储备项目

24	新冠抗体检测 试剂盒	50000	卡型:20 人份/盒 广州万孚 生物技术 股份有限 公司	符合国家相关规定。	13.50	675000	
----	---------------	-------	---	-----------	-------	--------	--

总报价（人民币大写）：叁佰陆拾壹万壹仟零贰拾伍元整（¥ 3611025 元）

储备工作完成时间：我公司收到本次医疗物资储备资金之日起 15 个工作日内。

备注：以上总报价包含完成所承诺的本项目招标范围内应急医疗物资储备任务所需一切费用，包含应急医疗物资的价款、运输、存储、设备安装、培训等成本费用，以及保险、税金、利润及其他所有费用的总和，投标人均应综合考虑在报价中。

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4. 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5. 此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面内容按投标须知要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：广西柳州医药股份有限公司

日期：2020 年 12 月 17 日



武宣县应急医疗物资储备项目

项目编号：LBWXZC2020-G1-00913-GXTZ

谈判文书

广西柳州医药股份有限公司：

请提供最终报价。

应答文件应于 2020 年 12 月 18 日 17 时 40 分前交回

谈判小组成员（签字）：李智、陈序、张捷、李中良、李峰

应答文件

最终报价为：（大写）叁佰肆拾肆万壹仟玖百伍拾元整。

（小写）¥：3441950元

储备完成时间：自签订合同后承储供应商在接储备计划后，须在 7 日内完成储备工作，由采购人会同武宣县市场监管局、卫健局、财政局对储备物资进行验收。

递交时间：2020 年 12 月 18 日 17 时 40 分

竞标人：广西柳州医药股份有限公司

竞标人代表（签字）：李智

应答文件附件：（如修改报价请提供）

武宣县应急医疗物资储备项目

项目编号：LBWXZC2020-G1-00913-GXTZ

序号	物资名称	计量单位	数量	单价（元）
1	医用外科口罩	个	50000	0.25 = 12500
2	一次性口罩	个	2912500	0.22 = 640,750
3	N95 医用防护口罩	个	21000	3 = 63000
4	防护服	件	7000	34 = 238000
5	一次性医用隔离衣	件	20000	11 = 220,000
6	护目镜	副	10000	8.8 = 88000
7	一次性隔离面屏	片	10000	4.5 = 45000
8	一次性医帽	顶	20000	0.49 = 9800
9	无菌医用手套	双	20000	2.2 = 44000
11	鞋套	双	10000	1.2 = 12000
12	靴套	双	10000	5.6 = 56000
13	手消毒液	瓶	15000	8.5 = 127500
14	手消毒液	瓶	10000	25.1 = 251000
15	二氯异氰尿酸钠（优虑净）	包	6000	3.6 = 21600
16	84 消毒液	瓶	15000	2.4 = 36000
17	体温枪	把	2000	55 = 110,000
18	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸 检测试剂盒（荧光 PCR 法）	人份	26000	13 = 338000
19	病毒 RNA 提取试剂（县医院）	人份	17000	10 = 170,000
20	病毒 RNA 提取试剂（疾控中心）	人份	9000	22 = 198000
21	病毒采样管	人份	26000	3 = 78000
22	采样吸头（100ul 带滤芯）	个	13000	0.3 = 3900
23	采样吸头（1000ul 带滤芯）	个	13000	0.3 = 3900
24	新冠抗体检测试剂盒	人份	50000	13.5 = 675000
总价	¥: 3441950元			

竞标人：广西柳州医药股份有限公司

竞标人代表（签字）：

李智

3441950

售后服务承诺书

为了认真贯彻落实国家相关法律法规，保证产品及售后服务质量，我公司特做出以下承诺：

一、质量和配送承诺：

1、我公司提供的产品符合适用的法定质量标准，包装、标签、说明书和合格证明等符合国家有关规定，并提供相关产品证明资料（加盖公章），对其真实性、有效性负责，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2、我公司按照国家规定开具发票，发票应当列明商品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等，不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。

3、我公司按所供产品的储存运输要求送货，保证运输过程中产品的质量。

4、我公司全年 365 天，天天 24 小时全天候供货，急需医疗物资 2 小时之内送达，并协助将药品堆放好，保证供货量，决不断货。

二、物资轮换承诺：

1. 我公司建立应急医疗物资储备 24 小时值班制度，设立 24 小时值班电话，并由专人负责。值班电话及负责人信息另报武宣县应急医疗物资储备管理部门备案。

2. 我公司在接到武宣县应急医疗物资储备管理部门下达的应急医疗物资储备商品的调用通知单后，应于 1 小时内快速响应，最迟不超过 2 小时，将医疗物资配送到武宣县区内指定地点，并按照相关规定办理交接手续。

如遇中毒、爆炸、交通事故等特殊情况导致医疗物资不能按时配送到位的，必须及时向武宣县应急医疗物资储备管理部门报告。

三、售后服务承诺

1. 武宣县应急医疗物资储备管理部门接到药监部门质量查询时,我公司 30 分钟内答复,必要时提供相关证明材料
2. 我公司提供的产品,凡在质量保证期内,由于产品原因导致的人身伤害及财产损失,生产厂家承担全部责任,使用过程中出现的任何问题或疑问,可通过售后电话咨询,公司保证接到用户提议 30 分钟内做出回应并及时反馈解决方案。
3. 我公司接到药监部门要求召回的商品通知后,当天内通知购买方退回。

