

二、开标一览表

项目名称：智能防菌医用空间配套设施项目

项目编号：WZZC2022-G1-30005-GCTF

供应商名称：广东华展家具制造有限公司


所投分标（如有）：无

单位：元

项号	货物名称		数量及单位 ①		品牌	规格型号		制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
	产品名称	部品名称				规格	型号					
										【一】二层		
										（一）大堂		
1	医用护士站	护士站主体	10.05	米	华展医疗	10050*27 0/660*73 7/1137	HZ00 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，▲抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前挡板 (4) ▲符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试	5286.00	53124.30



									验,耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。		
	医用防菌人造石-上台面	7.09	米	华展医疗	7090*300	HZ001-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面:采用医用防菌人造石,厚度12mm,医用防菌人造石:符合GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准:抗菌率:大肠杆菌99.2%、铜绿假单胞菌99.8%、金黄色葡萄球菌99.4%,耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到0级。	863.00	6118.67
	医用防菌人造石-下台面	10.05	米	华展医疗	10050*700	HZ001-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	11426.85
	单门单抽柜	4	个	华展医疗	400*450*710	HZ001-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:整体材质采用电解钢板 (2)整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理,抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率:大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐腐蚀。 (3)结构:柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 (4)配件:304不锈钢门铰+导轨+锁具;▲导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(加载:推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ,120000次)。▲门铰(铰链)符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (5)▲单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(加载:推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ,160000次)。	1089.00	4356.00
	主机柜(带抽)	4	个	华展医疗	300*450*700	HZ001-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:整体材质采用电解钢板 (2)整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理,抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率:大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球	998.00	3992.00



									菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) ▲主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 160000 次)。			
		三抽柜	2	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ00 1-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。	1180.00	2360.00
		钢制键 盘架	4	个	华展 医疗	标准	HZ00 1-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) ▲钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。	277.00	1108.00
		SUS316 不锈钢 踢脚线	10.05	米	华展 医疗	10050*1 0*120	HZ00 1-8	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。	224.00	2251.20



									(3) 整体符合: ▲316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(二) 门诊			
2	医用护士站	护士站主体	4.75	米	华展医疗	4750*270 /660*737 /1137	HZ00 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m ³ , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	25061.00
		医用防菌人造石-上台面	2.3	米	华展医疗	2300*300	HZ00 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015 《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018 《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、	863.00	1984.90



		医用防 菌人造 石-下台 面	4.75	米	华展 医疗	4750*700	HZ00 2-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉 菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球 毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	5400.75
		单门单 抽柜	2	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ00 2-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通 过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积× 0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推 拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家 具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 （加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000 次）。	1089.00	2178.00
		主机柜 （带 抽）	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ00 2-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通	998.00	1996.00



									用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。			
		钢制键盘架	2	个	华展医疗	标准	HZ00 2-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	4.75	米	华展医疗	4750*110 *120	HZ00 2-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	1064.00
		定制灯箱（电解钢）	4.75	米	华展医疗	4750*300 *400	HZ00 2-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，▲电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附	1915.00	9096.25



									着力1级, ③规定塑性延伸强度207MPa, 抗拉强度333MPa, 断后伸长率34.0%, ④化学成分: C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
3	医用更衣柜	医用更衣柜	5.38	米	华展医疗	5380*400*1800	HZ003	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用E1级环保15mm饰面刨花板, ▲饰面刨花板: 符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量0.024mg/m ³ , 静曲强度14.4MPa, 弹性模量2890MPa, 内结合强度0.33MPa, 密度0.65g/cm ³ , 表面胶合强度0.83MPa, 握螺钉力板面1270N, 板边1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用2.0mm厚PVC封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合: 医用更衣柜: 符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。	5864.00	31548.32
(三) 影像科												
4	医用护士站	护士站主体	2.24	米	华展医疗	2240*270/660*737/1137	HZ005-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板 (4) 符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、	5276.00	11818.24



									GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用防菌人造石-上台面	2.24	米	华展医疗	2240*300	HZ005-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	1933.12
	医用防菌人造石-下台面	2.24	米	华展医疗	2240*700	HZ005-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	2546.88
	单门单抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ005-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T	1089.00	1089.00



									3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （5）单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。			
		主机柜 （带抽）	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ00 5-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。	998.00	1996.00
		钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ00 5-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.24	米	华展 医疗	2240*110 *120	HZ00 5-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm （2）工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。	224.00	501.76




									(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
		定制灯箱（电解钢）	2.24	米	华展医疗	2240*300*400	HZ005-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	1915.00	4289.60
									(四) 急诊			
5	医用护士站	护士站主体	2.63	米	华展医疗	2630*270/660*737/1137	HZ006-01	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度	5276.00	13875.88



									0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m ³ , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用防菌人造石-上台面	1.3	米	华展医疗	1300*300	HZ006-02	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	1121.90
	医用防菌人造石-下台面	2.63	米	华展医疗	2630*700	HZ006-03	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	2990.31
	单门单抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ006-04	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 304 不锈钢门铰+导轨+锁具; 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 × 0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。	1089.00	1089.00



									(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。		
	主机柜 (带抽)	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ00 6-05	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。	998.00	1996.00
	钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ00 6-06	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。	277.00	554.00
	SUS316 不锈钢 踢脚线	2.63	米	华展 医疗	2630*110 *120	HZ00 6-07	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈	224.00	589.12




									钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
		定制灯箱（电解钢）	2.63	米	华展医疗	2630*300*400	HZ006-08	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	1915.00	5036.45
									(五) 输液大厅			
6	肌注室	医用肌注台（带软包）	2	米	华展医疗	2000*600*750	HZ007	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。 ▲理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。 2. 柜体：柜体采用知名医用电解钢板，钢板厚度 0.8mm-1.0mm。柜门采用一字型折弯拉手。	8164.00	16328.00



									<p>3. 柜体喷涂：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>4. 工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板（以加强台面支撑）、采用双层门板设计，内嵌门板工艺，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用 2.0 厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受 50KG 一体成型柜门拉手采用与门板同长度的一字型折弯拉手，组装后与门板平齐。柜门内置缓冲功能，与柜体的贴合更加紧密。</p> <p>5. 五金：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉内能放置 45KG 负载重量。</p>			
									(六) 配液室			
7	医用配餐柜 (30人)	医用配餐柜 (30人)	1.8	米	华展医疗	1800*550*1850	HZ008	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>1. 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>2. 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p>	5066.00	9118.80



									3.封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4.整体符合：▲医用配餐柜符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
医用吊柜	医用吊柜	4.45	米	华展医疗	4450*350*550	HZ009	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：▲医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	11761.35
医用背架	医用背架	4.45	米	华展医疗	4450*45*1850	HZ010	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	7809.75



		理化板 台面	2	米	华展 医疗	2000*650	HZ01 1-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	2642.00
	医用垃 圾处置 柜	医用垃 圾处置 柜	2	米	华展 医疗	2000*630 *837	HZ01 1-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：▲医用垃圾处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检	4401.00	8802.00



										出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。		
		感应式垃圾柜 (组件)	5	套	华展医疗	标准	HZ01 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置: 采用 PP 垃圾盖, 双杆支撑开启方式, 电动感应配件一套。	440.00	2200.00
										【二】三层		
										(一) 抽血室		
8	医用抽血台	理化板台面	1.3	米	华展医疗	1300*600	HZ01 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1710.80
		医用地柜	1.3	米	华展医疗	1300*570*750	HZ01 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:	4401.00	5721.30



									通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。			
									（5）整体符合：▲医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									（二）妇检室			
9	医用垃圾处置柜	理化板台面	1.75	米	华展医疗	1750*600	HZ01 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2303.00
		医用垃圾处置柜	1.75	米	华展医疗	1750*630*337	HZ01 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球	4401.00	7701.75



									<p>菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰(铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm³, 120000 次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(10 万次)。</p> <p>(5) 整体符合: 医用垃圾处置柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验(循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。</p>			
		感应式垃圾柜(组件)	2	套	华展医疗	标准	HZ01 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置: 采用 PP 垃圾盖, 双杆支撑开启方式, 电动感应配件一套。	440.00	880.00
										(三) 收费处		
10	医用护士站	护士站主体	2.92	米	华展医疗	2920*660*757	HZ01 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球	5276.00	15405.92




									<p>菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m³, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用防菌人造石-下台面	2.92	米	华展医疗	2920*700	HZ015-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。</p>	1137.00	3320.04
	单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ015-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件: 304 不锈钢门铰+导轨+锁具; 导轨符合</p>	1089.00	2178.00



									GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。			
		主机柜 （带抽）	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ01 5-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。	998.00	1996.00
		钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ01 5-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。	277.00	554.00



		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.92	米	华展 医疗	2920*110 *120	HZ01 5-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	654.08
										(四) B 超		
11	医用护 士站分 诊台	护士站 分诊台 主体	2.65	米	华展 医疗	2650*270 /660*737 /1137	HZ01 6-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前挡板 (4) 整体符合▲医用护士站分诊台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、洞钉（预留孔、选择孔除外）	5276.00	13981.40
		医用防 菌人造	1.5	米	华展 医疗	1500*300	HZ01 6-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015 《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018 《塑料 塑料防霉剂	863.00	1294.50



		石-上台面							的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。			
		医用防菌人造石-下台面	2.65	米	华展医疗	2650*700	HZ016-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	3013.05
		单门单抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ016-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000 次）。	1089.00	1089.00
		主机柜（带抽）	2	个	华展医疗	300*450*710	HZ016-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000 次）。	998.00	1996.00
		钢制键盘架	2		华展医疗		HZ016-6	广东华展家具制造	广东省清	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符	277.00	554.00



							有限公司	远市	合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。		
	SUS316 不锈钢踢脚线	2.65	米	华展医疗	2650*110*120	HZ016-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	593.60
	定制灯箱（电解钢）	2.65	米	华展医疗	2650*300*400	HZ016-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、	1915.00	5074.75



									Mn(%)0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									(五) 孕产保健			
12	医用护士站分诊台	护士站分诊台主体	2.95	米	华展医疗	2950*660*737	HZ017-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前挡板 (4) 整体符合医用护士站分诊台符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊疤表面波纹应均匀, 冲压件应无脱层、裂缝, 喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度: 应无剥落、裂纹、皱纹, 结构安全: 人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角, 固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、洞钉(预留孔、选择孔除外)	5276.00	15564.20
		医用防菌人造石-下台面	2.95	米	华展医疗	2950*700	HZ017-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到0级。	1137.00	3354.15
		主机柜(带抽)	3		华展医疗	800*450*710	HZ017-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大	998.00	2994.00




									<p>肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>		
	钢制键盘架	3	个	华展医疗	标准	HZ017-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：框架+路轨+托盘</p> <p>(4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。</p>	277.00	831.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	2.95	米	华展医疗	2950*110*120	HZ017-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	224.00	660.80
	定制灯箱（电解钢）	2.95		华展医疗	2950*300*400	HZ017-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧</p>	1915.00	5649.25



									低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
13	医用储物柜	医用储物柜	5.07	米	华展医疗	5070*400*2580	HZ018	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。304 不锈钢踢脚线， (2) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边 (3) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (4) 配置：层板四层+柜体+门板+锁具	6612.00	33522.84
										【三】四层		
										(一) 儿保科		
14	医用护士站	护士站主体	4.31	米	华展医疗	4310*270*660*737/1137	HZ019-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球	5276.00	22739.56



									<p>菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m³, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用防菌人造石-上台面	1.95	米	华展医疗	1950*300	HZ019-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。</p>	863.00	1682.85
	医用防菌人造石-下台面	4.31	米	华展医疗	4310*700	HZ019-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p>	1137.00	4900.47
	单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ019-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p>	1089.00	2178.00

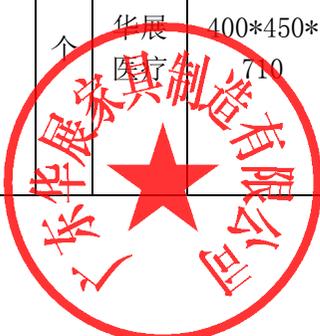

									<p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>		
	主机柜 (带抽)	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ01 9-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>	998.00	1996.00
	钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ01 9-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：框架+路轨+托盘</p> <p>(4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验</p>	277.00	554.00



									(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000次)。			
		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.31	米	华展 医疗	4310*110 *120	HZ01 9-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	965.44
		定制灯 箱(电 解钢)	4.31	米	华展 医疗	4310*300 *400	HZ01 9-8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体, 亚克力透光板, LED 灯及变压器, 电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019 《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 冲压件应无脱层、裂缝, ②金属喷漆(塑)涂层: 硬度 2H, 附着力 1 级, ③规定塑性延伸强度 207MPa, 抗拉强度 333MPa, 断后伸长率 34.0%, ④化学成分: C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	1915.00	8253.65
									(二) 配血室			
15	医用配 血室操 作台	理化板 台面	3	米	华展 医疗	3000*600	HZ02 0-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量	1316.00	3948.00




									0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
		医用地柜	3	米	华展医疗	3000*630*837	HZ02 0-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材，表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂，1.5*40*60 mm 优质方型钢材，表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂。 (2) 柜体、柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (3) 实验室专用配电检修结构设计。 (4) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。	4401.00	13203.00
									(三) 诊室			
16	医用治疗柜 1	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*350*550	HZ02 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未	2643.00	6607.50



									检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ02 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	4387.50
		理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ02 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	3290.00
		医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ02 1-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线	4401.00	11002.50



									<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ02 1-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	572.50
17	医用治疗柜 2	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*150*550	HZ02 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球</p>	2643.00	6607.50




									<p>菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具</p> <p>(5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验(循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ02 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 框架+层板</p>	1755.00	4387.50
	理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ02 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m³, 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色(A类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色(A类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。</p>	1316.00	3290.00



									<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	11002.50	
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150*837	HZ02 2-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈</p>	229.00	572.50



									钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
18	医用治疗柜 3	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*350*550	HZ02 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	6607.50
		医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ02 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	4387.50
		理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ02 3-3	广东华展家具制造	广东省清	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造	1316.00	3290.00

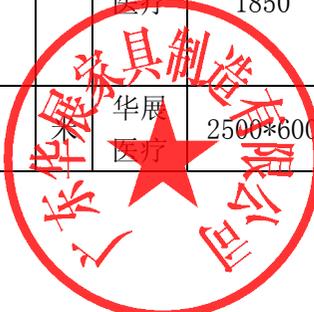

							有限公司	远市	板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。			
		医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ023-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理， 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》 抗菌率： 大肠杆菌 99.9%、 铜绿假单胞菌 >99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。 喷粉涂层厚度 60-80um， 经高温流平、 固化等工序， 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置： 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件： 导轨+锁具+门铰（铰链）； 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准： 通过推拉构件耐久性试验（加载： 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³， 120000 次）。 门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准： 通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合： 医用地柜： 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 标准： 甲醛释放量未检出， 苯未检出， 甲苯未检出， 二甲苯未检出， TVOC 0.022mg/m³， 家具涂层可迁移元素： 铅 Pb 未检出， 镉 Cd 未检出， 铬 Cr 未检出， 汞 Hg 未检出， 锑 Sb 未检出， 钡 Ba307.4mg/kg， 硒 Se 未检出， 砷 As 未检出， 通过结构和底架强度试验， 通过跌落试验， 通过搁板垂直加</p>	4401.00	11002.50



									载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.5	米	华展 医疗	2500*150	HZ02 3-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	572.50
19	医用治 疗柜 4	医用吊 柜	2.5	米	华展 医疗	2500*350 *550	HZ02 5-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性	2643.00	6607.50



									等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ025-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	4387.50
		理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ025-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	3290.00
		医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ025-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。	4401.00	11002.50



									(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ02 5-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	572.50
20	医用治疗柜 5	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*350*550	HZ02 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产	2643.00	6607.50



									品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ026-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	4387.50
	理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ026-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、起泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	3290.00
	医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ026-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。	4401.00	11002.50



									<p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ02 6-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	572.50
(四) 盆底康复中心												



21	医用治疗柜	医用背架	2.43	米	华展医疗	2430*45*1850	HZ027-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	4264.65
		理化板台面	2.43	米	华展医疗	2430*600	HZ027-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	3197.88
		医用地柜	2.43	米	华展医疗	2430*630*837	HZ027-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿	4401.00	10694.43



									色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.43	米	华展 医疗	2430*150	HZ02 7-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	556.47
22	医用治 疗柜	医用吊 柜	1.8	米	华展 医疗	1800*350 *550	HZ02 8-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未	2643.00	4757.40



									检出,二甲苯未检出,TVOC未检出,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,钡Ba313.4mg/kg,硒Se未检出,砷As未检出,通过结构和底架强度试验,通过跌落试验,通过搁板垂直加载稳定性试验,通过拉门耐久性试验(循环次数320000次),耐霉菌等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用背架	1.8	米	华展医疗	1800*45*1850	HZ028-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:整体材质采用电解钢板 (2)整体采用喷涂工艺:采用医用抑菌粉末喷涂处理,喷粉涂层厚度60-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐腐蚀。 (3)结构配置:框架+层板	1755.00	3159.00
		理化板台面	1.8	米	华展医疗	1800*600	HZ028-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)台面:采用12mm理化板台面,边缘双层加厚。理化板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试塑料表面抗菌测试方法》标准:甲醛释放量0.04mg/m ³ ,耐磨:磨耗值54mg/100r,素色磨350r,应无露底现象,耐冷热循环:无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色(A类),耐水蒸气:无凸起、龟裂和明显变色(A类)抗菌率:大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2368.80
		医用地柜	1.8	米	华展医疗	1800*630*837	HZ028-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:整体材质采用电解钢板 (2)整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理,抑菌粉末符合HG/T3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率:大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐腐蚀。 (3)结构配置:由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线	4401.00	7921.80



									<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		SUS316 不锈钢踢脚线	1.8	米	华展医疗	1800*150	HZ02 8-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	412.20
23	医用护士站	护士站主体	1.9	米	华展医疗	1900*660*737	HZ02 9-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球</p>	5276.00	10024.40



									<p>菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m³, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用防菌人造石-下台面	1.9	米	华展医疗	1900*700	HZ029-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。</p>	1137.00	2160.30
	主机柜(带抽)	2	个	华展医疗	300*450*710	HZ029-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件: 导轨+锁具+合页</p>	998.00	1996.00



									(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。			
		钢制键盘架	2	个	华展医疗	标准	HZ029-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷漆涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	1.9	米	华展医疗	1900*110*120	HZ029-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	425.60
		定制灯箱（电解钢）	1.9	米	华展医疗	1900*300*400	HZ029-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱	1915.00	3638.50




									层、裂缝,②金属喷漆(塑)涂层:硬度 2H,附着力 1 级,③规定塑性延伸强度 207MPa,抗拉强度 333MPa,断后伸长率 34.0%,④化学成分: C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42,⑤耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
24	医用操作台 (资料柜)	医用吊柜	2.87	米	华展 医疗	2870*350 *550	HZ03 0-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质:整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理,抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率:大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um,经高温流平、固 化等工序,使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置:由柜体+门板 (4) 五金配件:导轨+锁具 (5) 整体符合:医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金 属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产 品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定 法》标准: 甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未 检出,二甲苯未检出,TVOC 未检出,家具涂层可迁移 元素:铅 Pb 未检出,镉 Cd 未检出,铬 Cr 未检出,汞 Hg 未检出,锑 Sb 未检出,钡 Ba313.4mg/kg,硒 Se 未检出,砷 As 未检出,通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验,通过搁板垂直加载稳定性试验,通过 拉门耐久性试验(循环次数 320000 次),耐霉菌性 等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青 霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	7585.41
		医用背架	2.87	米	华展 医疗	2870*45* 1850	HZ03 0-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质:整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺:采用医用抑菌粉末喷涂处 理,喷粉涂层厚度 60-80um,经高温流平、固化等工 序,使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置:框架+层板	1755.00	5036.85



		理化板 台面	2.87	米	华展 医疗	2870*600	HZ03 0-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	3776.92
		医用地 柜	2.87	米	华展 医疗	2870*630 *837	HZ03 0-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡	4401.00	12630.87



									Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.87	米	华展医疗	2870*150	HZ03 0-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	657.23
25	医用被服柜	医用被服柜	2.3	米	华展医疗	2300*400*2450	HZ03 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	6612.00	15207.60
									(五) 检验科实验操作台			
									(六) 更衣室			
26	医用更衣柜	医用更衣柜	3	米	华展医疗	3000*400*1800	HZ03 2	广东华展家具制造	广东省清	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料人	5864.00	17592.00

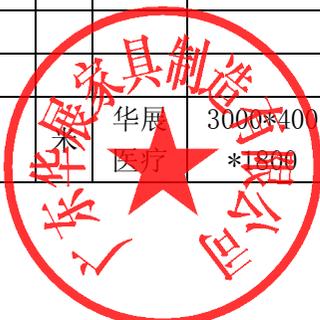

		(25人)					有限公司	远市	造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：▲医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
27	医用换鞋凳	医用换鞋凳	1.5	米	华展医疗	1500*350*450	HZ033	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：▲医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状	1975.00	2962.50



									青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									(七) 微量元素室			
28	医用实验台	理化板台面	4.61	米	华展医疗	4610*600	HZ03 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	6066.76
		医用实验柜 (柜体)	4.61	米	华展医疗	4610*570 *850	HZ03 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (5) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 (6) 整体符合▲医用实验台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.015mg/m ³ , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba333.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过桌面水平耐久性试验 (加力 300N, 循环次数 30000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	4401.00	20288.61



29	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6102AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	881.00
30	防酸碱PP水槽	防酸碱PP水槽	1	个	华展医疗	445*340*290	HZ037	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	440.00
31	抗菌防酸碱挡水	抗菌防酸碱挡水	1	套	华展医疗	500*500*40	HZ038	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用理化板材质, 12.7mm 厚。	651.00	651.00
32	LAB 桌上型单口洗眼器	LAB 桌上型单口洗眼器	1	个	华展医疗	标准	HZ039	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 金属材质。 (2) 洗眼喷头: 金属材质。外加软性橡胶, 出水经缓压处理避免二次伤害。 (3) 水流锁定开关: 水流开启、锁定功能一次完成, 手释放后持续供水。 (4) 控水阀: 为限流型止逆阀门, 防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里, 造成污水污染眼睛的二次伤害。 (5) 防尘盖: PP 材质, 使用时自动被水冲开。 (6) 供水软管: 1.5 米, 软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网, 防生锈及漏水。外层包裹 PE 管, 耐强腐蚀, 不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水, 同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下, 15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。	1320.00	1320.00
33	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	1	个	华展医疗	550*400	HZ040	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 高密度 PP, 款式新颖, 有现代感, (2) 类型: 单面, (3) 底部托盘中间设有排水孔, (4) 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 27/52 根, 有三种不同功能及长度的滴水棒, 方便不同规格的器皿挂放, (5) 安装方式: 壁挂式/台式,	660.00	660.00




										(八) 高效液相室		
34	医用实 验台	理化板 台面	4.6	米	华展 医疗	4600*600	HZ04 2-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m³，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。</p>	1316.00	6053.60
		医用实 验柜 (柜 体)	4.6	米	华展 医疗	4600*570 *850	HZ04 2-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (5) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 (6) 整体符合医用实验台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.015mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba333.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	20244.60
										(九) 体液室		




35	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	5.43	米	华展医疗	5430*600	HZ04 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	7145.88
		医用边台	5.43	米	华展医疗	5430*570 *850	HZ04 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	23897.43
36	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	3.35	米	华展医疗	3350*600	HZ04 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	4408.60
		医用边台	3.35	米	华展医疗	3350*570 *850	HZ04 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。	4401.00	14743.35



									(3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。			
37	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	3.35	米	华展医疗	3350*600	HZ04 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	4408.60
		医用边台	3.35	米	华展医疗	3350*570 *850	HZ04 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	14743.35
38	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6102 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	881.00
39	防酸碱 PP 水槽	防酸碱 PP 水槽	1	个	华展医疗	445*340* 290	HZ04 8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	440.00



40	抗菌防酸碱挡水	抗菌防酸碱挡水	1	套	华展医疗	500*500*40	HZ049	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用理化板材质，12.7mm 厚。	651.00	651.00
41	LAB 桌上型单口洗眼器	LAB 桌上型单口洗眼器	1	个	华展医疗	标准	HZ050	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体：金属材质。 (2) 洗眼喷头：金属材质。外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 (3) 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。 (4) 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 (5) 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开。 (6) 供水软管：1.5 米，软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹 PE 管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。	1320.00	1320.00
42	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	1	个	华展医疗	550*400	HZ051	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：高密度 PP，款式新颖，有现代感， (2) 类型：单面， (3) 底部托盘中间设有排水孔， (4) 可拆卸式滴水棒，滴水棒 27/52 根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， (5) 安装方式：壁挂式/台式，	660.00	660.00
43	实验室紧急冲淋装置	实验室紧急冲淋装置	1	套	华展医疗	标准	HZ052	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：304 不锈钢材质（不含接水池）	14885.00	14885.00
(十) 无菌室												
44	LAB 钢木防酸	理化板台面	6.38	套	华展医疗	6380*600	HZ053-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实	1316.00	8396.08



	碱操作边台								实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
	医用边台	6.38	米	华展医疗	6380*570*850	HZ05 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	28078.38	
45	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.18	米	华展医疗	1175*600	HZ05 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	1552.88
		医用边台	1.18	米	华展医疗	1175*570*850	HZ05 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。	4401.00	5193.18



									(3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。			
46	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6102AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	881.00
47	防酸碱PP水槽	防酸碱PP水槽	1	个	华展医疗	445*340*290	HZ057	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	440.00
48	防菌防酸碱挡水	防菌防酸碱挡水	1	套	华展医疗	500*500*40	HZ058	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用理化板材质, 12.7mm 厚。	651.00	651.00
49	LAB 桌上型单口洗眼器	LAB 桌上型单口洗眼器	1	个	华展医疗	标准	HZ059	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 金属材质。 (2) 洗眼喷头: 金属材质。外加软性橡胶, 出水经缓压处理避免二次伤害。 (3) 水流锁定开关: 水流开启、锁定功能一次完成, 手释放后持续供水。 (4) 控水阀: 为限流型止逆阀门, 防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里, 造成污水污染眼睛的二次伤害。 (5) 防尘盖: PP 材质, 使用时自动被水冲开。 (6) 供水软管: 1.5 米, 软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网, 防生锈及漏水。外层包裹 PE 管, 耐强腐蚀, 不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水, 同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下, 15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。	1320.00	1320.00
50	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	1	个	华展医疗	550*400	HZ060	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 高密度 PP, 款式新颖, 有现代感, (2) 类型: 单面, (3) 底部托盘中间设有排水孔, (4) 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 27/52 根, 有三种不	660.00	660.00



									同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， (5) 安装方式：壁挂式/台式，			
51	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.6	米	华展医疗	1600*600	HZ06 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	2105.60
		医用边台	1.6	米	华展医疗	1600*570 *850	HZ06 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	7041.60
(十一) 生化、免疫室												
52	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.2	米	华展医疗	1200*600	HZ06 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1579.20



		医用边台（带两个主机柜（带抽））	1.2	米	华展医疗	1200*570*850	HZ06 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	5281.20
53	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	7.01	米	华展医疗	7010*600	HZ06 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	9225.16
		医用边台	7.01	米	华展医疗	7010*570*850	HZ06 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	30851.01
54	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	9.6	米	华展医疗	9600*600	HZ06 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量	1316.00	12633.60



									0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
		医用边台	9.6	米	华展医疗	9600*570*850	HZ06 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	42249.60
55	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.81	米	华展医疗	1810*600	HZ06 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2381.96
		医用边台	1.81	米	华展医疗	1810*570*850	HZ06 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	7965.81



56	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	4.2	米	华展医疗	4200*600	HZ067-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	5527.20
		医用边台	4.2	米	华展医疗	4200*570*850	HZ067-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	18484.20
57	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	3	个	洁博利	标准	GBL-6102AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	2643.00
58	防酸碱 PP 水槽	防酸碱 PP 水槽	3	个	华展医疗	445*340*290	HZ069	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	1320.00
59	防菌防酸碱挡水	防菌防酸碱挡水	3	套	华展医疗	500*500*40	HZ070	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用理化板材质, 12.7mm 厚。	651.00	1953.00
60	LAB 桌上型单	LAB 桌上型单	3	套	华展医疗	标准	HZ071	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 金属材质。 (2) 洗眼喷头: 金属材质。外加软性橡胶, 出水经缓压处理避免二次伤害。	1320.00	3960.00



	口洗眼器	口洗眼器							<p>(3) 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。</p> <p>(4) 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。</p> <p>(5) 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开。</p> <p>(6) 供水软管：1.5 米，软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹 PE 管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。</p>			
61	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	3	个	华展医疗	550*400	HZ07 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：高密度 PP，款式新颖，有现代感，</p> <p>(2) 类型：单面，</p> <p>(3) 底部托盘中间设有排水孔，</p> <p>(4) 可拆卸式滴水棒，滴水棒 27/52 根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放，</p> <p>(5) 安装方式：壁挂式/台式，</p>	660.00	1980.00
62	LAB 钢木防酸碱操作边台	LAB 钢木防酸碱操作边台（无下台）	1.8	米	华展医疗	1800*700*850	HZ07 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。</p> <p>(2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。</p> <p>(3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。</p> <p>(4) 实验室专用配电检修结构设计。</p> <p>(3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。</p>	4401.00	7921.80
										(十二) 标本接收		
63	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	4.3	米	华展医疗	1300*600	HZ07 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测</p>	1316.00	5658.80



									试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。			
		医用边台	4.3	米	华展医疗	4300*570*850	HZ07 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质： 采用 16mm 厚中密度纤维板， 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺： 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚： 实验室专用抗氧化橡胶地脚， 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置： 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	18924.30
64	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	5.75	米	华展医疗	5750*600	HZ07 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面： 采用 12mm 理化板台面， 边缘双层加厚。 理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、 GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	7567.00
		医用边台	5.75	米	华展医疗	5750*570*850	HZ07 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质： 采用 16mm 厚中密度纤维板， 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺： 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚： 实验室专用抗氧化橡胶地脚， 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。	4401.00	25305.75



									(3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。			
									【四】五层			
									(一) 儿科康复			
65	医用护士站	护士站主体	4.82	米	华展医疗	4820*270 /660*737 /1137	HZ07 7-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m ³ , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	25430.32
		医用抗菌人造石-上台面	3.3	米	华展医疗	3300*300	HZ07 7-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用医用抗菌人造石, 厚度 12mm, 医用抗菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	2847.90
		医用抗菌人造	4.82	米	华展医疗	4820*700	HZ07 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	5480.34




		石-下台面											
		单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ077-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>	1089.00	2178.00	
		主机柜（带抽）	2	个	华展医疗	300*450*710	HZ077-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>	998.00	1996.00	
		三抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ077-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	1180.00	1180.00	



									(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 304 不锈钢门铰+导轨+锁具 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。		
	钢制键盘架	2	个	华展医疗	标准	HZ07 7-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷涂涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。	277.00	554.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	4.82	米	华展医疗	4820*110 *120	HZ07 7-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	1079.68
	定制灯箱 (电解钢)	4.82	米	华展医疗	4820*300 *400	HZ07 7-9	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体, 亚克力透光板, LED 灯及变压器, 电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致,	1915.00	9230.30



									应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
66	医用更衣柜	医用更衣柜	2.44	米	华展医疗	2440*400*1800	HZ078	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5864.00	14308.16
									(二) 更衣室			
67	医用更衣柜	医用更衣柜	2.5	米	华展医疗	2500*400*1800	HZ079	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表	5864.00	14660.00



									面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
(三) 测试室												
68	儿保测试软包床	儿保测试软包床（带软包，踢脚 200mm）	2.5	米	华展医疗	2500*1600*800	HZ080	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	1. 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 2. 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。 3. 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	11090.00	27725.00
(四) 医生办												
69	医用操作台	理化板台面	2.9	米	华展医疗	2900*650	HZ081-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测	1321.00	3830.90




									试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。			
		医用地柜	2.9	米	华展医疗	2900*630*837	HZ08 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质： 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理， 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》 抗菌率： 大肠杆菌 99.9%、 铜绿假单胞菌 >99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。 喷粉涂层厚度 60-80um， 经高温流平、 固化等工序， 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置： 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件： 导轨+锁具+门铰（铰链）； 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准： 通过推拉构件耐久性试验（加载： 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³， 120000 次）。 门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准： 通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合： 医用地柜： 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出， 苯未检出， 甲苯未检出， 二甲苯未检出， TVOC 0.022mg/m³， 家具涂层可迁移元素： 铅 Pb 未检出， 镉 Cd 未检出， 铬 Cr 未检出， 汞 Hg 未检出， 锑 Sb 未检出， 钒 Ba307.4mg/kg， 硒 Se 未检出， 砷 As 未检出， 通过结构和底架强度试验， 通过跌落试验， 通过搁板垂直加载稳定性试验， 通过拉门耐久性试验， 耐霉菌性等</p>	4401.00	12762.90




									级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		转角下柜（带台面）	1	个	华展医疗	900*900*900	HZ08 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。</p>	4401.00	4401.00



		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.9	米	华展 医疗	2900*150	HZ08 1-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	664.10
										(五) 接种室		
70	医用资 料柜	医用资 料柜	3.06	米	华展 医疗	3060*400 *2850	HZ08 2	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	4313.00	13197.78
71	接种室 台柜	理化板 台面	2.3	米	华展 医疗	2300*600	HZ08 3-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、	1316.00	3026.80

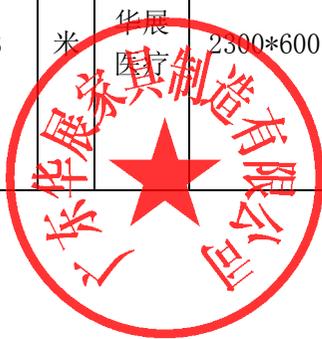

									起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
		医用地柜	2.3	米	华展医疗	2300*630*837	HZ083-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。</p>	4401.00	10122.30

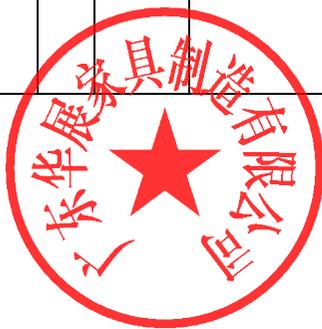

		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.3	米	华展 医疗	2300*150	HZ08 3-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	526.70
		理化板 台面	1.92	米	华展 医疗	1920*600	HZ08 5-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2526.72
72	接种台	医用地 柜	1.92	米	华展 医疗	1920*630 *837	HZ08 5-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合	4401.00	8449.92




								<p>GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>（5）整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
		SUS304 踢脚线	1.92	米	华展 医疗	1920*150	HZ08 5-3	<p>广东省清 远市</p> <p>广东华展 家具制造 有限公司</p> <p>（1）材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm （2）工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合▲304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；</p>	226.00	433.92
（六）诊室区										




73	医用打包台	医用打包台	6.3	米	华展医疗	6300*800*800	HZ086	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 打包台软垫: 选用医用级高密度定型海绵一体发泡成型, 弹性好, 不易变形, 成型板: 用高频热压机将多层木皮涂胶层叠后热压成型, 成型效果好, 不易变形、开裂, 面料: 优质超纤皮, 皮的颜色按实物为准, 门板: 医用级 16mm 刨花板为基材, 耐划、耐热、耐污、防褪色, 环保性能好。 (2) 人性化设计, 颜色亮丽。	4408.00	27770.40
(七) 牙科诊室												
74	医用牙科边柜	理化板台面	8.34	米	华展医疗	8340*530	HZ087-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	10975.44
		医用牙科边柜 (下柜)	8.34	米	华展医疗	8340*500*837	HZ087-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 × 0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通	4401.00	36704.34



									<p>过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>（5）整体符合：▲医用牙科边柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.5mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		医用分类垃圾柜组件	2	个	华展医疗	标准	HZ08 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）配置：采用 PP 垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。	440.00	880.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	8.34	米	华展医疗	8340*150	HZ08 7-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>（2）工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>（3）整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	1909.86
75	医用治疗柜（两个电脑位）	医用吊柜	2	米	华展医疗	2000*350*550	HZ08 8-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>（2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	2643.00	5286.00



									<p>(3) 结构配置：由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具</p> <p>(5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		医用背架	2	米	华展医疗	2000*45*1850	HZ08-8-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：框架+层板</p>	1755.00	3510.00
		理化板台面	2	米	华展医疗	2000*600	HZ08-8-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m³，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。</p>	1316.00	2632.00
		医用地柜	2	米	华展医疗	2000*630*2375	HZ08-8-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉</p>	4401.00	8802.00



							有限公司	远市	<p>末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	SUS316 不锈钢踢脚线	2	米	2000*150	HZ08 8-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、</p>	229.00	458.00	



										皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。		
										【五】六~十二层		
										(一) 护士站		
76	医用护士站	护士站主体	26.25	米	华展医疗	3750*270 /660*737 /1137	HZ08 9-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前档板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	138495.00
		医用防菌人造石-上台面	18.55	米	华展医疗	2650*300	HZ08 9-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	16008.65
		医用防菌人造	26.25	米	华展医疗	3750*700	HZ08 9-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	29846.25



		石-下台面										
		单门单抽柜	7	个	华展医疗	400*450*710	HZ089-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>	1089.00	7623.00
		主机柜（带抽）	14	个	华展医疗	300*450*710	HZ089-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>	998.00	13972.00
		三抽柜	7	个	华展医疗	400*450*710	HZ089-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	1180.00	8260.00



									(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。		
	钢制键 盘架	14	个	华展 医疗	标准	HZ08 9-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷涂涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。	277.00	3878.00
	SUS316 不锈钢 踢脚线	26.25	米	华展 医疗	3750*110 *120	HZ08 9-8	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	5880.00
	定制灯 箱 (电 解钢)	26.25	米	华展 医疗	3750*300 *400	HZ08 9-9	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体, 亚克力透光板, LED 灯及变压器, 电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致,	1915.00	50268.75



									应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	理化板 台面	15.4	米	华展 医疗	2200*600	HZ08 9-10	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	20266.40
	电脑操 作台柜 体	15.4	组	华展 医疗	2200*570 *750	HZ08 9-11	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 柜体：柜体采用知名医用电解钢板，钢板厚度 0.8mm-1.0mm。柜门采用一字型折弯拉手。 (2) 喷涂，采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点颜色根据院方要求。 (3) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板（以加强台面支撑）、采用双层门板设计，内嵌门板工艺，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用 2.0 厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受 50KG 一体成型柜门拉手采用与门板同长度的一	3961.00	60999.40



									字型折弯拉手，组装后与门板平齐。柜门内置缓冲功能，与柜体的贴合更加紧密。 (4)五金：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉内能放置 45KG 负载重量。			
		SUS304 踢脚线	15.4	米	华展 医疗	2200*120	HZ08 9-12	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)< 0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；	226.00	3480.40
77	护士站 储物柜	理化板 台面	26.25	米	华展 医疗	3750*600	HZ09 0-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	34545.00
		医用地 柜	26.25	米	华展 医疗	3750*570 *750	HZ09 0-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉	4401.00	115526.25



							有限公司	远市	<p>末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 × 0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
		SUS316 不锈钢踢脚线	26.25	米	3750*120	HZ09 0-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、</p>	224.00	5880.00



									皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(二) 治疗室			
78	医用治疗柜	医用吊柜	42.35	米	华展医疗	6050*350*550	HZ09 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	111931.05
		医用背架	42.35	米	华展医疗	6050*45*1850	HZ09 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	74324.25
		理化板台面	42.21	米	华展医疗	6030*600	HZ09 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实	1316.00	55548.36



广东华展家具制造有限公司

									<p>实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m³， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。</p>			
		医用地柜	42.21	米	华展医疗	6030*630*837	HZ091-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质： 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理， 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》 抗菌率： 大肠杆菌 99.9%、 铜绿假单胞菌 >99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。 喷粉涂层厚度 60-80um， 经高温流平、 固化等工序， 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置： 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件： 导轨+锁具+门铰（铰链）； 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准： 通过推拉构件耐久性试验（加载： 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³， 120000 次）。 门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准： 通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合： 医用地柜： 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 标准： 甲醛释放量未检出， 苯未检出， 甲苯未检出， 二甲苯未检出， TVOC 0.022mg/m³， 家具涂层可迁移元素： 铅 Pb 未检出， 镉 Cd 未检出， 铬 Cr 未检出， 汞 Hg 未检出， 锑 Sb 未检出， 钡 Ba307.4mg/kg， 硒 Se 未检出， 砷 As 未检出， 通过结构和底架强度试验， 通过跌落试验， 通过搁板垂直加载稳定性试验， 通过拉门耐久性试验， 耐霉菌性等</p>	4401.00	185766.21



									级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。		
	转角下柜（带台面）	14	个	华展医疗	900*900*900	HZ09 1-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）	4401.00	61614.00
	PP水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ09 1-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）高密度的PP注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理：有皮纹、与台面板纹一样。壁厚5mm，水槽底部7mm。 +下水装置一套	440.00	3080.00
	感应水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL-6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	（1）材质：不锈钢材质；感应距离15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24弯管520MM	881.00	6167.00
	亚克力挡水	7	套	华展医疗	500*500*200	HZ09 1-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：采用亚克力材质。	742.00	5194.00
	SUS316不锈钢踢脚线	42.21	米	华展医疗	6030*150	HZ09 1-9	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、	229.00	9666.09



									皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(三) 处置室			
79	医用垃圾处置柜	理化板台面	26.67	米	华展医疗	3810*650	HZ09 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	35231.07
		医用垃圾处置柜	26.67	米	华展医疗	3810*630*837	HZ09 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用垃圾处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检	4401.00	117374.67



									出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。		
	PP 水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ09 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 高密度的 PP 注塑成型, 耐腐蚀、耐酸碱和有机物. 槽沿处理: 有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm, 水槽底部 7mm. +下水装置一套	440.00	3080.00
	感应水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL- 6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 材质: 不锈钢材质; 感应距离 15CM、主体外径: 45MM、高度: 390MM、24 弯管 520MM	881.00	6167.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	26.67	米	华展医疗	3810*150	HZ09 2-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫 <0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	6107.43
	亚克力挡水	7	套	华展医疗	500*500* 200	HZ09 2-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用亚克力材质。	742.00	5194.00
	感应式垃圾柜	35		华展医疗	标准	HZ09 2-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置: 采用 PP 垃圾盖, 双杆支撑开启方式, 电动感应配件一套。	440.00	15400.00




		(组 件)										
										(四) 更衣室		
80	医用更 衣柜	医用更 衣柜	35	米	华展 医疗	5000*400 *1800	HZ09 3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	5864.00	205240.00
81	通道储 物柜 (非标 定制)	通道储 物柜 (鞋、 被服 柜，非 标定 制)	26.32	米	华展 医疗	3760*400 *2500	HZ09 5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p>	6749.00	177633.68



									(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
									(五) 医生办			
82	智能感应洗手操作台	理化板台面	12.74	米	华展医疗	1820*600	HZ09 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	16765.84
		医用洗手台	12.74	米	华展医疗	1820*450 *850	HZ09 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	3564.00	45405.36
		PP 水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ09 6-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 高密度的 PP 注塑成型, 耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理: 有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm, 水槽底部 7mm。 +下水装置一套	440.00	3080.00
		感应水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL- 6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 材质: 不锈钢材质; 感应距离 15CM、主体外径: 45MM、高度: 390MM、24 弯管 520MM	881.00	6167.00



		亚克力挡水	7	套	华展医疗	500*500*200	HZ096-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用亚克力材质。	742.00	5194.00
		SUS304踢脚线	12.74	米	华展医疗	1820*150	HZ096-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；	226.00	2879.24
										(六) 餐厅		
83	医用配餐柜	理化板台面	27.86	米	华展医疗	3980*600	HZ097-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	36663.76
		配餐台柜体	27.86	米	华展医疗	3980*450*850	HZ097-2	广东华展家具制造	广东省清	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板， (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用	3564.00	99293.04

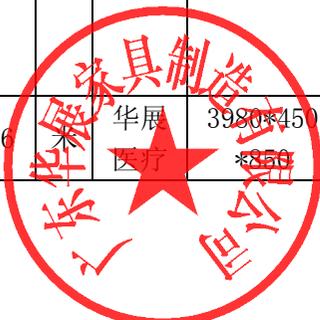

							有限公司	远市	<p>三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>（3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>（4）医用配餐柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	PP 水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ09 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）高密度的 PP 注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理：有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm，水槽底部 7mm。</p> <p>+下水装置一套</p>	440.00	3080.00
	手动水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL- 6115 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	<p>（1）材质：不锈钢材质；</p>	660.00	4620.00
	SUS304 踢脚线	27.86	米	华展医疗	3980*100	HZ09 7-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>（2）工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>（3）整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，</p>	226.00	6296.36



										断后伸长率 55%；化学成分：C (%)0.061、S (%) < 0.002、P (%)0.011、Si (%)0.35、Mn (%)0.73，抗菌率大肠杆菌 >99.99%、铜绿假单胞菌 >99.99%、金黄色葡萄球菌 >99.99%；		
										【六】七~八层		
84	智能雾化操作台	智能雾化操作台	14	台	华展医疗	800*600*1200	HZ098	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	雾化桌 (1) 雾化台采用 16mm~25mm 厚的医用抗菌刨花板。 (2) 每位雾化台含卡通型订制式 9 寸 1024*600 显示器内存卡 16G ,内带动画及儿歌。	6247.00	87458.00
85	雾化操作椅	雾化操作椅	14	张	华展医疗	标准	HZ099	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 一体成型塑钢材质	445.00	6230.00
										【七】九~十层		
86	避难间医用治疗柜	医用吊柜	6	米	华展医疗	3000*350*550	HZ100-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性	2643.00	15858.00



									等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用背架	6	米	华展医疗	3000*45*1850	HZ10 0-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	10530.00
		理化板台面	6	米	华展医疗	3000*600	HZ10 0-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	7896.00
		医用地柜	6	米	华展医疗	3000*630*837	HZ10 0-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。	4401.00	26406.00



									(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钒 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	6	米	华展医疗	3000*150	HZ10 0-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	1374.00
										【八】十一层		
87	检查室治疗操作台	医用吊柜	3.6	米	华展医疗	3600*350*550	HZ10 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金	2643.00	9514.80



广东华展家具制造有限公司

									属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba313.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数320000次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。		
	医用背架	3.6	米	华展医疗	3600*45*1850	HZ10 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	6318.00
	理化板台面	3.6	米	华展医疗	3600*600	HZ10 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	4737.60
	医用地柜	3.6	米	华展医疗	3600*630*837	HZ10 1-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固	4401.00	15843.60



								<p>化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>				
		SUS316 不锈钢踢脚线	3.6	米	华展医疗	3600*150	HZ10 1-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	824.40



88	医用垃圾处置柜	理化板台面	1.35	米	华展医疗	1350*650	HZ10 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	1783.35
		医用垃圾处置柜	1.35	米	华展医疗	1350*630 *837	HZ10 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用垃圾处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检	4401.00	5941.35




										出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。		
		感应式垃圾柜 (组件)	3	套	华展医疗	标准	HZ10 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置: 采用 PP 垃圾盖, 双杆支撑开启方式, 电动感应配件一套。	440.00	1320.00
89	洗婴室	圆润型游泳池	3	套	华展医疗	900*790	HZ10 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面及功能背板全部采用 PMMA 高分子材料, 用模具吸塑一次性成型。	3191.00	9573.00
		平底无人形洗婴盆	2	套	华展医疗	1000*790	HZ10 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用亚克力材质, 一体注塑成型。	3211.00	6422.00
		医用洗婴台	8.43	米	华展医疗	8425*750 *837	HZ10 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板, 防潮防水, 经久耐用, 0.8mm 厚 316# 不锈钢底座, 医用耐磨皮软包饰面, (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件: 一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链 (门铰)、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头, 一体成型洗婴池 3 个, 游泳池 2 个、打包台, (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合: ▲医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.088mg/m ³ , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 铋 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌	5804.00	48927.72



									面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用洗 婴台软 包	3.9	米	华展 医疗	3900*790 *100	HZ10 3-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	3307.20
	医用洗 婴台	2	米	华展 医疗	2000*100 0*837	HZ10 3-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm 厚 316# 不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	8365.00	16730.00
	医用洗 婴台软 包	2.04	米	华展 医疗	2040*790 *100	HZ10 3-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	927.00	1891.08



		给排水工程标配套装	5	套	华展医疗	常规	HZ10 3-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 五金配件: 排水管、PP-R 冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材, 2、工艺/其他说明: 按每个接水点计算。(不含现场预留)。 (2) 现场: 下水及进水只有一个点位。	268.00	1340.00
										【九】十二层		
90	检查室治疗操作台	医用吊柜	3.6	米	华展医疗	3600*350*550	HZ10 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板 (4) 五金配件: 导轨+锁具 (5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	9514.80
		医用背架	3.6	米	华展医疗	3600*45*1850	HZ10 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	6318.00



		理化板 台面	3.6	米	华展 医疗	3600*600	HZ10 5-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	4737.60
		医用地 柜	3.6	米	华展 医疗	3600*630 *837	HZ10 5-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡	4401.00	15843.60



									Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	3.6	米	华展医疗	3600*150	HZ10 5-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	824.40
91	医用垃圾处置柜	理化板台面	1.35	米	华展医疗	1350*650	HZ10 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	1783.35
		医用垃圾处置柜	1.35	米	华展医疗	1350*630*837	HZ10 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚	4401.00	5941.35



									线 (4)五金配件:导轨+锁具+门铰(铰链);导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(加载:推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ,120000次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (5)整体符合:医用垃圾处置柜:符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准:甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出,TVOC未检出,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,硒Se未检出,砷As未检出,通过结构和底架强度试验,通过跌落试验,通过搁板垂直加载稳定性试验,通过拉门耐久性试验(循环次数320000次),耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到0级。			
		感应式垃圾柜(组件)	3	套	华展医疗	标准	HZ106-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)配置:采用PP垃圾盖,双杆支撑开启方式,电动感应配件一套。	440.00	1320.00
92	洗婴室	圆润型游泳池	3	套	华展医疗	900*790	HZ107-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)台面及功能背板全部采用PMMA高分子材料,用模具吸塑一次性成型。	3191.00	9573.00
		平底无人形洗婴盆	2	套	华展医疗	1000*790	HZ107-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:采用亚克力材质,一体注塑成型。	3211.00	6422.00
		医用洗婴台	8.43	套	华展医疗	8425*750*837	HZ107-3	广东华展家具制造	广东省清	(1)材质:0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板,防潮防水,经久耐用,0.8mm厚316#不锈钢底座,医用耐	5804.00	48927.72



							有限公司	远市	磨皮软包饰面， (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用洗婴台软包	3.9	米	华展医疗	3900*790*100	HZ107-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	3307.20
	医用洗婴台	2	米	华展医疗	2000*1000*837	HZ107-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm 厚 316# 不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿	8365.00	16730.00



									色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，硒Se未检出，砷As未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力300N，循环次数30000次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用洗 婴台软 包	2.04	米	华展 医疗	2040*790 *100	HZ10 7-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	927.00	1891.08
		给排水 工程标 配套装	5	套	华展 医疗	常规	HZ10 7-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 五金配件：排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材，2、工艺/其他说明：按每个接水点计算。（不含现场预留）。 (2) 现场：下水及进水只有一个点位。	268.00	1340.00
										【十】十三层		
										(一) 产房		
93	防菌不 锈钢台 柜	不锈钢 上柜	8.4	米	华展 医疗	1200*300 *600	HZ10 8-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 (2) 门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 (3) 配件：优质铰链+锁具。	3520.00	29568.00
		不锈钢 中柜	8.4	米	华展 医疗	1200*300 *550	HZ10 8-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 (2) 门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 (3) 配件：优质铰链+锁具。	2199.00	18471.60



		不锈钢下柜	8.4	米	华展医疗	1200*650*850	HZ108-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 采用医用防菌 304 不锈钢板, 厚度 0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺, 没有外露焊点。 (2) 门板均为双层不锈钢复合式工艺, 符合卫生学, 不易藏污纳垢, 易于清洁, 杜绝卫生死角。 (3) 配件: 优质铰链+锁具。	7924.00	66561.60
										(二) 污物通道		
94	医用垃圾处置柜	理化板台面	4.5	米	华展医疗	2250*650	HZ109-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1321.00	5944.50
		医用垃圾处置柜	4.5	米	华展医疗	2250*630*837	HZ109-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链) (5) 整体符合: 医用垃圾处置柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr	4401.00	19804.50



										未检出,汞Hg未检出,铋Sb未检出,硒Se未检出,砷As未检出,通过结构和底架强度试验,通过跌落试验,通过搁板垂直加载稳定性试验,通过拉门耐久性试验(循环次数320000次),耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到0级。		
		感应式垃圾柜(组件)	10	套	华展医疗	标准	HZ109-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)配置:采用PP垃圾盖,双杆支撑开启方式,电动感应配件一套。	440.00	4400.00
95	防菌不锈钢处置操作台	不锈钢下柜	2	米	华展医疗	2000*600*850	HZ110-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)主体:采用医用防菌304不锈钢板,厚度0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 (2)门板均为双层不锈钢复合式工艺,符合卫生学,不易藏污纳垢,易于清洁,杜绝卫生死角。 (3)配件:优质铰链+锁具。	7924.00	15848.00
		垃圾柜组件	2	套	华展医疗	标准	HZ110-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)配置:采用PP垃圾盖,双杆支撑开启方式,电动感应配件一套。	440.00	880.00
		胎盘处置(带锁)	1	套	华展医疗	标准	HZ110-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)整体采用304不锈钢材质。 (2)配置:铰链+锁具	693.00	693.00
									(三) 无菌库房			
96	库房	医用货柜	3.6	米	华展医疗	3600*400*1800	HZ111	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体采用0.8mm-1.0mm冷轧钢板。▲冷轧钢板符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:抗拉强度361MPa;规定塑性延伸强度272MPa,断后伸长率34%;化学成分:C(%)0.09、S(%)0.028、P(%)0.027、Al(%)0.029、Mn(%)0.41,金属喷漆(塑)涂层硬度2H;冲击强度(冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。 (2)工艺:整体采用电阻焊接工艺,没有外露焊	6517.00	23461.20



									点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正门面及抽屉间空隙在 2.0-2.5mm 之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到 90 度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受 50KG。折弯一体成型。			
									机械库房			
97	器械库房	医用不锈钢器械柜	2.8	米	华展医疗	2800*400*1800	HZ112	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体采用医用抗菌冷轧钢板，冷轧钢板符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：抗拉强度 361MPa；规定塑性延伸强度 272MPa，断后伸长率 34%；化学成分：C(%)0.09、S(%)0.028、P(%)0.027、Al(%)0.029、Mn(%)0.41，金属喷漆(塑)涂层硬度 2H；冲击强度（冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>(2) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正门面及抽屉间空隙在 2.0-2.5mm 之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到 90 度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受 50KG。折弯一体成型。</p> <p>(3) 整体符合：▲医用不锈钢器械柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：平整度 0.02mm，着地平稳性<0.02mm，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、漏钉(预留孔、选择孔除外)，金属电镀层抗盐雾：100h，1.5mm 以下锈点<20 点/dm² (距离边棱角缘 2mm 以内不计)，其中≥1.0mm 锈点<5 点/dm² (距离边棱角缘 2mm 以内不计)，通过搁</p>	6517.00	18247.60



									板定位试验, 通过搁板支承件强度试验, 通过结构和底架强度试验, 通过非固定柜空载稳定性, 通过非固定柜加载稳定性。			
									(五) 库房			
98	库房	医用货柜	2.68	米	华展医疗	2680*400*2570	HZ113	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体采用 0.8mm-1.0mm 冷轧钢板。冷轧钢板符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 抗拉强度 361MPa; 规定塑性延伸强度 272MPa, 断后伸长率 34%; 化学成分: C(%)0.09、S(%)0.028、P(%)0.027、Al(%)0.029、Mn(%)0.41, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 冲击强度(冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>(2) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 没有外露焊点。柜体需全封闭顶板, 以加强台面支撑, 柜体正面门及抽屉间空隙在 2.0-2.5mm 之间, 采用双层门板设计, 内嵌门板工艺, 柜门打开角度达到 90 度, 并且内有加强筋, 提高门的使用寿命, 层板加强筋可承受 50KG。折弯一体成型。</p>	6517.00	17465.56
									(六) 治疗室			
99	医用治疗柜	医用吊柜	5.26	米	华展医疗	5260*350*550	HZ115-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具</p> <p>(5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未</p>	2643.00	13902.18



									检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		医用背架	5.26	米	华展医疗	5260*45*1850	HZ115-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	9231.30
		理化板台面	4.16	米	华展医疗	4160*600	HZ115-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	5474.56
		医用地柜	4.16	米	华展医疗	4160*630*837	HZ115-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线	4401.00	18308.16



								<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
	转角下柜（带台面）	1	个	华展医疗	850*850*850	HZ115-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合</p>	4401.00	4401.00



									GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （5）整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	PP 水盆	1	个	华展医疗	标准	HZ11 5-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）高密度的 PP 注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理：有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm，水槽底部 7mm。 +下水装置一套	440.00	440.00
	感应水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL- 6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	（1）材质：不锈钢材质；感应距离 15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24 弯管 520MM	881.00	881.00
	亚克力挡水	1	套	华展医疗	500*500* 200	HZ11 5-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：采用亚克力材质。	742.00	742.00
	感应式垃圾柜（组件）	5	套	华展医疗	标准	HZ11 5-9	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）配置：采用 PP 垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。	440.00	2200.00



		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.16	米	华展 医疗	4160*150	HZ11 5-10	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	952.64
(七) 待产区												
100	医用护 士站	护士站 主体	4.34	米	华展 医疗	4340*270 /660*737 /1137	HZ11 6-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	22897.84




		医用防 菌人造 石-下台 面	4.34	米	华展 医疗	4340*700	HZ11 6-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	4934.58
		单门单 抽柜	2	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ11 6-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000 次）。	1089.00	2178.00
		主机柜 (带 抽)	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ11 6-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000 次）。	998.00	1996.00



		三抽柜	1	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ11 6-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。	1180.00	1180.00
		钢制键盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ11 6-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.34	米	华展 医疗	4340*110 *120	HZ11 6-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫 <0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	972.16
										(八) 换鞋室		



101	医用换鞋柜	医用换鞋柜(两组40人)	3	米	华展医疗	3000*350*1500	HZ117	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	4753.00	14259.00
(九) 更衣室间												
102	医用更衣柜(女)	医用吊柜	1	米	华展医疗	1000*300*600	HZ118-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2374.00	2374.00
		医用中柜	1	米	华展医疗	1000*300*550	HZ118-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放	1585.00	1585.00




									量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。		
	理化板台面	1	米	华展医疗	1000*600	HZ11 8-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、起泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1316.00
	医用地柜	1	米	华展医疗	1000*570 *850	HZ11 8-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。	3961.00	3961.00



									(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
		SUS304 踢脚线	1	米	华展 医疗	1000*100	HZ11 8-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)< 0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%;	226.00	226.00
103	医用更 衣柜	医用更 衣柜	1.35	米	华展 医疗	1350*400 *1800	HZ11 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合: 医用更衣柜: 符合 GB/T 1741-2020	5864.00	7916.40




									《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
104	医用更衣柜（男）	医用吊柜	2.72	米	华展医疗	2720*300*600	HZ120-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m ³ ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm ³ ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。	2374.00	6457.28
		医用中柜	2.72	米	华展医疗	2720*300*550	HZ120-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m ³ ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm ³ ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。	1585.00	4311.20
		理化板台面	2.72	米	华展医疗	2720*600	HZ120-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造	1316.00	3579.52

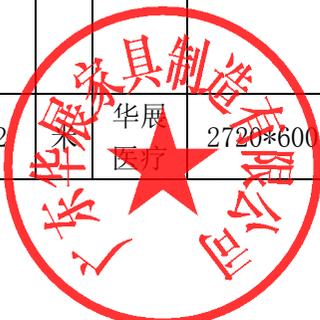

							有限公司	远市	板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，色素磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。		
	医用地柜	2.72	米	华展医疗	2720*570*850	HZ120-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	3961.00	10773.92
	SUS304 踢脚线	2.72	米	华展医疗	2720*100	HZ120-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm （2）工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力	226.00	614.72



									1级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%) < 0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率 大肠杆菌 >99.99%、铜绿假单胞菌 >99.99%、金黄色葡萄球菌 >99.99%;			
									(十) 走道			
105	医用护士站	护士站主体	2.5	米	华展医疗	2500*270 /660*737 /1137	HZ12 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m ³ , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	13190.00
		医用防菌人造石-上台面	1.5	米	华展医疗	1500*300	HZ12 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、	863.00	1294.50




		医用防 菌人造 石-下台 面	2.5	米	华展 医疗	2500*700	HZ12 1-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉 菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球 毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	2842.50
		单门单 抽柜	2	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ12 1-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通 过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积× 0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推 拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家 具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 （加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000 次）。	1089.00	2178.00
		主机柜 （带 抽）	1	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ12 1-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通	998.00	998.00



									用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000次）。			
		钢制键盘架	1	个	华展医疗	标准	HZ12 1-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。	277.00	277.00
		SUS316不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*110*120	HZ12 1-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳0.02%、硫<0.001%、磷0.014%、锰1.01%。	224.00	560.00
106	医用地柜	理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*650	HZ12 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟	1321.00	3302.50



									裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。		
	医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ12 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 $\times 0.35\text{kg}/\text{dm}^3$, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC $0.022\text{mg}/\text{m}^3$, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba$307.4\text{mg}/\text{kg}$, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	11002.50
	SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ12 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p>	229.00	572.50



									(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(十一) 治疗室			
107	医用治疗柜	医用吊柜	4	米	华展医疗	4000*350*550	HZ123-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性</p>	2643.00	10572.00



									等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用背架	4	米	华展医疗	4000*45*1850	HZ12 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	7020.00
		理化板台面	4	米	华展医疗	4000*600	HZ12 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	5264.00
		医用地柜	4	米	华展医疗	4000*630*837	HZ12 3-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。	4401.00	17604.00



									(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钒 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	4	米	华展医疗	4000*150	HZ12 3-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	916.00
										(十二) 资料室		
108	鞋衣柜	上衣柜、下鞋柜	1.21	米	华展医疗	1210*400*1800	HZ12 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐	5862.00	7093.02




									龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
									(十三) 检查室			
109	医用治疗柜	医用吊柜	1.8	米	华展医疗	1800*350*550	HZ12 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链） (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	4757.40
		医用背架	1.8	米	华展医疗	1800*45*1850	HZ12 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	3159.00



		理化板 台面	1.8	米	华展 医疗	1800*600	HZ12 6-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2368.80
		医用地 柜	1.8	米	华展 医疗	1800*630 *837	HZ12 6-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡	4401.00	7921.80




									Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	1.8	米	华展医疗	1800*150	HZ12 6-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	412.20
									【十一】十四层			
									(一) 办公走廊			
110	医用换鞋柜	医用换鞋柜(两组 20 人)	3.88	米	华展医疗	3880*350 *600	HZ12 7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2377.00	9222.76
111	医用换鞋凳	医用换鞋凳	1.8	米	华展医疗	1800*350 *500	HZ12 8	广东华展家具制造	广东省清	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人	1975.00	3555.00

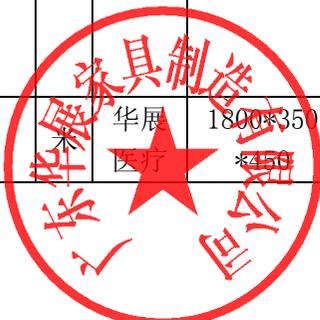

							有限公司	远市	造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
									(二) 女更衣室			
112	医用更衣柜	医用更衣柜	2	米	华展医疗	2000*400*1800	HZ129	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状	5864.00	11728.00



									青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									(三) 走廊缓冲间			
113	304 不锈钢防水医用换鞋柜一	304 不锈钢医用换鞋柜	0.95	米	华展医疗	950*350*1800	HZ130	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%;	5465.00	5191.75
									(四) 去污区缓冲间			
114	304 不锈钢防水医用换鞋柜二	304 不锈钢医用换鞋柜(10人)	1.09	米	华展医疗	1090*350*900	HZ131	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)<	5261.00	5734.49
115	304 不锈钢防水医用换鞋柜三	304 不锈钢医用换鞋柜(10人)	1.74	米	华展医疗	1740*350*900	HZ132	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)<	5261.00	9154.14

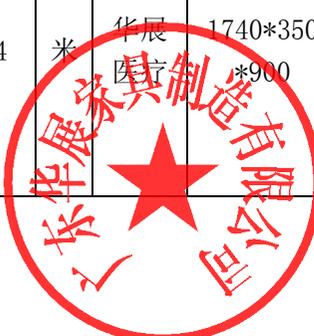

									0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；			
116	医用办公操作台	医用办公操作台（防撞式）	1	组	华展医疗	1400*600*750	HZ133-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 金属钢制脚：表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材</p> <p>(3) 配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。</p> <p>(4) 实验室专用配电检修结构设计。</p> <p>(5) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。</p>	4401.00	4401.00
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ133-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心率 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m³，软质聚</p>	529.00	529.00



									氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
									(五) 清洁打包区			
117	医用办公操作台	医用办公操作台（防撞式）	2	组	华展医疗	1200*600*750	HZ13 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。 (2) 金属钢制脚：表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材 (3) 配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (5) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。	4401.00	8802.00
		医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ13 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 (4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无	529.00	1058.00



									开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
									（六）） 无菌存放区			
118	医用办公操作台（防撞式）	医用办公操作台（防撞式）	1	组	华展医疗	1400*600*750	HZ136-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 金属钢制脚：表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材</p> <p>(3) 配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。</p> <p>(4) 实验室专用配电检修结构设计。</p> <p>(5) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。</p>	4401.00	4401.00
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常規	HZ136-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀</p>	529.00	529.00




									<p>镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝绉应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝绉对称部位应对称。缝绉线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m²h，TVOC 0.086mg/m²h。</p>			
									【十二】十五层			
									(一) 治疗室			
119	医用操作台	理化板台面	5.59	米	华展医疗	5590*600	HZ13 7-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m³，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 > 99.9%。</p>	1316.00	7356.44
		医用地柜	5.59	米	华展医疗	5590*630*227	HZ13 7-2	广东华展家具制造	广东省清	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉</p>	4401.00	24601.59



							有限公司	远市	<p>末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	转角下柜（带台面）	1	个	华展 医疗 器具 制造 有限公司	900*900* 837	HZ13 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	4401.00	4401.00



									<p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	感应式垃圾柜（组件）	4	套	华展医疗	标准	HZ13 7-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 配置：采用 PP 垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。</p>	440.00	1760.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	5.59	米	华展医疗	5590*150	HZ13 7-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、</p>	229.00	1280.11

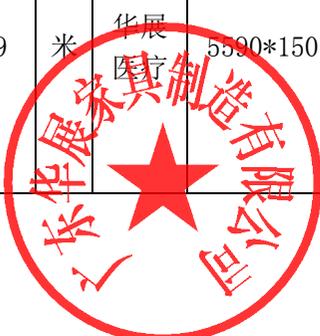

										皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。		
										(二) 洗婴室		
120	新生儿洗婴室	平底无人形洗婴盆	3	套	华展医疗	1000*790	HZ13 8-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用亚克力材质，一体注塑成型。	3211.00	9633.00
		医用洗婴台	6	米	华展医疗	5995*750 *837	HZ13 8-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm 厚 316# 不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5804.00	34824.00
		医用洗婴台软包	6.36	米	华展医疗	3175*790 *100	HZ13 8-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	5393.28



		给排水工程标配套装	3	套	华展医疗	常规	HZ13 8-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)五金配件:排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材,2、工艺/其他说明:按每个接水点计算。(不含现场预留)。 (2)现场:下水及进水只有一个点位。	268.00	804.00
121	隔离洗婴室	平底无人形洗婴盆	2	套	华展医疗	1000*790	HZ13 9-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:采用亚克力材质,一体注塑成型。	3211.00	6422.00
		医用洗婴台	7.95	米	华展医疗	7950*750*837	HZ13 9-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板,防潮防水,经久耐用,0.8mm厚316#不锈钢底座,医用耐磨皮软包饰面, (2)台面采用医用抑菌人造石材质 (3)配件:一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链(门铰)、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头,一体成型洗婴池3个,游泳池2个、打包台, (4)柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5)整体符合:医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准:甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出,TVOC 0.088mg/m ³ ,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,硒Se未检出,砷As未检出,通过主桌面垂直静载荷试验,通过桌面持续垂直静载荷试验,通过桌面垂直冲击试验,通过桌面水平耐久性试验(加力300N,循环次数30000次),耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。	5804.00	46141.80
		医用洗婴台软包	6.36	米	华展医疗	8075*790*100	HZ13 9-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:采用覆面采用优质耐磨皮,内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	5393.28



		给排水工程标配套装	2	套	华展医疗	常规	HZ139-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 五金配件: 排水管、PP-R 冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材, 2、工艺/其他说明: 按每个接水点计算。(不含现场预留)。 (2) 现场: 下水及进水只有一个点位。	268.00	536.00
										(三) 配奶室		
122	配奶室台柜	医用吊柜	1.27	米	华展医疗	1270*350*550+570	HZ140-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰(铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积 × 0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(10 万次)。 (5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验(循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	3356.61



		医用背架	1.27	米	华展医疗	1270*45*1850	HZ140-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	2228.85
		理化板台面	4.5	米	华展医疗	4500*600	HZ140-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	5922.00
		医用地柜	4.5	米	华展医疗	4500*630*837	HZ140-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿	4401.00	19804.50



									色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m ³ ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		转角下柜（带台面）	1	个	华展医疗	900*900*850	HZ140-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未</p>	4401.00	4401.00



									检出, 汞 Hg 未检出, 铋 Sb 未检出, 钡 Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		PP 水盆	1	个	华展医疗	标准	HZ14-0-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 高密度的 PP 注塑成型, 耐腐蚀、耐酸碱和有机物. 槽沿处理: 有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm, 水槽底部 7mm. +下水装置一套	440.00	440.00
		感应水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 材质: 不锈钢材质; 感应距离 15CM、主体外径: 45MM、高度: 390MM、24 弯管 520MM	881.00	881.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	4.5	米	华展医疗	4500*150	HZ14-0-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	1030.50
									(四) 消毒室			
123	消毒室台柜	医用吊柜	3.87	米	华展医疗	3870*350*550-570	HZ14-1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板	2643.00	10228.41




广东华展家具制造有限公司

									<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用背架	3.87	米	华展医疗	3870*45*1850	HZ14 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：框架+层板</p>	1755.00	6791.85
	理化板台面	3.87	米	华展医疗	3870*600	HZ14 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m³，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟</p>	1316.00	5092.92




									裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。		
	医用地柜	3.87	米	华展医疗	3870*630*837	HZ14 1-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰(铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm³, 120000 次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(10 万次)。</p> <p>(5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.022mg/m³, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	17031.87
	SUS316 不锈钢踢脚线	3.87	米	华展医疗	3870*150	HZ14 1-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p>	229.00	886.23

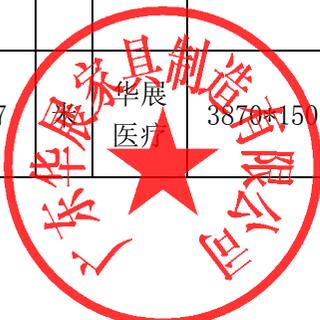

									(3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(五) 医生办			
124	医生办	医生操作台 (上中下)	7	组	华展 医疗	1200*600 *1800	HZ14 2-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>(1) 台面采用品牌 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。钢木组合结构, 主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材, 表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂, 1.5*40*60 mm 优质方型钢材, 表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂。</p> <p>(2) 柜体、柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺板, 以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板: 采用 16mm 厚的中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺板, 以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。</p> <p>(3) 实验室专用 220V 插座单插、双插、三插均有, 符合 IP44 要求。(此项为选配)</p> <p>(4) 铰链采用品牌缓冲铰链, 滑轨采用三节路轨, 铝合金暗拉手。</p> <p>(5) 水龙头: 实验室专用水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。水槽: 黑色, PP 材质。</p> <p>(6) 整体符合: 理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m³, 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循</p>	5281.00	36967.00



									环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。		
	医生工作椅	7	张	华展医疗	常规	HZ14 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒</p> <p>（2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>（3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>（4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度43mm，座面左右水平偏差1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝绉应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝绉对称部位应对称。缝绉线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面58.1kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N），应无倾翻，甲醛释放量0.012mg/m²h，TVOC 0.086mg/m²h。</p>	529.00	3703.00
	茶水柜	1	米	华展医疗	1000*400*350	HZ14 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放</p>	4458.00	4458.00



									<p>量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚：木制脚</p>			
									(六) 换床室			
125	医用护士站	护士站主体	4.15	米	华展医疗	4150*660*737	HZ143-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构：由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr</p>	5276.00	21895.40



									未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用防菌人造石-下台面	4.15	米	华展医疗	4150*700	HZ14 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，▲医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	4718.55
	单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ14 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，160000 次）。	1089.00	2178.00



		主机柜 (带抽)	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ14 3-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固 化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通 用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加 载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 160000 次)。	998.00	1996.00
		钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ14 3-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符 合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆 菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌> 99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等 工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家 具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.15	米	华展 医疗	4150*110 *120	HZ14 3-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈 钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现 象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、 皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	929.60




										(七) 医生谈话室		
126	医生操作台 (带2个电脑位)	理化板台面	2.51	米	华展医疗	2510*600	HZ14 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m³，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。</p>	1316.00	3303.16
		医用地柜	2.51	米	华展医疗	2510*570 *750	HZ14 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m³，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未</p>	4401.00	11046.51



									检出, 汞 Hg 未检出, 铋 Sb 未检出, 钡 Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
									(八) 餐厅			
127	用餐休息室	理化板台面	1.5	米	华展医疗	1500*600	HZ14 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m ³ , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1974.00
		配餐柜 1	1.5	米	华展医疗	1500*570 *850	HZ14 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	3961.00	5941.50



		SUS304 踢脚线	1.5	米	华展 医疗	1500*100	HZ14 6-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%) < 0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率大肠杆菌 >99.99%、铜绿假单胞菌 >99.99%、金黄色葡萄球菌 >99.99%;	226.00	339.00
		中柜 (双层)	1.7	米	华展 医疗	1700*300 *550	HZ14 6-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	1733.00	2946.10
		理化板 台面	1.7	米	华展 医疗	1700*600	HZ14 6-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实	1316.00	2237.20



									实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。		
	配餐柜 2	1.7	米	华展 医疗	1700*570 *850	HZ14 6-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	3961.00	6733.70
	SUS304 踢脚线	1.7	米	华展 医疗	1700*100	HZ14 6-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，	226.00	384.20



									断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；			
									(九) 女更衣室			
128	医用更衣柜	医用更衣柜(50人)	4.88	米	华展医疗	4880*400*1800	HZ147	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	5864.00	28616.32
129	医用鞋柜	医用鞋柜	3.8	米	华展医疗	3800*350*1800	HZ148	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐</p>	5862.00	22275.60




									<p>龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p>			
130	医用换鞋凳	医用换鞋凳	5.01	米	华展医疗	5010*350*600	HZ149	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	1975.00	9894.75
(十) 男更衣室												
131	医用鞋柜	医用鞋柜	2.5	米	华展医疗	2500*400*1800	HZ150	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐</p>	5862.00	14655.00



									<p>龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p>			
132	医用换鞋凳	医用换鞋凳	1.78	米	华展医疗	1780*350*450	HZ15 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	1975.00	3515.50
									【十三】十六层			
									(一) 家属等候区			
133	医用换鞋柜	医用换鞋柜（带门、上层有抽屉）	1.4	米	华展医疗	1400*350*1300	HZ15 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体采用医用冷轧钢板，</p> <p>(2) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正面门及抽屉间空隙在 2.0-2.5mm 之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到 90 度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受 50KG。折弯一体成型。</p>	4704.00	6585.60




									(3) 家具产品部分符合:GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准。			
									(二) 洁净走廊			
134	医用护士站	护士站主体	5.78	米	华展医疗	5780*270 /660*737 /1137	HZ15 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m ³ , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	30495.28
		医用防菌人造石-上台面	2.4	米	华展医疗	2400*300	HZ15 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	2071.20
		医用防菌人造石-下台面	5.78	米	华展医疗	5780*700	HZ15 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	6571.86

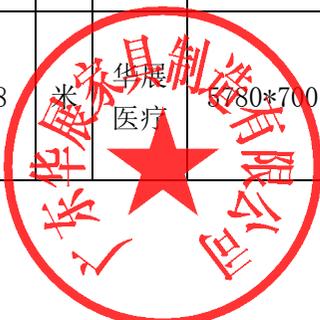

		单门单抽柜	3	个	华展医疗	400*450*710	HZ15 3-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>	1089.00	3267.00
		主机柜（带抽）	3	个	华展医疗	300*450*710	HZ15 3-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，160000 次）。</p>	998.00	2994.00
		三抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ15 3-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大</p>	1180.00	1180.00



									<p>肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件: 导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。</p>			
		钢制键盘架	3	个	华展医疗	标准	HZ15 3-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 框架+路轨+托盘</p> <p>(4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm³, 120000 次)。</p>	277.00	831.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	5.78	米	华展医疗	5780*110 *120	HZ15 3-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	224.00	1294.72
										(三) 用餐室		
135	用餐室	理化板台面	3.47	米	华展医疗	3470*600	HZ15 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实</p>	1316.00	4566.52

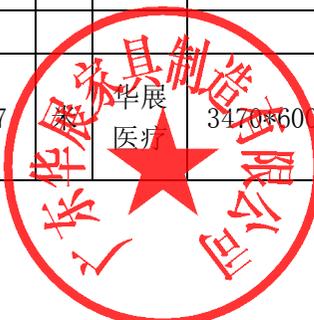

									实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m ³ ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。		
	医用配餐柜	3.47	米	华展医疗	3470*600*750	HZ15 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板， 饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准： 甲醛释放量 0.024mg/m ³ ， 静曲强度 14.4MPa， 弹性模量 2890MPa， 内结合强度 0.33MPa， 密度 0.65g/cm ³ ， 表面胶合强度 0.83MPa， 握螺钉力板面 1270N， 板边 1020N， 表面耐冷热循环无裂纹、 鼓泡、 变色、 起皱等， 表面耐香烟灼烧 4 级、 表面耐干热 5 级、 表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条， 全自动封边机完成封边。	3961.00	13744.67
	SUS304 踢脚线	3.47	米	华展医疗	3470*100	HZ15 5-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢， 厚度 0.8mm （2）工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准： 涂层应无漏喷、 锈蚀和脱色、 掉色现象； 涂层应光滑均匀， 色泽一致， 应无流挂、 疙瘩、 皱皮、 飞漆等缺陷； 冲压件应无脱层、 裂缝， 金属喷漆（塑）涂层硬度 2H； 附着力 1 级， 规定塑性延伸强度 286MPa； 抗拉强度 695MPa，	226.00	784.22



									断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；			
									(四) 女更衣室			
136	医用更衣柜	医用更衣柜	7.14	米	华展医疗	7140*400*1800	HZ156	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	5864.00	41868.96
									(五) 换鞋室			
137	换鞋室	医用鞋柜	5.19	米	华展医疗	5190*350*1800	HZ157-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱</p>	5862.00	30423.78



									等,表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件:采用缓冲门铰连接。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。			
		医用换鞋凳	1.89	米	华展医疗	1890*350*450	HZ157-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体:采用E1级环保15mm饰面刨花板,饰面刨花板:符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准:甲醛释放量0.024mg/m ³ ,静曲强度14.4MPa,弹性模量2890MPa,内结合强度0.33MPa,密度0.65g/cm ³ ,表面胶合强度0.83MPa,握螺钉力板面1270N,板边1020N,表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等,表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件:采用缓冲门铰连接。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。 (4)整体符合:医用换鞋凳符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准:耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。	1975.00	3732.75
									(六)男更衣室			
138	医用更衣柜	医用更衣柜	5.09	米	华展医疗	5090*400*1800	HZ158	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体:采用E1级环保15mm饰面刨花板,饰面刨花板:符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准:甲醛释放量0.024mg/m ³ ,静曲强度14.4MPa,弹性模量2890MPa,内结合强度0.33MPa,密度0.65g/cm ³ ,表面胶合强度0.83MPa,握螺钉力板面1270N,板边1020N,表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱	5864.00	29847.76



									等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
									【十四】二层			
									(一) 影像科			
139	医用办公操作台 1	医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ159	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 脚：金属钢制脚。	3785.00	7570.00



									(5) 整体符合: ▲医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。			
140	医生工作椅	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ160	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。 (4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心率 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无褶皱, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m ³ , 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m ² h, TVOC 0.086mg/m ² h。	529.00	1058.00
141	医用资料柜	医用资料柜	1.7		华展医疗	1700*400*1600	HZ161	广东华展家具制造有限公司	广东省清	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人	5146.00	8748.20



							有限公司	远市	造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门			
142	医用诊断桌	医用诊断桌	3	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ162	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合：▲医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检	4515.00	13545.00



									出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 镉 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。			
143	医生工作椅	医生工作椅	3	张	华展医疗	常规	HZ16 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m³, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m²h, TVOC 0.086mg/m²h。</p>	529.00	1587.00
144	医用诊断桌	医用诊断桌	1	组	华展医疗	1200*600 750	HZ16 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表</p>	3785.00	3785.00



									<p>面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p> <p>(5) 整体符合: 医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>			
145	医生工作椅	医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ16 6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m³, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验</p>	529.00	529.00



									(座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m ² h, TVOC 0.086mg/m ² h。		
									(二) 急诊		
146	值班室操作台 1	值班室操作台 (上中下)	1	组	华展医疗	1200*450 /300*180 0	HZ16 7-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	6979.00	6979.00
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ16 7-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。 (4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 <0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝绉应无破损, 无污迹、无脱线、无	529.00	529.00



									开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
147	床头柜	床头柜	1	组	华展 医疗	480*480* 750	HZ16 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	750.00	750.00
148	医用诊 断桌	医用诊 断桌	1	组	华展 医疗	1200*140 6*750	HZ16 9-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表	4515.00	4515.00




								面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合: 医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。		
	医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ16 9-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。 (4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m ³ , 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验	529.00	529.00



									(座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m ² h, TVOC 0.086mg/m ² h。		
149	医用诊室吊柜	医用诊室吊柜	2	米	华展医疗	2000*350*600	HZ170	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2094.00	4188.00
									(三) 收费处		
150	收费处	医用收费桌(主)	8.15	米	华展医疗	8150*600*750	HZ171-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。	5385.00	43887.75



									<p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合▲医用收费桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.1mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，</p>		
	医用收费桌（副）	5	米	华展医疗	5000*500*750	HZ17 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合医用收费桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.1mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，</p>	5385.00	26925.00
	资料柜	3	米	华展医疗	3000*400*1800	HZ17 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放</p>	5146.00	15438.00



									量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。		
									(四) 收费处 (改诊室)		
151	医用诊断桌	医用诊断桌	1	组	华展医疗	1200*140 0*750	HZ17 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。	4515.00	4515.00



		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ17 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无褶皱, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m³, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m²h, TVOC 0.086mg/m²h。</p>	529.00	529.00
(五) 输液大厅												
152	茶水柜	茶水柜	1	米	华展医疗	1000*400*850	HZ17 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边</p>	4458.00	4458.00



									1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 (4)脚：木制脚			
									【十五】三层			
									(一) 孕妇学校			
153	讲台	讲台	1.5	组	华展医疗	1500*800	HZ17 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m ³ ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm ³ ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。	6734.00	10101.00
154	医用换鞋柜	医用换鞋柜	3.3		华展医疗	8300*3300*500	HZ17 6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017	4912.00	16209.60



广东华展家具制造有限公司

									《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
155	展柜	展柜	3.33	米	华展医疗	3330*450*1800	HZ177	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	5734.00	19094.22
									(二) 诊室			
156	医用诊断桌	医用诊断桌	6	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ178	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边	4515.00	27090.00



共 10 页

								<p>1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p> <p>(5) 整体符合: 医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	6	张	华展医疗	常规	HZ179	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m³, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无</p>	529.00	3174.00



									倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m ² h, TVOC 0.086mg/m ² h。			
157	医用资料柜	医用资料柜	5.1	米	华展医疗	5100*400*1800	HZ180	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门	5146.00	26244.60
									【十六】四层			
									(一) 诊室			
158	医用资料柜	医用资料柜 (5 个)	4.25	米	华展医疗	4250*400*1800	HZ181	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。	5146.00	21870.50



									(2)五金配件:采用缓冲门铰连接。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。 (4)结构:活动层板3个,4门			
159	医用诊断桌	医用诊断桌	5	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ182	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体:采用E1级环保15mm饰面刨花板,饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准:甲醛释放量0.024mg/m ³ ,静曲强度14.4MPa,弹性模量2890MPa,内结合强度0.33MPa,密度0.65g/cm ³ ,表面胶合强度0.83MPa,握螺钉力板面1270N,板边1020N,表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等,表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件:采用缓冲门铰连接。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。 (4)钢脚桌脚 (5)整体符合:医用诊断桌符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准:甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出,TVOC未检出,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,钡Ba299.6mg/kg,硒Se未检出,砷As未检出。	4515.00	22575.00
		医生工作椅	5	张	华展医疗	常规	HZ183	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)主要材料说明:1、坐垫为网布,2、靠背采用聚丙烯注塑成型,黑色,3、海绵采用高密度原生态回弹海绵,密度为D40,4、底盘采用多功能底盘,钢板2.0mm厚,5、优质三级气压棒 (2)结构/配置:1、电镀活动五星脚架, (3)五金配件:钢质螺帽、不锈钢螺丝,表面镀镍。	529.00	2645.00



									(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
									(二) 盆底康复中心			
160	医用诊断桌	医用诊断桌	2	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ185	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚	4515.00	9030.00



									(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。			
		医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ186	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 (4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心率 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。	529.00	1058.00
(三) 会议室												



161	会议室	会议桌	2.6	米	华展 医疗	2600*120 0*750	HZ18 7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：▲会议桌符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度 0.06mm，底脚平稳性 0.1mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均 4 级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性 6 万次，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯 0.01mg/m³，二甲苯 0.003mg/m³，TVOC 0.1mg/m³。</p>	3341.00	8686.60
-----	-----	-----	-----	---	----------	-------------------	-----------	----------------------	------------	--	---------	---------



		会议椅	10	张	华展 医疗	常规	HZ18 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。	529.00	5290.00
162	医用资料柜	医用资料柜	3.3	米	华展 医疗	3300*400 *1800	HZ18 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门	5146.00	16981.80
(四) 主任办												
163	医用办公操作台	医用工作台	2	组	华展 医疗	1400*600 *750	HZ19 0	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐	3785.00	7570.00




								<p>龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚：金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合：医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba301.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ19 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应</p>	529.00	1058.00



									对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
164	医用资料柜	医用资料柜	1.2	米	华展医疗	1200*400*1800	HZ19 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	6175.20
									【十七】五层			
									(一) 通道			
165	哺乳室打包台	哺乳室打包台	1	米	华展医疗	1000*600*850	HZ19 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表	4514.00	4514.00




									面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
166	茶水柜	茶水柜	1	米	华展医疗	1000*400*850	HZ195	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 脚: 木制脚	4458.00	4458.00
									(二) 测试室			
167	医用诊断桌	医用诊断桌	4	米	华展医疗	1200*1400*750	HZ196	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017	4515.00	18060.00



								<p>《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p> <p>(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	4	张	华展医疗	常规	HZ197	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应</p>	529.00	2116.00



									对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。		
168	设备操作台 1	设备操作台	1	组	华展医疗	1400*800*750	HZ198	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 （1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	4922.00	4922.00
169	设备操作台 2	设备操作台（上中下，2 电脑位）	2.1	组	华展医疗	2100*600*1800	HZ199	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 （1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐	6601.00	13862.10



									龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
									(三) 接种室			
170	医用诊断桌	医用诊断桌	3	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ200	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。	4515.00	13545.00
		医生工作椅	3	张	华展医疗		HZ201	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀	529.00	1587.00



									<p>镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m²h，TVOC 0.086mg/m²h。</p>			
171	医用诊断桌	医用诊断桌	1	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ202	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p>	4515.00	4515.00



									(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。			
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ203	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 (4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心率 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。	529.00	529.00
(四) 诊室区												



172	医用诊断桌	医用诊断桌	6	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ205	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p> <p>(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>	4515.00	27090.00
		医生工作椅	6	张	华展医疗	常规	HZ206	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝绉应无破损，无污迹、无脱线、无</p>	529.00	3174.00



									开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
173	医用资料柜	医用资料柜	4	米	华展医疗	4000*400*1800	HZ207	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	20584.00
174	孕校展柜（非标定制）	孕校展柜（非标定制）	1.8	米	华展医疗	1800*400*2100	HZ208	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量	5914.00	10645.20



									2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。		
									【十八】六~十二层		
									(一) 医生办		
175	医生办	医用工作台	70	组	华展医疗	1100*1050*750	HZ209	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 脚: 金属钢制脚。 (5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017	3994.00	279580.00



									《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba301.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出。		
	医生工作椅	70	张	华展医疗	常规	HZ210	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度43mm，座面左右水平偏差1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面58.1kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N），应无倾翻，甲醛释放量0.012mg/m²h，TVOC0.086mg/m²h。</p>	529.00	37030.00
	会议桌	18.2	张	华展医疗	2600*1200*750	HZ211	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017	3341.00	60806.20



								<p>《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：会议桌符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度 0.06mm，底脚平稳性 0.1mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均 4 级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性 6 万次，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯 0.01mg/m³，二甲苯 0.003mg/m³，TVOC 0.1mg/m³。</p>		
		会议椅	56		HZ21 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢</p>	529.00	29624.00

									板 2.0mm 厚, 5、三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。		
		医用办公吊柜	53.13	米	华展医疗	7590*350*600	HZ213	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2094.00	111254.22
									(二) 主任办		
176	主任办	医用资料柜	20.79	米	华展医疗	2970*400*1800	HZ215	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市 (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自	5146.00	106985.34



									动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门		
	医用工作台	14	组	华展 医疗	1400*600 *750	HZ21 6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm³, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚: 金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>	3785.00	52990.00
	医生工作椅	14		华展 医疗		HZ21 7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢</p>	529.00	7406.00



									<p>板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m³, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m²h, TVOC 0.086mg/m²h。</p>		
	茶水柜	5.6	米	华展 医疗	800*400* 850	HZ21 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用</p>	4458.00	24964.80



									三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。			
									（3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
									（4）脚：木制脚			
									（三）餐厅			
177	用餐休息室	餐桌 (成品)	7	张	华展 医疗	1400*700 *750	HZ21 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）台面跟桌脚：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。	6991.00	48937.00
		餐椅	70	张	华展 医疗		HZ22 0	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。	440.00	30800.00
									（3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
									（1）优质 ABS 工程塑料一体成型组合椅。			



								有限公司	远市			
										(四) 护士长办		
178	护士长办	医用资料柜	20.93	米	华展医疗	2990*400*1800	HZ22 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 结构：活动层板 3 个，4 门</p>	5146.00	107705.78
		医用工作台	14	组	华展医疗	1400*600*750	HZ22 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T</p>	3785.00	52990.00



									3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （3）封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba301.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出。			
		医生工作椅	14	张	华展医疗	常规	HZ223	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度43mm，座面左右水平偏差1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾	529.00	7406.00



									翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
		茶水柜	5.6	米	华展 医疗	800*400* 850	HZ22 5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 （3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：木制脚	4458.00	24964.80
									【十九】十三层			
									（一）办公室			
179	办公室	医用工 作台	3	组	华展 医疗	1200*600 *750	HZ22 6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量	3785.00	11355.00



								<p>2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm³, 120000 次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(10 万次)。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚: 金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	3	张	华展医疗	常规	HZ22 7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性<0.02mm, 软、硬包</p>	529.00	1587.00



									件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
		矮柜	2.49	米	华展医疗	2490*400*990	HZ228	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。	4453.00	11087.97



									(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
									(二) 医生办公室			
180	医生办公室	医用工作台	3	组	华展医疗	1200*600*750	HZ229	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm³, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚: 金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>	3785.00	11355.00
		医生工作椅	3		华展医疗		HZ230	广东华展家具制造有限公司	广东省清	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态</p>	529.00	1587.00



							有限公司	远市	<p>回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m²h，TVOC 0.086mg/m²h。</p>			
		医用资料柜	4.05	米	华展医疗	4050*400*1800	HZ231	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p>	5146.00	20841.30



									(2)五金配件:采用缓冲门铰连接。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。 (4)结构:活动层板3个,4门			
									【二十】十四层			
									(一)护长办			
181	办公室	医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ23 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体:采用E1级环保15mm饰面刨花板,饰面刨花板:符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准:甲醛释放量0.024mg/m ³ ,静曲强度14.4MPa,弹性模量2890MPa,内结合强度0.33MPa,密度0.65g/cm ³ ,表面胶合强度0.83MPa,握螺钉力板面1270N,板边1020N,表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等,表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件:采用缓冲门铰连接,导轨采用医用三节路轨,抽拉自如,抽屉耐重。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。 (4)脚:金属钢制脚。 (5)整体符合:医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准:甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出,TVOC未检出,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,钡Ba301.4mg/kg,硒Se未检出,砷As未检出。	3785.00	7570.00
		医生工作椅	2		张	华展医疗		HZ23 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)主要材料说明:1、坐垫为网布,2、靠背采用聚丙烯注塑成型,黑色,3、海绵采用高密度原生态回弹海绵,密度为D40,4、底盘采用多功能底盘,钢板2.0mm厚,5、优质三级气压棒	529.00



广东华展家具制造有限公司

									<p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m³, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m²h, TVOC 0.086mg/m²h。</p>			
182	医用资料柜	医用资料柜	1.7	米	华展医疗	1700*400*1800	HZ235	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自</p>	5146.00	8748.20



									动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门			
									【二十一】十五层			
									(一) NICU 大厅			
183	NICU 大厅	医用工作台	4.25	米	华展医疗	4250*1200*750	HZ236	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm³, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚: 金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>	3341.00	14199.25



		医生工作椅	8	张	华展医疗	常规	HZ237	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m³, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m²h, TVOC 0.086mg/m²h。</p>	529.00	4232.00
184	医用资料柜	医用资料柜	1.2	米	华展医疗	1200*400*2560	HZ238	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m³, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm³, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱</p>	5535.00	6642.00



									等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门			
									(二) 主任办			
185	主任办	医用资料柜	1.7	米	华展医疗	1700*400*1800	HZ239	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	8748.20
		医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ240	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。	3785.00	7570.00



								<p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚：金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合：医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba301.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ24 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，</p>	529.00	1058.00



									软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
									(三) 护长办			
186	护长办	医用资料柜	1.7	米	华展医疗	1700*400*1800	HZ24 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	8748.20
		医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ24 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱	3785.00	7570.00



								<p>等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚：金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合：医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba301.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ24 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无</p>	529.00	1058.00



									倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m ² h, TVOC 0.086mg/m ² h。			
									(四) 餐厅			
187	医务配餐室	餐桌 (成品)	1	张	华展 医疗	1400*700 *750	HZ24 6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面跟桌脚: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m ³ , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm ³ , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	6991.00	6991.00
		餐椅	8	张	华展 医疗	常规	HZ24 7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 优质 ABS 工程塑料一体成型组合椅。	440.00	3520.00
									【二十二】十六层			
									(一) 会议室/避难间			



188	会议室 /避难间	会议桌	4.5	米	华展 医疗	4500*120 0*750	HZ24 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m³，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm³，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：会议桌符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度 0.06mm，底脚平稳性 0.1mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、起泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、起泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均 4 级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性 6 万次，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯 0.01mg/m³，二甲苯 0.003mg/m³，TVOC 0.1mg/m³。</p>	3341.00	15034.50
		会议椅	14	张	华展 医疗		HZ24 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p>	529.00	7406.00



									(3)五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。			
		医用资料柜	2.28	米	华展医疗	2280*400*1800	HZ250	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m ³ ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm ³ ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 (4)结构：活动层板3个，4门	5146.00	11732.88
									(二)用餐室			
189	医务配餐室	餐桌(成品)	1	张	华展医疗	1400*700*750	HZ251	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)台面跟桌脚：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m ³ ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm ³ ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(加载：推拉构件净空体积×	6991.00	6991.00



									0.35kg/dm ³ ，120000次)。门铰(铰链)符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。			
		餐椅	8	张	华展医疗	常规	HZ25 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 优质ABS工程塑料一体成型组合椅。	440.00	3520.00
										(三) 主任办		
190	医用办公操作台	医用办公操作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ25 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板。饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m ³ ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm ³ ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm ³ ，120000次)。门铰(铰链)符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (3) 封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构配置：左三抽柜+右主机柜	3785.00	7570.00
		医生工作椅	2		华展医疗	常规	HZ25 5	广东华展家具制造	广东省清	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯一次注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原	529.00	1058.00



							有限公司	远市	生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 (4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m ³ ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m ² h，TVOC 0.086mg/m ² h。			
191	医用资料柜	医用资料柜	0.85	米	华展医疗	850*400*1800	HZ256	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m ³ ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm ³ ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。	5146.00	4374.10



