



### 三、竞标报价表

项号	货物名称	单位	数量	品牌	技术参数及性能配置要求	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	全自动微生物鉴定药敏分析仪	台	1	碧迪 (BD)	<p>一、规格型号: BD Phoenix M 50</p> <p>二、响应</p> <p>▲1、细菌鉴定方法采用显色法与荧光法, 鉴定时间平均&lt;4小时, 准确率&gt;95%。</p> <p>2、能够鉴定细菌数 470 种, 能鉴定革兰氏阳性球菌, 革兰氏阳性杆菌; 革兰氏阴性发酵菌, 革兰氏阴性非发酵菌, 真菌, 链球菌等。</p> <p>3、鉴定实验一次性上机完成, 无需添加剂和附加实验。</p> <p>▲4、最快可以 1.5 小时内得到鉴定结果, 细菌平均鉴定时间仅为 3 小时。</p> <p>▲5、可进行超过 30 种链球菌的鉴定药敏检测, 可进行 16 种抗生素的药敏实验, 包括真正实测 MIC 值。</p> <p>6. 药敏检测方法采用氧化还原显色法与比浊法。</p> <p>7、能对革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性发酵菌, 革兰氏阴性非发酵菌进行药敏实验, 可以对总计 611 种细菌进行鉴定和/或药敏试验, 其中革兰氏阴性菌 272 种、革兰氏阳性菌 200 种、酵母菌 64 种、链球菌 75 种。</p> <p>▲8、药敏检测孔 85 孔; 检测药物采用对倍浓度稀释, 检测微生物真正的 MIC 实测浓度, 而非计算值。</p> <p>9、检测药物种类&gt;169 种, 每</p>	692000.00	692000.00	无

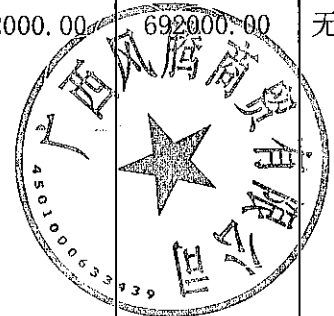

			<p>种药物具有 3 个浓度，可以提供多达 7 个浓度梯度。</p> <p>10、进行药敏实验的同时，能检测包含 ESBL、MRSA、VRE、BL、HLSR、HLGR 在内的 20 多种细菌耐药机制，而不需要另外附加耐药机制检测板，细菌耐药机制检测无需附加实验确认。</p> <p>11、能够进行延迟耐药菌的判断与药敏检测。</p> <p>12、仪器需具有专家系统对药敏解释结果进行判断，符合 N CCLS、DIN、SFM 等国际标准。</p> <p>13、标本加样简单方便，无需借助真空负压等辅助设备，独有的重力加样法一次性完成所有孔位充填。</p> <p>▲14、仪器容量为不少于 50 个标本位，可同时进行不少于 50 个标本的鉴定药敏检测。同一系统可扩增至不少于 100 个标本位。支持持续上机，并且可以通过增加模块扩充通量。</p> <p>15、具有单独鉴定板，鉴定药敏复合板，具有单独阳性药敏板和单独阴性药敏板。</p> <p>16、实验所需的肉汤等培养基无需人工配制，保证质控；鉴定药敏板室温保存。</p> <p>17、仪器为整体机。操作界面简单、图形化，无需另外附加电脑即能完成实验结果的读取与打印。</p> <p>18、具有中文和英文软件可以选择。</p> <p>19、仪器维护简单，无需更换消耗品。</p> <p>20、可以原厂分子检测平台和全自动微生物培养系统无缝连接。</p> <p>21、仪器可以提供中文报告系</p>		
--	--	--	--	--	--

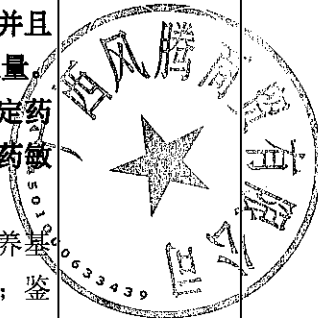

				统, 具有 LIS 联网功能, 能完成基本的统计功能。 22、仪器与耗材具备 FDA 与 S FDA 证书。 23、售后服务由厂家和经销商负责。																																
				全自动微生物鉴定药敏分析系统配置要求																																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>编号</th> <th>描述</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Phoenix M50 Instrument 仪器主机</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Phoenix M50 Starter Kit 启动工具包</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Phoenix M50 Software 软件</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Quick Reference Guide Phoenix M50 Package 快速操作指南</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Panel Phoenix Temperature 温度板</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PhoenixSpec Nephelometer 比浊仪</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PhoenixSpec AP Calibrator Kit 比浊计定标管</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Stabilized Voltage Supply 稳压电源 (内装)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>打印机</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	编号	描述	数量	1	Phoenix M50 Instrument 仪器主机	1	2	Phoenix M50 Starter Kit 启动工具包	1	3	Phoenix M50 Software 软件	1	4	Quick Reference Guide Phoenix M50 Package 快速操作指南	1	5	Panel Phoenix Temperature 温度板	1	6	PhoenixSpec Nephelometer 比浊仪	1	7	PhoenixSpec AP Calibrator Kit 比浊计定标管	1	8	Stabilized Voltage Supply 稳压电源 (内装)	1	9	打印机	1		
编号	描述	数量																																		
1	Phoenix M50 Instrument 仪器主机	1																																		
2	Phoenix M50 Starter Kit 启动工具包	1																																		
3	Phoenix M50 Software 软件	1																																		
4	Quick Reference Guide Phoenix M50 Package 快速操作指南	1																																		
5	Panel Phoenix Temperature 温度板	1																																		
6	PhoenixSpec Nephelometer 比浊仪	1																																		
7	PhoenixSpec AP Calibrator Kit 比浊计定标管	1																																		
8	Stabilized Voltage Supply 稳压电源 (内装)	1																																		
9	打印机	1																																		

竞标总报价 (大写): 人民币陆拾玖万贰仟元整 (¥692000.00)

交货安装期: 合同签订后 30 日内交货并安装调试完毕。

交货地点: 采购人指定地点。

质保期: 壹年 (自交货并验收合格之日起)。

采购项目名称: 医疗设备微生物鉴定药敏分析仪

谈判供应商 (盖单位公章): 广西风腾商贸有限公司

法定代表人或委托代理人签字: 陈斌



竞标说明:

- 1、谈判供应商必须按以上格式加盖单位公章并签名, 否则, 无签名、盖单位公章的视为竞标无效。
- 2、凡在技术参数及其性能 (配置) 要求中表述为 “标配” 或 “标准标配” 的货物, 谈判供应商应在竞标报价中将其标配参数详细列明, 否则竞标无效。