



昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院） 国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）

医疗设备项目

项目编号：XJZC(CG)2024-021-1/2/3/4/5/6/7/9

招标文件



采 购 人： 昌吉回族自治州人民医院

本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购

代理机构：新疆正成招标代理有限公司


(共同编制)

二零二四年八月

交通指引

新疆正成招标代理有限公司位于昌吉市北京南路 69 号康丽家园文化中心三楼，可采用以下交通方式：

- 1、公交：44 路 2 路 世纪花园站下车，康丽家园东门步行 100 米即可到达。
- 2、自驾：高德 腾讯 百度地图导航输入“新疆正成招标代理有限公司”。
- 3、建议将车辆停放于文化中心楼前地面停车场，来访人员 1 楼步行楼梯上 3 楼。

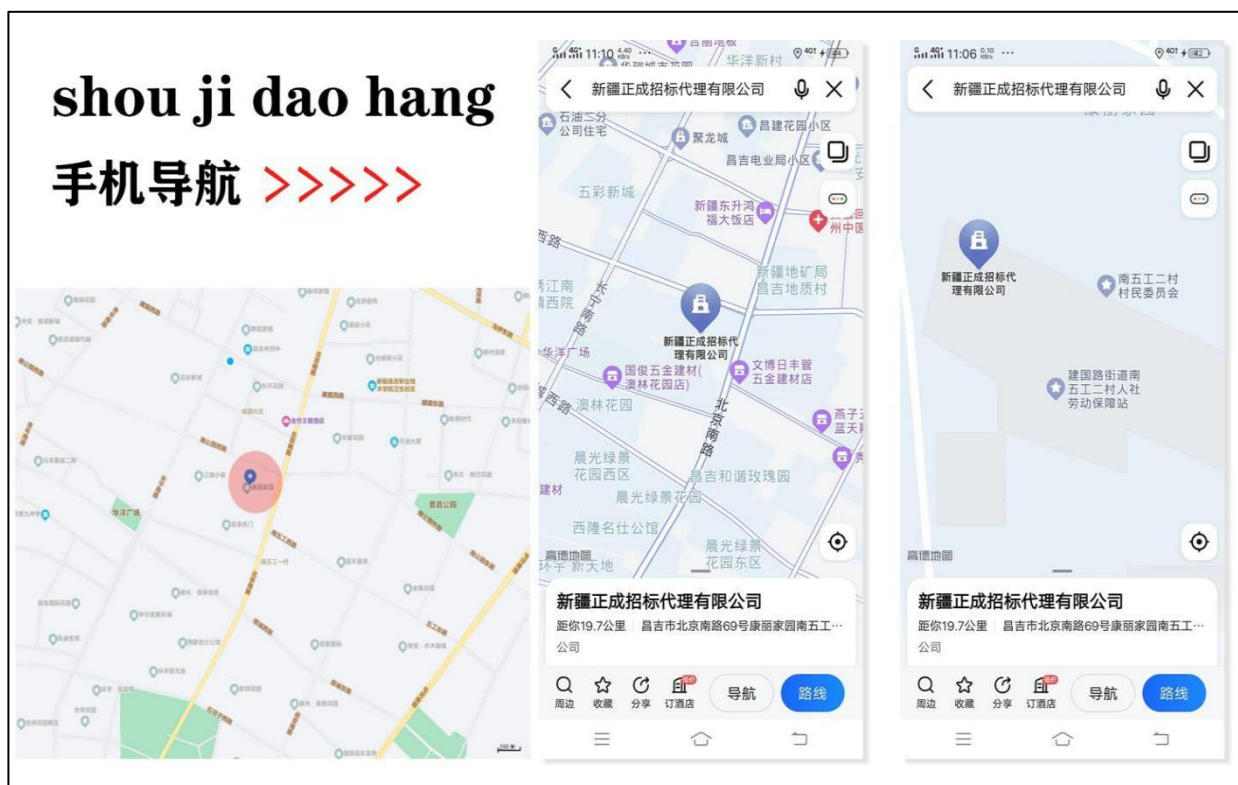



纪律要求

1.对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (四) 对需要专业判断的主观评标因素协商评分；
- (五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。



目 录

第一章 招标公告	5-14
第二章 投标须知	15-63
投标须知前附表	15-25
投标须知正文	26-63
一、总则	26-32
二、招标文件	32-33
三、投标文件	34-37
四、投标文件的提交	38-38
五、开标、评标和定标	39-52
六、评标结果信息公布与授予合同	52-62
七、其他规定	63-63
第三章 评标方法及标准	64-77
第四章 政府采购合同	78-93
第五章 采购需求	94-132
第六章 投标文件格式	133-172
一、投标文件封面格式	134-134
二、投标文件组成	135-135
三、供应商自查索引表	136-138
四、投标文件格式范本	139-172
第七章 招标结束后注意事项	173-188



第一章 招标公告

项目概况：

昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）线上获取招标文件，并于 2024 年 09 月 10 日 10:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： XJZC (CG) 2024-021

项目名称： 昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目

采购方式： 公开招标

预算金额（元）： 3820000.00

最高限价（元）： 3820000.00

采购需求：

标项一： 昌吉回族自治州人民医院口腔种植机等

数量： 3 台

预算金额（元）： 350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 口腔种植机 1 台、口腔牙片机 1 台、口腔扫描仪 1 台。



标项二：昌吉回族自治州人民医院口腔综合治疗台等

数量： 5 台

预算金额（元）： 370000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：口腔综合治疗 4 台、根管马达 1 台。

标项三：昌吉回族自治州人民医院脑反射治疗仪等

数量： 4 台

预算金额（元）： 200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：脑反射治疗仪 2 台、超声波治疗仪 2 台。

标项四：昌吉回族自治州人民医院体感音波反馈系统

数量： 1 台

预算金额（元）： 350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：体感音波反馈系统 1 台。

标项五：昌吉回族自治州人民医院超声波清洗机

数量： 1 台

预算金额（元）： 20000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声波清洗机 1 台。

标项六：昌吉回族自治州人民医院血液透析机

数量： 3 台

预算金额（元）： 480000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血液透析机 3 台。



标项七：昌吉回族自治州人民医院子痫检测设备等

数量：3 台

预算金额（元）：500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：子痫检测设备 1 台、超低温冰箱 2 台。

标项八：昌吉回族自治州人民医院心衰超滤脱水装置

数量：1 台

预算金额（元）：800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：心衰超滤脱水装置 1 台。

标项九：昌吉回族自治州人民医院磁刺激仪

数量：1 台

预算金额（元）：750000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：磁刺激仪 1 台。

合同履行期限：按照甲乙双方合同约定执行

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；**
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**
- (5) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。**



2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 标项一、标项二、标项三、标项四、标项五、标项六、标项七、标项九，专门面向中小企业，供应商应所投货物的生产厂家须为中小企业，投标时须提供《中小企业声明函》（货物）。

2.2 标项八不专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：

(1) **提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械证件：** 供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证，如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。（按要求提供证明文件）

(2) **信用查询：** 未被“信用中国”网站 <https://www.creditchina.gov.cn>、中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（需提供承诺书）

(3) **关联企业情况：** ①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。（关联企业等情况表）。

(4) **投标保证金交纳证明：** 投标保证金银行转账回单/电子保函。（加盖公章）

(5) 本项目不允许转包或分包，不允许联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2024 年 08 月 16 日 00 时 00 分至 2024 年 08 月 23 日 23 时 59 分（北



京时间，线上获取，法定节假日均可)

地址：新疆政府采购网政采云平台 (<https://www.zcygov.cn>)

方式：投标人登录新疆政采云平台 <https://www.zcygov.cn>/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行报名下载招标文件）。

售价（元）：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地址

提交投标文件截止时间：2024 年 09 月 10 日 10:30（北京时间）

投标地址：新疆政府采购网政采云平台 (<https://www.zcygov.cn>)

开标时间：2024 年 09 月 10 日 10:30（北京时间）

开标地址：新疆政府采购网政采云平台 (<https://www.zcygov.cn>)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜：

1、电子招投标相关要求：

关于政府采购活动办理 CA 的提示，根据国办函〔2019〕41 号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，我区政府采购云平台目前已支持包括新疆 CA、翔晟 CA 及汇信 CA 等多家 CA 的办理及使用。为进一步优化营商环境，保障政府采购市场环境公开、公平、公正，各政府采购代理机构在发布的招标公告信息中，需引导投标人通过新疆政府采购网-办理指南—投标人—CA 证书办理操作指南-进入 CA 办理界面，按需选择办理任意一家 CA 厂商的数字证书，不得违规指定厂家办理或要求投标人重复办理 CA。



1.1 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可访问通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

1.2 采用电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

1.3 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

1.4 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<https://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

1.5 投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。本项目投标文件的解密时间为30分钟内,若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。

1.6 投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。投标人钉钉群号：35547618（政采云新疆网超投标人服务二十群）（如已加入，无需重复加入，所有群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

1.7 投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一



个CA锁。

2、投标保证金

2.1、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 33 条规定，招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%。

投标保证金的金额（元）：标项一：¥6800 （大写：陆仟捌佰元整）

标项二：¥7400 （大写：柒仟肆佰元整） 标项三：¥4000 （大写：肆仟元整）

标项四：¥7000 （大写：柒仟元整） 标项五：¥400 （大写：肆佰元整）

标项六：¥9600 （大写：玖仟陆佰元整） 标项七：¥10000 （大写：壹万元整）

标项八：¥16000 （大写：壹万陆仟元整） 标项九：¥15000 （大写：壹万伍仟元整）

2.2、投标保证金的形式：应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。银行电子保函或者保险公司、担保公司电子保函应当从其基本账户开具。以投标人基本账户以外的个人、投标人的办事处、分公司、子公司名义或者其他账户转出的投标保证金无效。

2.3、提交时间：投标保证金或电子保函必须在投标截止时间（投标时间）前从潜在投标人基本账户以电汇、转账方式足额交纳至新疆正成招标代理有限公司指定账户，投标保证金是否交纳成功以银行入账为准。各投标人必须在投标截止时间前交到指定账户。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

2.4、电子保函

投标保证金还可以采用电子保函形式按以下要求办理：

(1) 电子保函按照“一标项一保函”的原则；

- (2) 电子保函须在投标截止时间前办理完成；
- (3) 保函的有效期不得少于本项目投标有效期；
- (4) 投标人通过的电子保函必须真实有效，否则后果自负；
- (5) 投标人以电子保函形式交纳投标保证金；
- (6) 电子担保凭证需作为电子投标文件组成部分在递交投标文件时一并提交。

交纳投标保证金汇款信息如下：

户名：新疆正成招标代理有限公司

开户银行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司北京南路支行

银行账号：806020612010111586786

银行行号：402885000320

■付款用途：投标保证金

■汇款时备注栏附言：XJZC(CG)2024-021-1	XJZC(CG)2024-021-2
XJZC(CG)2024-021-3	XJZC(CG)2024-021-4
XJZC(CG)2024-021-5	XJZC(CG)2024-021-6
XJZC(CG)2024-021-7	XJZC(CG)2024-021-8
XJZC(CG)2024-021-9	

经办人电话：xxx xxxx xxxx

投标保证金交纳说明：

- (1) 投标人以电汇或网银转账方式交纳投标保证金，无需到代理机构换取投标保证金收据，同时需要将投标保证金交纳凭证加盖公章放入投标文件中；
- (2) 投标人以支票、汇票、本票等非现金形式交纳，需到代理机构换取投标保证金收据，同时需要将投标保证金收据扫描件加盖公章放入投标文件中；
- (3) 投标人以金融机构、担保机构出具的保函形式交纳，同时需要将保函扫描件加盖公章放入投标文件中；
- (4) 投标人应充分考虑投标保证金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续，投标保证金的交付时间以实际到账时间为准，超过交纳的时限交纳投标保证金视为投标无效。



七、发布公告的媒介：

新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)

特别提示：

①、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

②、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

③、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

④、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。



八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：昌吉回族自治州人民医院

本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购

联 系 人：郭老师

联 系 方 式：189 0994 5698

2、代理机构信息

名 称：新疆正成招标代理有限公司

地 址：昌吉市北京南路 69 号康丽家园文化中心三楼

联 系 人：夏鲁梅

联 系 方 式：0994-2380033

Q Q 邮 箱：385585645@qq.com

3.项目联系方式

联 系 人：夏鲁梅

联 系 方 式：181 3904 2419

第二章 投标须知

投标须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称 项目编号	昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等22台（套）医疗设备项目 XJZC（CG）2024-021
2	招标范围	国产设备 1 批
3	项目地址	昌吉回族自治州人民医院
4	招标方式	公开招标
5	供货时间	以甲乙双方政府采购合同中约定为准
6	设备质量技术标准及包装	1.乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定。 2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。 3.设备包装应为设备生产厂原包装。
7	售后服务要求	详见第五章采购需求
8	付款情况	以甲乙双方政府采购合同中约定为准
9	所属行业	本项目的所属行业为工业（从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业）。
10	资金来源	事业单位收入



序号	条款名称	编列内容
11	预算金额 最高限价	预算金额 (元) : 3820000.00 最高限价 (元) : 3820000.00 其中: 标项一: 350000.00 标项二: 370000.00 标项三: 200000.00 标项四: 350000.00 标项五: 20000.00 标项六: 480000.00 标项七: 500000.00 标项九: 750000.00 注: 1、投标报价时每包投标报价不得超过各产品采购预算, 每包中的分项报价也不超过分项的预算金额, 超过按废标处理。 2、报价说明: 采用公开招标, 仅对满足招标文件实质性要求的投标人, 进行一次最终报价, 报价不得高于最高限价, 否则其投标将被否决。报价应包含招标文件中所需货物报价(含税金)、运输费、保险费用、施工、安装、调试费、验收、拆装、培训、备品备件、售后服务、税款、测试、质检、检验、行政许可及相关证书等直至给业主正常履行合同前的一切费用。 3、投标人的报价明显低于其他投标人报价或者明显低于市场价, 使得其报价可能低于其个别成本的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明, 必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会将其作为无效投标处理, 自行承担相关责任。
12	采购人	名称: 昌吉回族自治州人民医院 本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购 联系人: 郭老师 联系方式: 189 0994 5698
13	代理机构	名称: 新疆正成招标代理有限公司 地址: 昌吉市北京南路69号康丽家园文化中心三楼 联系人: 夏鲁梅 联系电话: 0994-2380033 181 3904 2419
14	资格证明文件	资格证明文件: 见招标文件资格性审查表 投标人未提供有效的资格证明文件的, 视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求, 投标无效。



序号	条款名称	编列内容
15	信用查询	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或代理机构将对投标人进行信用情况查询，通过信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参加本次政府采购活动。（信用查询以代理机构开标前1日查询结果为准）
16	中小企业扶持政策说明	1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6、小微企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境)采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策的，依据规定给予评标优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评标，不重复享受价格扣除政策。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定。
17	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	本项目专门面向中小企业，标项一、标项二、标项三、标项四、标项五、标项六、标项七、标项九，不享受价格扣除。



序号	条款名称	编列内容
18	偏离	不接受实质性偏离及重大偏离
19	是否接受 联合体投标	不接受
20	是否允许 转包或分包	不允许
21	踏勘现场	不组织
22	投标有效期	从首次提交投标文件截止之日起，不得少于90个日历日。
23	进口产品	本项目不适用
24	投标截止 时间	2024年09月10日10:30（北京时间），本项目采用电子评标，请各投标人务必制作好电子投标文件。使用CA锁提交电子投标文件，必须于投标文件截止时间前提交到“新疆政府采购云平台”逾期提交的投标文件将被拒收。
25	澄清或修改	详见招标文件
26	投标人询问	对招标公告、招标文件、招标过程、评标结果的询问可向采购人或代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：夏鲁梅 联系电话：181 3904 2419 注：采购人或代理机构只对投标人依法提出的询问作出答复。
27	投标人质疑	供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑并递交至代理机构，逾期质疑无效。 供应商应知其权益受到损害之日是指：



序号	条款名称	编列内容
		(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日； (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。 采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。 接受的方式：现场收取纸质版质疑函 接收人：夏鲁梅 联系方式：0994-2380033 181 3904 2419 递交地址：昌吉市北京南路 69 号康丽家园文化中心三楼 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评标方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。
28	投标人投诉	质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。 投诉受理单位：昌吉州财政局政府采购办 联系电话：0994-2517760 注：根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》及其他有关规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
29	投标保证金	详见招标公告



序号	条款名称	编列内容
30	投标保证金的退还	(1) 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 (2) 采购人或者代理机构应当自中标（成交）通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标（成交）人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金或者转为中标（成交）人的履约保证金。 ★退还投标保证金须知：详见招标文件 P180-P187。
31	不予退还投标保证金的情形	有下列情形之一的，投标保证金不予退还： (1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的； (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的； (4) 投标人与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通的； (5) 招标文件规定的其他情形。
32	财政部门指定的媒体	新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html
33	投标文件一般要求	1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。 2、投标人提交的投标文件及投标人与采购人或代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。 3、计量单位应使用我国法定计量单位。未列明时应默认为我国法定计量单位。 4、投标文件应采用电子投标形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。 5、投标人使用相同 IP 地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 6、投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

序号	条款名称	编列内容
34	投标文件的签署	1、本采购项目电子投标文件的封面，标明所采购的项目名称、项目编号、招标范围及内容（项目包号/产品名称）、采购人名称、供应商名称、供应商地址、联系人、联系电话及传真、供应商QQ邮箱号等内容。 2、投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。
35	开标时间和地址	开标时间：2024年09月10日10:30（北京时间） 开标地址：新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn） 注：投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功提交至“新疆政府采购网政采云平台”，否则投标无效。
36	投标文件的提交地址	电子投标文件数目：电子版1套。新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn）使用新疆政府采购云平台投标文件制作工具，制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前提交至政采云平台对应位置。 纸质投标文件份数：中标供应商在评标结果1个工作日公示期结束后，将投标文件1正3副（胶装成册，投标文件厚度不超过4厘米，如厚度超出，建议双面打印或者胶装成上下2册），另以U盘形式提供全套电子版投标文件（电子版格式：投标文件正本盖章扫描生成的PDF格式）递交至新疆正成招标代理有限公司。 详细地址：使用高德地图、腾讯地图、百度地图搜索新疆正成招标代理有限公司到达指定位置，昌吉市北京南路69号康丽家园文化中心三楼303室，纸质版投标文件内容与电子版提交至新疆政采云平台的投标文件内容一致。 （接受邮寄，不接受到付）。 收件人：夏鲁梅 联系电话：181 3904 2419



序号	条款名称	编列内容
37	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人（其中：相关专业等方面的专家 4 人，业主代表 1 人）。 评标专家确定方式：新疆政府采购网评标专家库中随机抽取
38	评标方法	综合评分法 （其中：经济部分30分，商务和技术部分70分）
39	推荐的中标候选人数量	详见招标文件
40	履约保证金	招标文件要求中标供应商提交履约保证金的,投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的电子投标保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。中标人没有按照规定提交履约担保的,视为放弃中标资格,其投标保证金不予退还,由采购人与投标人在合同中约定。
41	同品牌同型号投标问题	当多家投标人所投品牌型号相同时,按照下列情形处理: 【采用综合评分法】提供同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌同型号投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由评标委员会按照下述第（2）条方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌同型号投标人不作为中标候选人。 (1)评标委员会采取随机抽取的方式确定。 (2)投标报价低的一方为中标候选人;投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人;投标报价和技术部分得分均相同时,采取随机抽取的方式确定。



序号	条款名称	编列内容
42	补充事项	①招标文件中要求：投标单位法定代表人和委托代理人的联系电话须实名制。 ②开标时《投标（响应）文件签收登记表》中联系人、联系电话须实名制并确保真实有效，第一时间可以接听，如因电话号码有误联系不上造成的投标失败等后果由投标人自行承担，《投标（响应）文件签收登记表》的邮箱号需填写无误。 ③为保证本项目产品质量及良好的售后服务，货物或产品必须符合国家标准。 ④投标单位应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，本文件中部分加粗、加黑、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标单位注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
43	中标通知书 领取	接到代理机构通知后，三个工作日内，请中标供应商凭有效身份证明证件到新疆正成招标代理有限公司领取中标通知书。若未在规定时间内领取，也无正当理由予以说明，将视为自动放弃第一中标候选人资格，投标保证金不予退还。
44	采购合同	中标单位与采购人签订合同后及时将合同扫描件（PDF 版）发送至邮箱（385585645@qq.com）或送至新疆正成招标代理有限公司。
45		自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、电子邮箱)长期有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则投标人承担由此引起的一切后果。

序号	条款名称	编列内容			
46	代理费标准	类别	货物采购	服务采购	工程采购
		采购额度（万元）			
		100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%
		100~500	1. 1%	0. 8%	0. 7%
		500~1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%
		1000~5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%
		5000~10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%
		10000~100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%
		100000 以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%
		代理服务收费标准：			
依据国家有关规定，向中标人收取中标代理服务费，同时承担所需的全部费用。参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980 号文）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号文）的收费标准计算招标代理服务费，并按收费标准额度下浮 50%后收取费用，由中标人支付。代理服务费支付方式：由中标供应商支付。					
代理服务费的支付时间：中标供应商在收到中标通知书同时向代理机构一次性支付本项目代理服务费。					

序号	条款名称	编列内容								
		★缴纳代理服务费银行账户信息如下： 账户名称：新疆正成招标代理有限公司 账户号码：65050162604609888999 开户银行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行 银行行号：105885000033 基本存款账户编号：J8850004061901 付款用途：代理服务费 <table><tr><td>XJZC(CG)2024-021-1</td><td>XJZC(CG)2024-021-2</td></tr><tr><td>XJZC(CG)2024-021-3</td><td>XJZC(CG)2024-021-4</td></tr><tr><td>XJZC(CG)2024-021-5</td><td>XJZC(CG)2024-021-6</td></tr><tr><td>XJZC(CG)2024-021-7</td><td>XJZC(CG)2024-021-9</td></tr></table> 备注：需要开具增值税专用发票，供应商需提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。如不按要求提交开票信息，一律按电子（普）发票开具，发票只开一次不予更换。	XJZC(CG)2024-021-1	XJZC(CG)2024-021-2	XJZC(CG)2024-021-3	XJZC(CG)2024-021-4	XJZC(CG)2024-021-5	XJZC(CG)2024-021-6	XJZC(CG)2024-021-7	XJZC(CG)2024-021-9
XJZC(CG)2024-021-1	XJZC(CG)2024-021-2									
XJZC(CG)2024-021-3	XJZC(CG)2024-021-4									
XJZC(CG)2024-021-5	XJZC(CG)2024-021-6									
XJZC(CG)2024-021-7	XJZC(CG)2024-021-9									
47		注：如本《投标须知前附表》相关内容与招标文件正文中相关内容表述不一致处，则以本《投标须知前附表》相关内容为准。								



投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 项目名称：详见投标须知前附表；
- 项目编号：详见投标须知前附表；
- 1.2 招标范围：详见投标须知前附表；
- 1.3 项目地址：详见投标须知前附表；
- 1.4 招标方式：详见投标须知前附表；
- 1.5 供货时间：详见投标须知前附表；
- 1.6 设备质量技术标准及包装：详见投标须知前附表；
- 1.7 售后服务要求：详见投标须知前附表；
- 1.8 付款情况：详见投标须知前附表；
- 1.9 所属行业：详见投标须知前附表；

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指投标招标文件要求、参加招标采购,向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，



详见《政府采购品目分类目录》（财库[2015]189号）。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号及《政府采购进口产品管理办法》财库〔2007〕119号。

2.7 偏离

2.7.1 本条所称偏离为投标文件对招标文的偏离，即不满足招标文件的要求，偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。（商务条款不允许偏离，技术条款偏离情况在详细评标中给与相应评分）

2.7.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“特殊”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.8 若采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

2.8.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2.8.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

2.8.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

2.8.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.8.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.8.6 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者代理机构应当及时询



问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.9 采购人或者代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇：

2.9.1 就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息；

2.9.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.9.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品；

2.9.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

2.9.5 对投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

2.9.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人；

2.9.7 非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.9.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

2.10 特别说明

2.10.1 投标人在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。凡参加投标的投标人必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好；

2.10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与相关认证等必须为投标人所拥有；

2.10.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

2.10.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。



3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合招标公告中规定的申请人的资格要求。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

3.2.1 与采购人、代理机构存在利害关系；

3.2.2 受到刑事处罚或者受到较大数额以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4 使用综合评分法的采购项目，提供同品牌同型号产品且通过资格性审查、符合性审查的不同潜在投标人参加同一合同项下投标的，按一家潜在投标人计算，评标后得分最高的同品牌同型号潜在投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个潜在投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌潜在投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家潜在投标人提供的核心产品品牌型号相同的，同上处理。

4. 投标费用和知识产权

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。



4.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5. 授权委托书

投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6. 联合体投标（不允许）

除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受以联合体形式投标的投标人。

7. 现场考察（不采用）

7.1 投标人应按规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察或者参加开标前答疑会。

7.2 现场考察或者参加开标前答疑会的费用由投标人自己承担，现场考察或者参加开标前答疑会期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品（不采用）

8.1 除投标须知前附表另有规定外，本项目不允许进口产品参加招标采购活动。

8.2 本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

8.3 采购人采购进口产品，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财



政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

9. 政府采购政策支持（本项目专门面向中小企业）

9.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

9.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

9.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.5 投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。



9.6 本项目中小企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境)采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策的，依据规定给予评标优惠；②因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评标，不重复享受价格扣除政策。

9.7 根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随评标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，本招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式



第七章 招标结束后注意事项

10.2 本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝，其风险由投标人承担。

11. 投标截止时间

11.1 投标截止时间即投标人提交投标文件的截止时间见投标须知前附表。

12. 招标文件的澄清或者修改

12.1 采购人或者代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

12.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者代理机构提出。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位。未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用电子投标形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。

13.6 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14. 投标文件的组成

投标文件包括下列内容：

供应商自查索引表

14.1 投标函

14.1.1反商业贿赂承诺书

14.2报价一览表

14.2.1投标报价明细表

14.2.2设备简要说明一览表



14.3 技术/商务响应与偏离表

14.4 资格证明文件

14.5 投标人主要业绩

14.6 货物说明

14.7 实施方案

14.8 售后服务表

14.9 人员配置表

14.10 投标人认为需要提供的其他资料

根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件均不予退还。

15. 报价

15.1 投标人应当根据招标文件的招标要求和招标范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有货物供货、运输、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3 投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件格式”填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的投标报价将被认为是非实质性响应而被拒绝。



15.5 本采购项目设定采购预算投标须知前附表，投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见投标须知前附表。

16. 投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1 投标人应提供资格证明材料，以证实各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.2 投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

16.3 投标人在货物说明中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.4 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

16.4.1 货物主要性能和参数的详细说明；

16.4.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

17. 投标保证金

17.1 投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2 潜在投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者代理机构应当自收到潜在投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因潜在投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：



- 17.3.1 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- 17.3.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 17.3.3 中标人未按招标文件规定交纳履约保证金的；
- 17.3.4 拒绝履行合同义务的。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

18.2 投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内潜在投标人撤销投标文件的，采购人或者代理机构可以不退还投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 本采购项目电子投标文件的封面，标明所采购的项目名称、项目编号、招标范围及内容（项目包号/产品名称）、采购人名称、投标人名称、投标人地址、联系人、联系电话及传真、投标人QQ邮箱号等内容。

19.2 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。



四、投标文件的提交

20. 投标文件的提交

20.1 投标文件的提交地址（详见前附表）

20.2 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

20.3 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

20.4 加密的电子投标文件应在递交截止时间前通过政采云平台提交完成。

注意：如未在规定时间内进行以上操作，将导致投标（投标）无效。

21. 当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

- （1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功提交加密电子投标文件；
- （2）投标人使用解密的 CA 数字证书与提交加密投标文件使用的 CA 数字证书不一致；
- （3）投标人解密时 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密；
- （4）加密投标文件时，CA 数字证书未过期，解密时，显示 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密；
- （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；
- （6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。

投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。



五、开标、评标和定标

22. 开标程序

22.1 宣布开标纪律；

22.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

22.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

22.4 投标人根据要求在限定时间内通过新疆政府采购网政采云平台对已上传的电子投标文件开始解密；

22.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

22.6 开标结束。

23. 开标

23.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过新疆政府采购网政采云平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

23.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

23.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑问，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

23.5 在评标结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，



系统不接受超时的澄清。

23.6 各投标人的评标得分与排序将在新疆政府采购网政采云平台告知。

23.7 开标时属于下列情况之一的，视为无效投标:

- (1) 未在政采云系统进行在线签到的;
- (2) 未在30分钟内完成在线解密的;
- (3) 唱标结束后**30分钟内**未完成“报价一览表”在线确认的;
- (4) 投标人未按照公开招标文件要求交纳投标保证金的;
- (5) 按照本文件规定有效证件不齐全的投标人的投标文件。

23.7.1 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7.2 潜在投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他潜在投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他潜在投标人的合法权益。

在评标过程中发现潜在投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.7.3 有下列情形之一的，视为潜在投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任:

- (1) 不同潜在投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同潜在投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同潜在投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同潜在投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同潜在投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同潜在投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 评标委员会



24.1 采购人或者代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

24.1.1 核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.1.2 宣布评标纪律；

24.1.3 公布潜在投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

24.1.4 组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长；

24.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰；

24.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.1.8 核对评标结果，有本招标文件投标须知正文第 25.10 条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.1.9 评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

24.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2 要求潜在投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；



24.2.3 对投标文件进行比较和评价；

24.2.4 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家投标人为中标候选人；

24.2.5 向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3 评标委员会由采购人代表和评标专家组成,成员人数应当为 5 人以上单数,其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的,应当回避。

采购项目符合下列情形之一的,评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数:

- (一) 采购预算金额在 1000 万元以上;
- (二) 技术复杂;
- (三) 社会影响较大。

评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标,对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评标专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家情形除外。代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.4 采购人或者代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中,通过随机方式抽取评标专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评标专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家。

24.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的,采购人或者代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。



无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6 采购人委派代表参加评标委员会的，要向代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过 2 人。

24.7 评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与投标人的合法权益。

24.8 评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

25. 评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评标因素、



标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评标，评标委员会应当对符合资格的潜在投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求潜在投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

潜在投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。潜在投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件投标须知正文第 25.2 款的规定经潜在投标人确认后产生约束力，潜在投标人不确认的，其投标无效。

25.4 评标委员会认为潜在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查潜在投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；潜在投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多



数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7 本项目评标方法为综合评分法。

25.7.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与潜在投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

25.7.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个潜在投标人的投标文件进行评价，并汇总每个潜在投标人的得分。

25.7.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

25.7.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

25.8 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为排名第一的中标候选人。

25.9 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

25.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一) 分值汇总计算错误的；



- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评标,重新评标改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

潜在投标人对上述(一)~(四)项提出质疑的,采购人或者代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标,重新评标改变评标结果的,应当书面报告本级财政部门。

25.11 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容:

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地址;
- (二) 潜在投标人名单和评标委员会成员名单;
- (三) 评标方法和标准;
- (四) 开标记录和评标情况及说明,包括无效潜在投标人名单及原因;
- (五) 评标结果,确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;
- (六) 其他需要说明的情况,包括评标过程中潜在投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正,评标委员会成员的更换等。

25.12 采购人、代理机构应当采取必要措施加强评标现场管理,与评标工作无关的人员不得进入评标现场,保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外,采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为,要依法严肃处理。



有关人员对标评情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.13 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (一) 评标委员会组成不符合本招标文件规定的；
- (二) 有本招标文件投标须知正文第 24.8 条第一至五项情形的；
- (三) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (四) 有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的；
- (五) 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

25.14 评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或代理机构书面说明情况，采购人或代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或代理机构报告。

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

26. 定标

26.1 代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标



候选人为中标人。

26.2 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告评标结果，招标文件应当随评标结果同时公告。

评标结果公告内容应当包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、中标公告期限以及评标专家名单。

中标公告期限为 1 个工作日。

在公告评标结果的同时，采购人或者代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的潜在投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

26.3 采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

26.4 在确定中标供应商前，采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

26.5 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

27. 招标终止

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (一) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 潜在投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；



(四) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有潜在投标人。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

27.2 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，评标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

27.2.4 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

27.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

28. 重新评标

28.1 除本须知第25.10所述情形外，采购人或者代理机构不能以任何理由组织重新评标。采购人、代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 保密与纪律事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对投标人资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相



关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、监督人、代理机构、评标委员会及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，我公司将根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

29.2 投标人不得与采购人、代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

29.3.1 投标人直接或者间接从采购人、代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

29.3.2 采购人、代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

29.3.3 投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

29.3.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

29.3.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

29.3.6 投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

29.3.7 投标人与采购人、代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的；

29.3.8 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

29.4 投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，



并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （三）与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

29.5 投标人有下列情形之一的，依照《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有上述第一项规定情形的，中标无效。评标阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和代理机构的，处以采购金额 5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29.6 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。



29.7 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

六、评标结果信息公布与授予合同

30. 中标信息的公布

30.1 采购人或者代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告评标结果，招标文件随评标结果同时公告。

30.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

31. 询问及质疑

31.1 《中华人民共和国政府采购法》（第五十一条）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问，采购人或代理机构应当及时回复，但答复的内容不得涉及商业秘密。《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第五



十二条) 采购人或代理机构将在3个工作日内作出答复。

31.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑：

31.2.1 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

31.2.2 关于评标结果的质疑，应在评标结果信息发布后7个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

31.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

31.5 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

31.6 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。



31.7 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给磋商方。磋商方不具有法定调查、认定权限和义务。

31.8 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

31.9 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

31.10 采购人或代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。



质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：
事实依据：
.....
法律依据：
.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章): 公章:

日期:



质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人： 联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2：

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：



代理机构名称:

采购文件公告:是/否 公告期限: 采购结果公告:是/否

公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向.....提出质疑, 质疑

事项为:

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2:

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:



投诉书说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



31.11 投标人对采购人或代理机构的答复不满意，或采购人或代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

31.12 参与政府采购活动的投标人对评标过程或者结果提出质疑的，采购人或代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致评标结果改变的，采购人或代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

32. 中标通知

32.1 中标人确定后，代理机构将以电子形式或线下纸质版向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变评标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.2 中标人在收到代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

32.3 招标文件要求中标投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的电子投标保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，由采购人与投标人在合同中约定。

32.4 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

33. 签订合同

33.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。



33.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地址和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

33.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

33.4 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他潜在投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的潜在投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

33.6 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

33.7 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

33.7.1 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

33.7.2 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

33.7.3 拒绝履行合同义务的；

33.7.4 违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.8 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者



终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

33.9 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。



七、其他规定

35. 代理服务费

35.1 中标人应按投标须知前附表规定缴纳代理服务费。

35.1.1 中标人在收到中标通知书同时向代理机构一次性支付本项目代理服务费。

35.1.2 依据国家有关规定，向中标人收取中标代理服务费，同时承担所需的全部费用。参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号文）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号文）的收费标准计算招标代理服务费，并按收费标准额度下浮 50%后收取费用，由中标人支付。

36. 其他规定

36.1 采购人、代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

36.2 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

36.3 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆正成招标代理有限公司。

36.3 参与本次招标的投标人应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。



第三章 评标方法及标准

一、总则

1. 评标委员会

1.1 资格性检查由资格审查小组负责。

1.2 评标由依法组成的评标委员会负责,其组成方式详见前附表。

2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为**综合评分法**。

2.1.1 综合评分法,是投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为中标候选人的评标方法。评标因素的设定与潜在投标人所提供货物服务的质量相关,包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

2.1.2 评标时,评标委员会各成员应当独立对每个潜在投标人的投标文件进行评价,并汇总每个潜在投标人的得分。

2.1.3 评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4 因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列,得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为排名第一的中标候选人。

3. 评标原则



3.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 评标纪律

3.3.1 采购人委派代表参加评标委员会的，要向代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过2人。采购人需要在评标前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2 评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.3 评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、



评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

3.3.4 评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.3.5 采购人、代理机构要加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为，要依法严肃处理。

3.4 评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1 评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标。遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2 要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有投标人的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性审查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价。

3.4.3 对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4 评标委员会如需要投标人对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予投标人必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文



件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。

3.4.5 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评标结果推荐中标候选人。

3.4.6 评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

二、评标程序

4. 投标文件的初步评标

4.1 初步评标分为资格性审查和符合性审查。

4.1.1 资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购人授权代理机构对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性审查表

序号	检查因素	检查内容		
一	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：	(1)具有独立承担民事责任的能力； 提供投标人营业执照彩扫描件，以及投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。		
		(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 提供2022年度或2023年度的审计报告（成立不足1年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、利润表、现金流量表）（提供彩扫描件）。		
		(3)具有履行合同所必需的设备和技术能力； 提供履行本合同所必需的设备清单和具有专业技术的人员清单或承诺书。		
		(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 提供2024年第一季度完税证明及相关人员近6个月任意1个月的社保缴纳证明；加盖投标人电子公章；投标人依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商电子公章。		
		(5)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 提供声明函。		
		(6)法律、行政法规规定的其他条件。 提供声明函或承诺。		
二	本项目专门面向中小企业。	供应商应所投货物的生产厂家须为中小企业，投标时须提供《中小企业声明函》（货物）。		
三	本项目的特定资格要求：	(1)提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械证件 供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证，如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。（按要求提供证明文件）		
		(2) 信用查询 无需自行提供查询结果，但需要在投标文件中包含 1 份承诺书，承诺未被列入相关失信名单。		
		(3) 关联企业情况 准备1份供应商关联企业情况表，详细列出与本单位存在关联关系的企业信息。		
		(4) 投标保证金交纳证明 提供投标保证金银行转账回单/电子保函。（加盖公章）		
结论	是否通过审查，进入下一阶段。			
①. “是否通过并进入下一阶段评标” 一栏应写 “通过” 或 “不通过” 。				
②.出现一个 “×” 的结论为 “不通过” 。表中全部为 “√” ， 同意进入下一阶段评标。				
③.若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评标。				

4.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出投标。评标委员会评标投标文件的投标性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.3 投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

序号	评审因素		评审标准
1	商务	投标文件签署	投标文件的签字、盖章符合招标文件规定。
2		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。
3		投标方案	每个标项只能有一个方案投标
4		供货范围（服务内容）	对招标文件规定的供货范围（服务内容）全部作出响应。
5		交货期(完成期限)	满足招标文件要求
6		质保期及售后服务	满足招标文件要求
7		投标有效期	满足招标文件规定
8		付款方式	投标文件承诺的付款方式满足招标文件要求
9		其他	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
10	报价	报价唯一	其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。
11	技术	质量技术	满足招标文件提出的技术和功能要求。



4.2有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的;
- (2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的。

4.3 废标后,除采购任务取消情形外,招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5. 澄清有关问题

5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求潜在投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

潜在投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。潜在投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 投标人不得对下列内容进行澄清或补充:

- (1) 投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。
- (2) 不满足第二章投标须知第3款规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3 投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:



(一) 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表 的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经潜在投标人确认后产生约束力，潜在投标人不确认的，其投标无效。

5.4 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。



问题澄清通知

(投标人名称) : _ _ _ _ _

(招标项目名称) 招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

1、

2、

评标委员会成员 (签字) :

日期: 年 月 日



问题的澄清、说明或补正

评标委员会： _ _ _ _ _

(招标项目名称) 的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1、

2、

单位公章：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日



5.5 评标委员会认为潜在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查潜在投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；潜在投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 投标文件的详细评标

6.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.3 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4 评分标准:各投标人的总评分: $A(\text{含E、F价格折扣})+B+C+D=100$ 分，具体评分细则如下：

综合评分表

(经济部分占 30 分，商务和技术得分占 70 分)

项目		分值	评审内容及规则	得分
经济部分	价格	30 (国产)	采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100。	
商务部分	相关业绩	2	提供投标方（2021 年至今）新成立公司提供成立以来同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得 1 分，最高得 2 分，不提供不得分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖投标单位公章）。	
	服务能力	16	1、售后服务体系完备，设备出现故障 1 小时内到达现场处理解决故障得 5 分，设备出现故障 2 小时内到达现场处理解决故障得 2 分，2 小时以上到达现场处理解决故障不得分，评审时以提供服务承诺和相关证明材料为准（提供具有维修招标设备的人员资质证明）。 2、提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得 1 分，不提供不得分。 3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的优秀得 5 分、一般得 2 分、不合理或不提供不得分。质保服务期三年的得 3 分，四年的得 4 分，五年及以上的得 5 分。质保期低于招标要求的，不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）	

技术部分	核心参数 * ★	15	关键（核心）技术参数完全满足得 15 分，不完全满足不得分。 （评审时以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准〔包括：检验报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、食药局备案过的产品说明书或生产厂家产品说明书、生产厂家技术白皮书〕，证明材料需加盖生产厂家公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。）	
	其他技术指标	32	1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得 20 分；由专家逐条确认是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣 2 分，扣完为止。 2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（影响产品质量实质性参数）（包括核心参数）高于招标文件中技术参数和性能，优于一般参数得 1 分/项，优于核心参数得 2 分/项，最多得 12 分。 （评审时以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准〔包括：检验报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、食药局备案过的产品说明书或生产厂家产品说明书、生产厂家技术白皮书〕，证明材料需加盖生产厂家公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。）	
	安装技术水平	5	1.有专门项目负责人，配备 2 名及以上安装技术人员得 2 分。 2.设备安装技术负责人员有相应安装经验、有培训方案，同时提供 3 项及以上安装调试业绩得 3 分，提供 2 项安装调试业绩得 1 分，提供 1 项安装调试业绩得 0.5 分，不提供不得分。评审时以相关证明材料为准。（相关证明材料：提供使用单位的验收单和培训证明，并加盖投标单位公章。）	
总得分 100 分		技术参数中标注 “*” 或 “★” 号的为关键（核心）参数		
备注：当多家投标人所投品牌型号相同时，按照下列情形处理： 【采用综合评分法】提供同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照下述第（2）条方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌同型号投标人不作为中标候选人。 (1)评标委员会采取随机抽取的方式确定。 (2)投标报价低的一方为中标候选人；投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人；投标报价和技术部分得分均相同时，采取随机抽取的方式确定。				



7. 推荐中标候选人名单

7.1 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为排名第一的中标候选人。

7.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

潜在投标人对上述(一)~(四)提出质疑的，采购人或者代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地址；
- (二) 潜在投标人名单和评标委员会成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效潜在投标人名单及原因；
- (五) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中潜在投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4 本次招标采购推荐的中标候选人数量详见招标文件26.3。



第四章 政府采购合同（货物类）

(此合同样本仅供参考,合同具体条款以双方最终签订为准.)

合同条款甲乙双方根据实际情况进行签订，签订内容不得违反国家法规政策，不得违反招标文件及投标文件的约定。(说明:本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。)

昌吉回族自治州人民医院医疗设备采购合同

合同编号：

采购方（以下简称甲方）：昌吉回族自治州人民医院

地址：昌吉市延安北路303号

电话：0994-2350409

邮编：831100

供货方（以下简称乙方）：

地址：

电话：

邮编：

甲方通过公开招标方式购买一批医疗设备（昌吉州州直卫生健康医疗系统医疗XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目）（招标文件编号：XXXX，招标项目名称:昌吉州卫生健康系统XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目(第XX包)）。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就设备的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款,共同信守。

一、经甲方同意，乙方向甲方供应完全符合以下要求的设备（设备配置明细等附后）。

序号	设备名称	型号、品牌	产地	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1							
2							
合计金额：小写 ¥xxxxxx 元， 大写：人民币 xxxx 元整（含税）							

设备的易耗配件必须在合同附件（附件1：设备配置清单、附件2：设备备品备件耗材清单、附件3：设备零配件消耗品购买价格清单）中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。



二、售后服务及质量保证：

1、设备（货物）验收合格后，自使用之日起由乙方免费保修____年，如乙方不具备自行维修的资质，可指定厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方履行质保义务。保修期后仍由乙方负责终身维修，乙方可委托厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方提供维保服务。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，人为损坏不在保修范围内；免费保修期后仍由乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）负责终身维修，免费保修期满以后乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）履行保修义务只收取甲方材料费，其他费用予以免除。乙方指定的售后维保商（或厂家）未按照本合同约定履行质保义务的，视为乙方违约，乙方应根据本合同的约定承担违约责任。

2.乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）自收到甲方维修要求（电话、微信、QQ、电子邮件、传真等不限）后应当在30分钟内响应，2小时内提出解决方案并开始进行维修。乙方在甲方提出维修要求24小时内不能维修到位的，则自24小时届满，乙方即有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。乙方为甲方出具一份维修承诺函，乙方一切按照承诺函进行维修。

3.质保期内计算机系统乙方负责免费升级。其中系统中使用的厂家自主知识产权的系统软件，由乙方负责联系厂家进行终身免费升级和保修。除正常维修外，乙方应定期派工程师进行设备检查和维护。

4.乙方在中国国内设有维护部门和零备件库，保证对合同设备所需的零备件长期（本设备使用年限）供应。

三、安装、验收及培训：



1.乙方将设备送达甲方指定地点后，甲、乙双方对设备进行现场验收，并出具验收证明。若在验收时发现设备数量、规格、品种、参数、外观等不符合规定，甲方有权拒收货物，因此产生的相关费用均由乙方负担。

验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告上签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方负担。

2. 乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

3.如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

四、设备质量技术标准及包装：

1.乙方保证所供设备的相关资质证书齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资质证复印件作为本合同附件。

2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。

3.设备包装应为设备生产厂原包装。

五、付款方式：

甲方与乙方签订合同后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方预付第一笔设



备款，合同总金额30%，计 XXX 元；机器到现场安装，进行临床使用人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第二笔设备款，合同款总额的30%，计 XXX 元；机器安装到位后进行维修人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第三笔设备款，合同款总额的30%，计 XXX 元；所有人员培训合格后，达到临床使用标准及要求，甲方收到乙方的项目付款审批单、收据、乙方开票信息等齐全的付款资料后30个工作日内向乙方支付第四笔设备款，合同款总额的10%，计 XXX 元。

甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

六、设备交付：

1.乙方应在合同签订之日起30个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

2.设备的配置详见附件设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单。设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单表是本合同的附件部分。乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

七、合同有效期：为本合同的履行期。

八、公证：如需公证的，公证费用由提出公证需求的一方承担。



九、违约责任：

1.乙方逾期供货或者逾期完成验收、人员培训的，每逾期一日，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2.乙方逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

3.如乙方交付的设备在验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，视为乙方根本违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的交付义务。

4. 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第二条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同二.2约定从乙方最后一笔款项中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付2000元的违约金。

5.如乙方未按本合同二.4的约定，不能保证本合同项下机器设备备件长期供应的，乙方应按照合同二.2的约定提供备用机，该备用机必须是全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的设备；如乙方不能提供符合要求的备用机的，本合同项下设备无法正常使用的，乙方应当按照当时的折旧后的价格予以回购，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括甲方主张权利的诉讼费、律师费、差旅费、调查取证等相关费用）。

6. 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增



加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

7.如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿责任的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

8.甲方如迟延付款的，每迟延一日应向乙方支付应付款总金额万分之一的违约金，该违约金累计达到合同总金额1%封顶。

9.乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。

10.若到货设备参数与招标文件参数响应不一致，视为虚假应标，合同立即终止。给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿责任的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

十、争议解决方法：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、其他：

1.合同变更须经双方书面同意。

2.招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。若合同与标书有冲突之处，以标书为准。



3.本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉诉讼法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲 方（盖章）：昌吉回族自治州人民医院 乙 方（盖章）：

开户行：中国建设银行昌吉分行文化东路支行 开户行：

账 号：65001620300050001465 账 号：

法人代表： 法人代表：

签约代表： 签约代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件1：

设备配置清单

序号	货物名称	品牌	型号	制造商 (产地)	数量	单位
1						
2						
3						

附件 2：

设备零配件、消耗品、耗材（试剂）购买价格清单

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价(元)	对应的投标 设备名称	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							



附件 3：设备零配件、消耗品、耗材（试剂）最低价承诺书

最低价承诺书

我司参加“昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备项目”的招标项目，项目编号:XXXX,我公司中标设备 XXXX,对该设备使用的耗材价格做出如下承诺：提供零配件和耗材，价格为同等级医院的全疆最低价。

承诺单位法定代表人（签字）：
承诺单位（盖章）：

日期：__年__月__日



附件 4：招投标参数正负偏离表盖公章



附件 5：法人授权书盖公章

法人代表授权书

本授权书声明：注册于 (XXXX) 的 (XXX 有限公司)，在下面签字的法人代表 (XX、总经理)，代表本公司授权在下面签字的 (XXX、销售经理) 为本公司的合法代理人，就 (昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）XXX 项目) 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 XXX 年 XX 月 XX 日签字生效，特此声明。

注：被授权人与法人身份证（正反面）扫描件

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公 章：

授权日期：XXX 年 XX 月 XX 日



附件 6：服务承诺书盖章（需提供厂家售后服务承诺书）

服务承诺书

- 1、提供整机免费全保三年（从验收合格之日起开始计算）终身免费维护。
- 2、 系统软件免费升级，需要时与医院各系统无条件免费连接。
- 3、 维修响应时间：维修响应时间 2 小时，接到故障报告后在 4 小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过 2 个工作日，否则乙方需提供备用机供临床使用。
- 4、 提供保修期后无偿技术支持。
- 5、 提供维修、检测和报错系统软件。
- 6、 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。
- 7、 国内有 800 免费电话、维修系统，并提供 7*24 小时服务，提供详细电话号码。
- 8、 配件服务：保修期以外维修配件的价格，我公司承诺按产品的成本价供货。
- 9、 对所提供的产品中在质保期内如有质量问题，可免费更换新品。

承诺单位法定代表人（签字）：

承诺单位（盖章）：

日期： 年 月 日



附件 7：反商业贿赂承诺书盖公章

反商业贿赂承诺书

我单位办理了编号为：_____的招标文件（项目编号：XXXXX）。为确保质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

杜绝任何形式的商业贿赂行为。在设备招采、合同签订及设备验收环节不给医院有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。严格按投标承诺履行合同，如有违反，用户有权依照相关法律追究相应责任。

我们将认真履行以上承诺，并接受监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人（签字）：
承诺单位（盖章）：XXXX

日期：__年__X月__X日



附件 8：中标通知书复印件加盖公章

第五章 采购需求

2024年第二批国产医疗设备购置分包

序号	项目名称	数量	单位	预算单价 (万元)	预算总价 (万元)	分包
1	口腔种植机	1	台	15	15	1
2	口腔牙片机	1	台	5	5	
3	口腔扫描仪	1	台	15	15	
4	口腔综合治疗台	4	台	8	32	2
5	根管马达	1	台	5	5	
6	脑反射治疗仪	2	台	5	10	3
7	超声波治疗仪	2	台	5	10	
8	体感音波反馈系统	1	台	35	35	4
9	超声波清洗机	1	台	2	2	5
10	血液透析机	3	台	16	48	6
11	子痫检测设备	1	台	40	40	7
12	超低温冰箱	2	台	5	10	
13	心衰超滤脱水装置	1	台	80	80	8
14	磁刺激仪	1	台	75	75	9
合计		22			382	



第一包

1.口腔种植机

设备选型：口腔种植机 产地：国产 数量:1 套 预算金额：15 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

（一）、主要技术参数要求：

★1.马达空载转速： 300~40,000 rpm

2.弯手机齿轮速比： 20:1

3.扭矩范围： 5-80 N•cm

4.蠕动泵流量： 0~110ml/min

5.主机重量： ≤3.5 kg

（二）、功能简介：

1.可视化种植机图案界面≥7英寸，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。

2.适配多种转速比的机头: 16:1 、 20:1 、 27:1 、 1:1 、 1:2 、 1:3 、 1:5。

3.采用进口微型马达，强劲有力，5.5Ncm 的电机扭矩保证终端输出达 80Ncm。

★4.采用进口轴承，弯手机跳动幅度小于 0.02mm，使用更平稳，寿命更长久。

5. 水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

（三）、主要配置要求：

1.带光电机 1个

2.轴承带光弯手机 8把

3.多功能脚踏 1个

4.一次性口腔输水管 4 包

5.专用小推车 1台

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。



★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



2.口腔牙片机

设备选型：口腔牙片机 产地：国产 数量:1 套 预算金额：5 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

- 1.进口射线发射器
- 2.射线类型：X 射线
- ★3.射线焦点 0.4mm
- 4.射线方向和分布：限束器出口方向直径 60mm
- 5.焦点-皮肤距离：20.5cm±0.5cm
- 6.输出辐射场：圆形，φ6cm±0.5cm
- 7.剂量率：6mGy/s
- 8.靶材及靶角:钨靶 12.5°
- ★9.管电压:65kV ±10%
- ★10.管电流:7mA ±20%
- 10.负载循环 1/30
- 12.固有滤过:0.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004
- 13.附加滤过:1.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004
- 14.总 滤 过:2.0mmAl/65kV,YY/T0062-2004
- 15.半 价 层:65kV 时为≥1.6 mmAl
- 16.漏辐射率:1 米处≤0.25mGy/h(65kV,7mA,1s,加载间隔 1s/30s)
- 17.加载时间调节范围:0.04s-2.0s ±(10%+1ms),
- 18.泄漏辐射加载因素:曝光 1 秒停 30 秒
- ★19.报警功能:具有故障自动检测故障代码显示功能，参数可重新设置并保存
- ★20.数字化拍摄: 预留多种拍摄模式。
- 21.X 射线管头垂直旋转角度:≥260°
- 22.X 射线管头垂直移动范围:≥480mm
- 23.座椅面上线移动范围：≥120mm
- 24.座椅能承受的负荷：≥135KG



二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



3.口腔扫描仪

设备选型：口腔扫描仪 产地：国产 数量：1 套 预算金额：15 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

（一）、设备总体要求：

机架结构为触控屏电脑口扫一体机。用于口腔义齿修复、口腔正畸和口腔种植等口腔内部的数字化三维取模。体积轻便小巧，智能快捷，可实时获取患者可靠的高精度真彩数字印模。通过强大的云平台集成服务系统无缝传输到技工端订单管理系统，满足多种应用场景，助力医技高效协同。

（二）、主要技术参数要求：

- 1 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪
- 2 扫描范围： $\geq 16\text{mm} * 12\text{mm}$ （标准口扫头）， $\geq 12\text{mm} * 9\text{mm}$ （迷你口扫头）
- ★3 扫描景深： $\geq 22\text{mm}$
- 4 扫描精度(std.): $\leq 0.020\text{mm}(3\text{Teeth})$; $\leq 0.05\text{mm}(\text{Single Jaw})$
- 5 扫描帧率： ≥ 20 帧/秒
- 6 机身重量： $\leq 239 \pm 20\text{g}$
- ★7 扫描头配置/外径:
 - 7.1 标准头：总长 119mm，前端 $\leq 20\text{mm} * 17\text{mm}$ ；迷你头：总长 119mm，前端 $\leq 16\text{mm} * 12\text{mm}$
 - 7.2 扫描头使用次数：高温高压灭菌 ≥ 100 次
- 8 产品使用期限： ≥ 8 年
- 9 具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能
- 10 扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备 ≥ 3 种状态指示灯
 - 10.1 蓝灯表示：数据拼接不成功；
 - 10.2 绿灯表示：链接状态/待机状态/休眠状态；
 - 10.3 橙灯表示：设备异常。
- 11 具备口扫头插拔状态指示灯提醒；



12 无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失

13 支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度。

14 具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。

★15 集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材。

★16 集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统。

17 体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。

18 扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）。

19 边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。

★20 精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。

★21 具备正畸模拟功能：

21.1 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画；

21.2 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等

21.3 支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享

22 具备云传输功能：

22.1 具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT 数据

22.2 支持云端预览真彩 3D 数据

22.3 同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身。

(三)、触控屏电脑工作站技术要求：

1.处理器： i7-12700 (12 核/25MB/20T/2.10 GHz 至 4.90 GHz/65 W)

内存： 32 GB, 4800 MHz



2.主机端口： RJ-45*1、USB 3.2 Type-A*4、DisplayPort 1.4*3、SMA 天线接头*2

3.无线网卡： 英特尔 AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.4 GHz/5 GHz/6 GHz、

4.Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)、蓝牙 5.2

5.存储： M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe x4, SSD

6.显卡： NVIDIA RTX A2000 GDDR6 12GB

7.电源： 330W

8.操作系统： Win10 专业版

9.显示器规格参数：显示器端口： HDMI 1.4*1、DisplayPort 1.2*1、VGA*1、USB 3.2 Type-C*2、USB 3.2 Type-A*3、音频输出*1、RJ-45*1, 显示屏： 23.8", 分辨率：1920 x 1080, 尺寸 (不含支架) (高×宽×深)： 320.98mm × 538.80mm × 54.10mm

(四)、UPS 电源:

1.输入电压： 220VAC, 输入电压范围： 100VAC ~ 240VAC

2.电池类型： 锂电池。满电待机时长： 8 ~ 10 小时

(五)、主要配置要求:

1.扫描仪主机	1 台
2.触控屏电脑工作站	1 台
3.UPS 电源	1 台
4.口扫一体机推车	1 台
5.标准口扫头	12 个
6.迷你口扫头	3 个

二、其他:

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。



★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



第二包

4.口腔综合治疗台

设备选型：口腔综合治疗台 产地：国产 数量 4 套 预算金额：32 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

主要配置要求：

（一）、医生位：

1、按压快接高速四孔高端手机 2 支，全套进口机芯；高端气动低速手机 1 套（含直机、弯机、马达）可高温高压消毒。

2、三用喷枪 1 支

3、医生位多功能程序控制盘

（二）、助手位：

1、1 支三用喷枪

2、1 支强吸/1 支弱吸

3、内置式 LED 观片灯

4、预留加装位一个

（三）、其它配置：

1、LED 口腔灯 1 个

2、多功能脚控开关 1 个

3、一体式无缝旋转陶瓷漱口盆 1 个

4、纯净水/蒸馏水系统 1 套

5、医生座椅 1 把

6、护士座椅 1 把

主要性能参数要求：

1、患者椅

1.1、治疗机与牙科椅连体式设计，方便拆卸、维护。

1.2、座椅高度可在 410 至 720 毫米范围内调节，负载 $\geq 130\text{KG}$ 。

★1.3、具有变频防抖动技术。

1.4、座椅和椅背联动设计，避免背部牵拉及搓背感。



1.5、多关节折叠式头枕，适应不同的治疗体位，满足特殊患者治疗，如：儿童、轮椅患者等。

1.6、采用进口品牌静音电机。

1.7、进口皮制作靠背及座垫。

2、医生治疗台

★2.1、液晶显示屏，显示治疗机使用状态

★2.2、具备三个医生设置，每个界面下可以设定并存贮 3 套共 9 个智能记忆程序控制记忆椅位，

2.3、具备故障代码显示。

2.4、具备水温显示。

2.5、电脑控制面板具有复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能。

2.6、具备一键式智能控制工作体位、一键式漱口体位、复位。

2.7、器械盘采用气压锁定装置，安全平稳。

2.8、具备大型注塑器械盘，配有透明整体防污罩，防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染，提供防污罩实物，防污罩可根据临床需求定期更换。

2.9、具有医师位防脱整体五联器械枪架，可旋转 90 度功能。

★2.10、具有内置式手机净化水系统 1 套，外置隐藏加水口。

2.11、具有冲盂漱口定量给水自动控制系统 1 套：进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

2.12、痰位冲盂联动设置、漱口冲盂联动设置

3、助手治疗台

3.1、助手臂可旋转，方便四手操作。

3.2、助手位设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留加装升级位。

3.3、可配置多功能三用枪、强吸、弱吸等。

3.4、配有内置式 LED 观片灯，采用背光源发光技术。。

4、多功能脚控

4.1、超薄设计，符合人体工程学。



4.2、具有多种功能：

4.2.1、可控制患者椅位运动

4.2.2、可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械

4.2.3、可控制高速手机单喷气/无水操作

4.2.4、可控制高速手机吹屑气操作

4.2.5、可控制牙科椅治疗位及手术灯开启及关闭

5、卫生及消毒系统

5.1、牙椅表面采用无缝设计和镜面处理，便于清洁消毒。

5.2、强、弱吸唾系统各 1 套，外置式重金属回收器，方便清洗消毒。

5.3、医生治疗台器械盘防护罩可拆卸更换，防止交叉感染。

5.4、吸唾系统：吸唾器头可拆卸进行清洗。

★5.5、内置蒸馏水/纯净水系统：适用于治疗中的无菌操作需求。

5.6、主箱体为注塑工艺，可转动，主箱体上方有隐藏磁吸式增、泄气开关，方便注水，纯净水/蒸馏水瓶注水时无需旋下瓶体，使更换纯净水/蒸馏水变得更加轻松方便。

★5.7、管路消毒功能，系统按照设定好的程序进行管路消毒。

6、漱口盆

6.1、一体式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。

6.2、可在 90 度范围内旋转，方便患者使用

3)。

7、安全保护系统

7.1、机椅互锁：当动态器械工作时，牙科椅不能运动，防止误操作造成意外伤害。

7.2、具有解度传感系统，当椅座下降过程遇到障碍时，下降运动被终止并自动小幅上升，避免意外伤害的发生。

★7.3、具有开机自检功能：开机 30s 内，长按自检键进入设备自检程序。自检项目包括口腔灯、牙椅升降俯仰、冲盂、漱口。



★7.4、恢复出厂键：开机 30s，长按恢复键可椅位恢复到出厂设置的极限椅位，出厂设置的 1、2、3 特定椅位，漱口水时间，水温，冲盂时间，痰位冲盂联动等功能。

★7.5、锁屏功能：按下锁屏键按下任何按键均无动作。可长按锁屏键解除或者在锁屏状态下用脚开关上牙椅位置控制按键中任何一个进行快速解锁。

8、口腔灯

8.1、可调 LED 口腔灯，手柄可拆卸消毒。

8.2、可以通过灯头开关、医生位、助手位控制面板及脚控开关实现手术灯关闭。

★8.3、口腔灯和椅位智能联动功能，当进行治疗时口腔灯自动打开；当吐痰复位时口腔灯自动熄灭。

9、医生椅

座椅高度可调节，最低椅位 425mm，行程 120mm，符合人体工程学。

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



5.根管马达

设备选型：根管马达 产地：国产 数量：1 套 原酸金额：5 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

（一）主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。

（二）、功能特点要求：

1、采用高性能无制电机、扭力大、寿命长、转速高、噪音小、发热小、输出更精准、更稳定、更高效；

2、超迷你 6:1 减速比弯机头、360°可旋转、使治疗更方便、口内视野更开阔；

3、采用实时反馈技术.对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针：

★4、往复模式角度每 10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效：

5、无线手柄.操作更自如：

★6、9 种自定义程序和内置多种主流锉系统.内置过台阶模式：

7、扭矩和速度范围宽.速度：100-2500rpm,扭矩 0.4—5.0Ncm：

★8、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；

9、手柄无线充电。

（三）、设备安全分类：

1、按运行模式分类：连续运行设备：

2、按防电击类型分类：带内部电源的 II 类设备：

3、按防电击程度分类：B 型应用部分：

4、对进液防护程度：普通器材（IPX0）：

(四)、主要技术参数要求：

★1、手柄电池：3.7V/2000mAh 可充电锂电池

★2、速度：150—2500rpm

★3、扭矩：0.6-3.9Ncm

(五)、主要配置要求：

1、底座	1 个
2、手柄	1 个
3、弯手机	5 个
4、注油嘴	1 个
5、电源适配器	1 个
6、测量线	2 根
7、锉夹	10 根
8、探针	4 根
9、唇挂构	10 根

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。



三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



第三包

6.脑反射治疗仪

设备选型：脑反射治疗仪

产地：国产数量 2 套

预算金额：10 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

★包括仿真生物电刺激小脑顶核（2 组）+仿真生物电刺激患肢肌肉神经（2 组 8 线）

★1.国家认可的产品注册证要体现“脑反射”字样。

2.产品外观：本设备立式推车式，屏幕为 ≥ 7 寸*2 触摸屏真彩显示。

3.磁疗输出部分基本参数：

(1) 治疗体磁感应强度： 低档： $6\text{mT} \pm 3\text{mT}$ ；强档： $14\text{mT} \pm 4\text{mT}$ ；

(2) 治疗体磁场频率： $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$

(3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁治疗帽有 6 个治疗体，头围部分 5 个治疗体可以横向移动， 也可根据患者头围大小调节治疗帽子的弹力带。

(4) 治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测

(5) 设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。

(6) 时间选择：治疗仪具有定时功能，可在 1min~99min 范围内设定所需时间。

(7) 治疗帽的各导线连接部位能承受 $\geq 20\text{N}$ 拉力。（提供检测报告）

(8) 微震按摩功能：a)震动幅度：分 4 档可调（1-4）

b)震动频率：分 5 档可调(1-5)

电疗输出部分基本参数：

★5.1 耳后低频电脉冲性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：小儿脑瘫相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）；



5.2 电刺激输出最大电压峰峰值：80V±20%，分 60 级可调。其最小输出值不超过最大设定值的 2%；输出设定 1min ~ 60 min, 开机预设置时间为 30min, 步进 1min, 定时误差±5%。

7、提供产品检验报告。

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

每台设备在原有的治疗帽的基础上额外配置 4 套治疗帽

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



7.超声波治疗仪

设备选型：超声波治疗仪 产地：国产 数量 2 套 预算金额：10 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1、柜式一体机， ≥ 8 英寸彩色液晶。（提供彩页及技术白皮书）

★2、仪器配有 4 个治疗探头，三个 1MHz 治疗探头、一个手持移动式 3MHz 治疗探头（提供相关证明文件）

3、1MHz 和 3MHz 治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

4、输入功率：100VA

5、额定输出功率： $5W \pm 20\%$ ；

★6、额定输出有效声强： $\leq 3W/cm^2$

7、波束类型：准直型。

8、波束不均匀系数： ≤ 8 。

9、十种占空比：0~90%可调，步进为 10%。

10、治疗时间： ≤ 30 分钟。

★11、输出模式：9 档脉冲模式和 1 档连续模式。

12、治疗头有效辐射面积：3MHz 治疗头为 $\geq 2.0cm^2$ ，1MHz 治疗头为 $\geq 2.5cm^2$ ；

13、治疗头对有害进液的防护程度分属于 IPX7，可以水下操作

14、调制波形：方波

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。



★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



第四包

8.体感音波反馈系统

设备选型：体感音波反馈系统 产地：国产 数量 1 套 预算金额：35 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1、设备利用心理音乐、心理电影及心理图片深入人的内心世界，让使用者达到放松目的，稳定情绪、调节压力、提高身心健康和工作学习效率。

2、输入功率： 主机： < 300W；单体治疗体： < 100W；

3、工作频率：≥2.4GHz；最大空旷传输距离：≥2KM；最大理论组网数量：≥255组。

★4、具有体感音波技术、音乐疗法技术、生理指标反馈技术、无线传输技术。

5、产品配置： 品牌身心反馈主机≥19 寸液晶显示器 1 套+体感音波沙发 15 套。

6、系统包括压力评估、数据中心、调节训练、体感音波四大模块。

7、功能压力评估与训练相结合：通过压力评估，生成压力评估报告，使用者能够准确了解自己当前的压力指数，并可获得压力管理指导建议。

8、评估报告：压力反应等级图、压力反应各维度分析图、生理反应维度分析图、情绪反应维度分析图、行为反应维度分析图、认知反应维度分析图。

★9、提供放松训练、音乐调适和自主调节三种调节方法。其中，放松训练不少于三类放松；音乐调试不少于四类；自主调节即反馈调节，心率、血氧、脉搏为基础的多种生物反馈信号。

10、自动储存历次压力评估、调节训练数据：系统后台数据库可以将使用者历次的压力评估、调节训练数据储存起来，以便进行后续研究性工作。

11、自动生成图文报告：报告以图形加文字方式显现，清晰地记录使用者整个过程相关数据，可以对调节训练进行客观的指导。



12、报告查看方便，可以导出与打印。

★13、心理视听资料介绍（心理视听资料含心理音乐、心理图片、心理视频、心理电影、心理小常识）

14、心理音乐分为振奋类、激扬类、放松类、中医五行类、脑电波类、冥想类等，各项不少于 8 首。

15、心理图片：放松图、错觉图等。

16、心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频。

17、心理电影：≥3 部

18、心理小常识：txt 文字版≥38 篇。

★19、体感音波沙发：随音律而波动按摩；使用无线传输技术，达到 1 拖 15（即 1 个主机同时控制 15 个沙发）的功能；软件控制：既可以个体设置曲目、音量、体感振动以及时间（按照序号），也可以全体设置曲目、音量、体感振动以及时间。

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

另配：15 个耳机



四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

第五包 9.超声波清洗机

设备选型：超声清洗机 产地：国产 数量 1 套 预算金额：2 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

序号	项目	招标要求
一：设备参数及配置		
1	技术要求	
1.1	清洗舱	
1.1.1	容积	≥10L
1.1.2	材质	304 不锈钢材质
1.2	外罩	
1.2.1	开门方式	手动开关门，门板可挂于外罩之上
1.2.2	材质	ABS 模具注塑成型，外观精美
1.3	管路系统	
1.3.1	★前置排水 阀	手动排水，操作简单
1.4	超声系统	
1.4.1	变频电源	40/80/100KHZ，变频功能，功率可调
1.5	控制系统	
1.5.1	★多程序选 择	设备设有就绪、单频、双频、多频清洗四个程序， 一键操作，方便快捷
1.5.2	控制方式	触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自 动检测功能；独立的电源控制模块，安全可靠。

1.5.3	温度指示器	数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。
1.5.5	安全保护	超时保护功能：加热片干烧保护。
1.6	整体参数	
1.6.1	运行时间	依据设定时间而定，0-60min 可设
1.6.2	外形尺寸	因场地限制，外形尺寸≤420*410*330（宽深高）
1.6.3	清洗温度	35℃（推荐温度）30℃～80℃可调
1.6.4	加热方式：	电加热 0.4kw
1.6.5	超声频率	三频：40/80/100KHZ
1.6.6	超声功率	240W

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 8 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



第六包

10.血液透析机

设备选型：血液透析机 产地：国产 数量：3套 预算金额：48万元

一. 设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

1. 供水：压力：100—700kPa；温度：5—30℃。
2. 透析液流速：设置范围：300—780mL/min，任意可调。
3. 透析液温度：设置范围：34—39℃，可实时监测及可调。
4. 脱水速度：设置范围：0.0—4.00L/h，脱水精度：±30mL/h 或透析液流量±0.1%。
5. 漏血检测器：方法：光电式检测，精度：≤0.40mL/min。
6. 动脉血泵：设置范围：50—600mL/min。
7. 肝素泵：设置范围：0.0—9.9mL/h；注射器类型：10、20、30mL 均可用，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。
8. ★空气检测器：方法：超声波；检测精度可达到：0.001mL。
9. 泵前动脉压：测量范围：-300—+280mmHg。
10. 透析器血液入口压：测量范围：-200—+700mmHg。
11. ★静脉压：测量范围：-200—+480mmHg。
12. TMP：测量范围：-100—+480mmHg。
13. 透析液压：测量范围：-600—+600mmHg。
14. 碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—7.0mS/cm。
15. 透析液浓度：测量范围：12.0—16.0mS/cm。

系统功能概述

1. 人机交互：≥12 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等为中文或英文显示。
2. 信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态。
3. 报警提示功能：360°可视三种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。
4. 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，



热水柠檬酸消毒温度最高 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，消毒、脱钙一体化完成时间 $\leq 36\text{min}$ 。

5.后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作 20 分钟；具备断电状态保存功能，任意时刻恢复供电至断电前的治疗状态。

6.★超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

7.浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存 ≥ 8 条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析。

8.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存 ≥ 8 条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析。

9.B 液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

★10.通讯组件：标准配置通讯组件，可连接医院透析机信息化管理系统。

11.液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简易、方便。

12.原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

13.透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高，减少微炎症反应和感染风险，提高治疗安全。

14.KT/V 计算：标准配备 KT/V 计算功能，帮助医护人员评价透析处方的合理性，辅助调整治疗方案。

15.提供一份在新疆不得少于 40 家客户的名单。

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

★6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：



1. 3 套全套。
2. 3 年内每台机器免费提供细菌过滤器，并进行更换。

3. 血透质控设备 1 台

4. BPM 在线血压监测组件

设备的选配件（需另外购置的）及技术要求：主要选配件

1. BVM 双通道血容计组件。
2. Hemo-master 生物反馈系统。
3. BPM 在线血压监测组件。
4. DDM 在线清除率监测组件。
5. 浓缩液集中供给接口。

设备的辅助设施要求（外围的、基建的、环境的、配套件）：

基本设备：配备满足工作需要的水处理设备、供氧装置、负压吸引装置，必要的职业防护物品；

急救设备：心脏除颤器、简易呼吸器、抢救车。

信息化设备：至少具备 1 台能够上网的电脑

四、售后服务及要求：

1. 要求提供中英文操作手册/维修手册或维修光盘及维修密码开放。
2. 售后服务：免费维修 3 年，定期（6 个月）对仪器维修养护。
3. 免费培训医护人员 2 名，（在具有血透培训资质的中心培训 3 个月，获得血液净化上岗资质。），免费培训设备维修工程师 1 名（取得血透机维修证书）。
4. 协助定期监测反渗水、透析用水质量，提供测定透析用水硬度及余氯的试剂。每季度对循环水路进行化学消毒。免费一年做一次化学污染物监测。
5. 维修服务要求接报告后 2 小时内到位维修，且不影响次日的血透工作。
6. 在疆内不得少于 3 个维修工程师工作人员，并提供办事处地点和社保证明。



第七包

11.子痫检测设备

设备选型：子痫检测设备 产地：国产 数量 1 套 预算金额：40 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

★1.最快检测速度：≥360 测试/小时；

★2.检测原理：基于先进的磁微粒吖啶酯直接化学发光反应体系；

3.试剂位：≥24 个，支持在机冷藏，不停机在线添加，随存随取，支持扫码获取试剂信息

★4.试剂针：3 根相互独立的试剂针，支持自定义加样模块，智能调度分配，高速移液

5.样本针：独特的特氟龙镀层样本针

6.样本位：≥96 个，支持在线装载、连续进样，支持智能识别样本条码

★7.进样系统轨道式进样；支持串联/并联双模式流水线联机多台并机；专属定制，自由组合

8.反应杯：一次性可添加≥1000 个反应杯，支持随时散装添加，自动排杯

9.急诊功能：≥12 个急诊位，随时急诊检测、支持急诊优先测定

10.孵育槽温度：37℃±0.5℃，波动度不超过 1.0℃；自动对温度进行补偿调节

★11.检测项目：可用于检测胎盘生长因子（PIGF）、可溶性 fms 样酪氨酸激酶 1（sFlt-1）、抑制素 A(INHA)、涎液化糖链抗原（KL6）、抗磷脂酶 A2 受体抗体、抗核抗体谱、抗血管炎抗体、同时还可检测肿瘤标志物、性激素项目

12.显示设备：仪器主机与控制电脑一体化，15 寸触控屏输入

13.输入/输出设备：内置高精度条码读取器+外置手持扫码枪；支持外拓独立显示器、打印机，UPS、灵活多变的数据处理方式，支持在线编辑、存储、查询、打印



- 14.LIS 系统：多类型 LIS 联接端口，支持单向、双向 LIS 的静态 IP 地址网络传输
- 15.软件系统全中文操作界面，简便，流畅，随机、批量、急诊多种操作模式，全天候在线远程技术支持和维护
- 16.自动维护功能：支持一键维护，仪器自动进行保养维护，无需人为干预
- ★17.远程诊断功能：支持远程通信功能，自动传输仪器故障信息，实现云平台诊断
- ★18.自动稀释功能：具有自动稀释样本的功能、对超出限定范围结果，仪器根据判断条件自动进行稀释处理
- 19.自动重测功能：具有样本自动重测功能，对超出限定结果，仪器自动完成样本重测处理
- 20.智能耗材管理：双底物备份系统、清洗液/洗涤液/反应杯等耗材智能监控系统；自动计数；实时监测，废液智能监测排放、报警，废弃物固液分离，过载提示、报警
- ★21.智能系统：直线运动轨迹配合独创的拉条构造，有效提高检测速度。支持旋涡混匀、12 针清洗结构及多阶清洗方式，使反应物混匀、清洗更加充分。支持自动开关机，异常情况实时自诊断、自处理、自保护，减少故障停机时间
- 22.携带污染率：< 1.0ppm

二、其他：

- 1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表
- 2、提供设备配置的详细清单
- ★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。
- ★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。
- ★5、出现故障不能解决则提供备用机



6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

该项目为交钥匙工程，满足科室实际使用需求。

低温离心机 1 台、隔水式恒温培养箱 2 套，实验计时器 20 个、超净工作台 1 套、满足科室实际使用需求。电脑 2 台。

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 5 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



12.超低温冰箱

设备选型：超低温冰箱 产地：国产 数量 2 套 预算金额：10 万元

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

（一）、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等。

（二）、技术要求及配置：

2.1 样式：立式。

2.2、有效容积 $\geq 390\text{L}$ 。

★2.3、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在 $-40^{\circ}\text{C} \sim -86^{\circ}\text{C}$ 范围内，控温精度 0.1°C 。

★2.4、显示： ≥ 7 寸高性能 LCD 触摸屏，显示精度 0.1°C ，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙或 WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

2.5、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。

★2.6、安全存储：14 种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。

2.7、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

2.8、无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷



回路。

2.9、进口高效压缩机，进口低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停，具备节能认证证书。

2.10、25℃环温时，单日耗电量 $\leq 8\text{KW.h}/24\text{h}$ ，可提供省级以上第三方检测报告。

2.11、一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。

2.12、25℃环温时，空载降温到 -80°C 时间 $\leq 5\text{h}$ 。

2.26、标配 5V 冷链供电系统，二氧化碳后备系统。

2.27、标配 RS485 数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

2.28、标配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。

2.29、标配冷链监测系统。

2.30、可存储 2 英寸标准冻存盒 300 个，2ml 标准冻存管 30000 支。

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

1、赛默飞各型号移液器 3 套。（0.2-2ul，1-10ul，2-20ul，5-50ul，10-100ul,20-200ul,100-1000u）



2、实验室温湿度计 10 个

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 5 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

第九包

14.磁刺激仪

设备选型：磁刺激仪 产地：国产 数量 1 套 预算金额：75 万元

序号	一、技术参数
1	适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，可以用于吞咽障碍、肌张力障碍、神经源性尿失禁、帕金森病、阿尔兹海默症等。
2	主机
2.1	★一体式可推移整机结构（防止跌落风险）：a)静音脚轮设计； b)可固定线圈支架；（彩页或检测报告证明）
2.2	★冷却系统：恒温线圈（内含液态内循环冷却系统），非风冷或静态液冷；（彩页或检测报告证明）
2.3	★操作系统：人机交互系统采用便携 PC 机控制操作，中文界面，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。
2.4	刺激强度：1.0-6Tesla 连续可调；
2.5	磁感应强度稳定输出允差：±5%；
2.6	磁感应强度最大变化率：至少包括 40kT/s-70kT/s；
2.7	磁感应强度最大变化率允差：±5%；（彩页或检测报告证明）
2.8	脉冲上升时间：至少包括 60μs±10μs；
2.9	输出脉冲宽度：至少包括 340μs±20μs（若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≥260μs）
2.10	刺激频率：0.1-80Hz 可调；



2.11	脉冲频率 $\geq 1\text{Hz}$ ，步进为 1Hz ；脉冲频率 $< 1\text{Hz}$ ，步进为 0.1Hz ；
2.12	脉冲频率允差值： $\pm 2\%$ （彩页或检测报告证明）
2.13	★电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达 4000VAC （彩页或检测报告证明）
3	安全预警：
3.1	当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。
3.2	在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。
3.3	磁刺激线圈表面温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$
3.4	★具有电容计数功能，当计数达到 $10,000,000$ 次后弹出提示框，设备停止工作。（彩页或检测报告证明）
3.5	可在 100% 设备强度下使用模式化脉冲(TBS)。
4	刺激线圈：
4.1	刺激线圈标配：成人八字形线圈*2、成人圆形线圈*2、
4.2	★线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型； （彩页或检测报告证明）
4.3	具有电动吸液和电动排液功能。
5	软件功能：
5.1	电脑操作管理方式，能实现： a)1T 固态硬盘储存、USB 储存，内存大于 8G ；必须和院内信息网络链接



	b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出; c)刺激模式图形(数字)仿真、温度显示与控制保护。
6	检测模式:
6.1	检测项目: 支持运动阈值(MT)、运动诱发电位(MEP)、 中枢神经传导时间(CMCT)、静息期检测等的检测功能;
6.2	检测记录: 运动阈值与治疗方案自动记忆功能, 可对保存文档 中波形与数据进行复现;
6.3	具备自动计算神经传导时间功能;
6.4	实时 MEP (EMG) 信息显示;
6.4.1	★双通道 MEP 检测功能, 采样率不低于 100KHz。(彩页或 检测报告证明)
6.4.2	传输方式: 有线传输, 非无线传输, 确保信号稳定。
6.4.3	最小分辨率: $\leq 0.2\mu V$ 。
6.4.4	频率测量范围: 1Hz~25KHz。(彩页或检测报告证明)
7	刺激模式
7.1	单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND 刺激的多种刺激模 式自由调整。
7.2	★支持双人同时治疗, 双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间 和刺激间隔可完全独立调节, 并且无强制关联关系, 两线圈可 同时输出脉冲。
7.3	定时时间按照方案的需要设置, 在预定时间(方案的总时间) 到达后设备自动终止磁场输出, 允差: $\pm 10\%$ 。

7.4	内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。
7.5	能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。
8	具备触发输入输出通用接口。
9	设备生产厂家取得国际认证机构认证的 ISO13485 质量体系认证。
10	开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

磁刺激器主机	1 台
恒温冷却系统	1 套
系统操作软件	1 套
刺激线圈	圆形或八字形 /共 4 副
MEP 模块	双通道/1 个

支架	4 个
刺激定位帽	40 套

另配：激光彩色打印机 1 台，电脑桌椅一套，满足临床需求。

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



第六章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。



一、投标文件封面格式

正本/副本

昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等
22 台（套）医疗设备项目

项目编号： XJZC(CG)2024-021

(标项 X)

投标文件

投标人名称： （全称并加盖公章）

投标人法定代表人： 电话（座机）：

总经理/项目负责人： 手机（实名）：

投标人授权代表人： 手机（实名）：

投标人授权代表人身份证号：

投标人QQ邮箱号：

邮 政 编 码：

日期：2024年__月__日



二、投标文件组成：（按此顺序编写目录）

供应商自查索引表

1、 投标函

1.1、反商业贿赂承诺书

2、 报价一览表

2.1、投标报价明细表

2.2、设备简要说明一览表

3、 商务/技术响应与偏离表

4、 资格证明文件

5、 投标人主要业绩

6、 货物说明

7、 实施方案

8、 售后服务表

9、 人员配置表

10、 投标人认为应提供的其它资料

注：招标文件的内容包括但不限于上述内容，如有不足请自行补充。

三、 供应商自查索引表

3-1 资格审查索引表

序号	审查内容	自查结论	详见 投标文件
1	投标人营业执照彩扫描件，以及投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
2	2022 年度或 2023 年度的审计报告（成立不足 1 年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、利润表、现金流量表）（提供彩扫描件）。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
3	履行本合同所必需的设备清单和具有专业技术的人员清单或承诺书。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
4	提供 2024 年第一季度完税证明及相关人员近 6 个月任意 1 个月的社保缴纳证明；投标人依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商电子公章。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
5	提供没有重大违法记录声明函。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
6	提供法律、行政法规规定的其他条件的书面声明或承诺。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
7	本项目专门面向中小企业，供应商应所投货物的生产厂家须为中小企业，投标时须提供《中小企业声明函》（货物）。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
8	供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证，如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。（按要求提供证明文件）	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
9	信用情况承诺书。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
10	供应商关联企业情况表。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
11	按招标文件规定交纳投标保证金/电子保函。（加盖公章）	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的口打“√”。

3-2 符合性审查索引表

序号	审查内容	自查结论	详见投标文件
1	投标文件的签字、盖章是否符合招标文件规定。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
2	法定代表人身份证明及授权委托书有效是否符合招标文件规定的格式。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
3	每个标项是否只有一个方案投标。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
4	对招标文件规定的供货范围（服务内容）是否全部作出响应。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
5	交货期(完成期限)是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
6	质保期及售后服务是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
7	投标有效期是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
8	投标文件承诺的付款方式是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
9	投标文件是否附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
10	其报价是否超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
11	质量技术是否满足招标文件提出的技术和功能要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

3-3 综合评分索引表

序号	评分因素	评标标准	详见投标文件
1			第__页
2			第__页
3			第__页
4			第__页
5			第__页
6			第__页
7			第__页
注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的口打“√”。			



四、投标文件格式范本：

1、投标函

昌吉回族自治州人民医院：

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址 _____ 我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的(招标项目名称) (编号为 _____)的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为 90 日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日期： 年 月 日



1.1反商业贿赂承诺书

在（项目名称：_____、项目编号：_____）磋商活动中，我公司承诺如下：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假磋商、陪标、串通磋商，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次磋商权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招标投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日期： 年 月 日

2.1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	标项名称	总报价（元）
1		小写：_____； 大写：_____。
供货时间：		

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

- 注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。
- 2.投标报价为完成本次采购项目内的所有内容的一切相关费用。可根据需要附报价明细。
- 3.投标总价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。
- 4.本表中“投标总价”须与《报价明细表》中的“投标总价”保持一致，如不一致，以《报价一览表》为准。

2.2 投标报价明细表

(设备、材料、系统费用及其他费用)

项目名称：项目编号：

序号	标的名称	品牌	规格 型号	注册 证号	数量	单位	单价	总价	产地	生产 厂家	备注
	...										
其他费用											
合计总报价（小写）：											
合计总报价（大写）：											

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

注: 1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果报价一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。

4.合计总报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

上述报价包含一切由供方承担的费用。

2.3 设备简要说明一览表

项目名称：

项目编号：

序号	设备名称	规格型号及 主要技术参数	性能说明	供货 厂(商)
1				
2				
3				
...				

注：此表需详列投标的每种设备。

备品、备件清单

序号	备品、备件 名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	合计
1							
2							
3							
...							

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

3、商务 / 技术响应与偏离表

序号	招标文件 条目号或 页码	招标文件要求	投标响应内容	偏离 情况	说明	投标文件 页码
商务响应与偏离						
1						
2						
3						
4						
技术（采购需求）响应与偏离						
1						
2						
3						
4						
5						
.....						

注：1.对招标文件中的所有商务、技术（采购需求）要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.商务条款包括投标有效期、交货期、供货范围、质保期等。

3.需在偏离表页码栏中明确标注技术参数相对应的技术支持资料的页码，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离。

4.核心技术参数、其他技术指标（一般技术参数）对应的相关证明材料以第三方技术支持资料为准包括：（①检验报告；②医疗器械注册证附件——产品技术要求；③食药局备案过的产品说明书或生产厂家产品说明书；④生产厂家技术白皮书）为准。

5.证明材料需加盖生产厂家公章。

6.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日



4、资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1 具有独立承担民事责任的能力

4.1.1 投标人营业执照彩扫描件

4.1.2 法定代表人身份证明

昌吉回族自治州人民医院:

供应商名称: _____

注 册 号: _____

注册地 址: _____

成 立 时 间: ____年____月____日

经 营 期 限: _____

经 营 范 围: _____主营: _____兼营: _____

姓 名: _____, 性 别: _____, 年 龄: _____系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面:



投标人名称 (盖单位章): _____

法定代表人或其委托代理人签字: _____

日期: 年 月 日



4.1.3法定代表人授权委托书

昌吉回族自治州人民医院:

本人(姓名、职务)系(供应商名称)的法定代表人,现授权(代理人姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义:(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交项目名称:_____ 项目编号:____ 投标文件及报价;(2)签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:_____。

代理人无转委托权。本授权书于____年____月____日签字生效,特此声明。

代理人情况

姓名:_____性别:_____年龄:_____职务:_____

身份证号码:_____电话(实名制):_____

附:法定代表人身份证正反面:委托代理人身份证正反面:



供应商名称(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人签字:

日期: 年 月 日



4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2022 年度或 2023 年度的审计报告（成立不足 1 年的提供成立至今的财务报表，
包含资产负债表、利润表、现金流量表）（提供彩扫描件）加盖公章；



4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

履行本合同所必需的设备清单和具有专业技术的人员清单或承诺书

承诺书

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日



4.4 有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录

(提供 2024 年第一季度完税证明及相关人员近 6 个月任意 1 个月的社保缴纳证明;

加盖投标人电子公章; 投标人依法享受缓缴、免缴税收, 免缴社会保障资金的提供证明

材料加盖投标人电子公章;)



4.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录提供声明函

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____；②法定代表人_____、身份证号码_____；③项目负责人_____、身份证号码_____）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在新疆政府采购网上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

四、我方承诺不存在直接控股或管理关系的投标人同时参加同一合同项下的采购活动的情形。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（印章）：

年 月 日



4.6 法律、行政法规规定的其他条件

提供书面声明或承诺加盖公章

政府采购诚信承诺书

(采购人)：

我公司_____（投标人名称）已详细阅读了项目_____（项目编号：_____）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标；

三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（印章）：

年 月 日



落实政府采购政策需满足的资格要求

投标人声明其所投货物的生产厂家须为中小企业，投标时提供《中小企业声明函》（货物）。

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日



中小企业划型标准规定 (仅作参考填写说明)

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、**本规定适用的行业包括:**农、林、牧、渔业, **工业**(包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 500 万元及以上的为中型企业,营业收入 50 万元及以上的为小型企业,营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元 以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 6000 万元 及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。



(六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入



入 100 万元以下或资产总 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 30 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。

个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

中小微企业划型标准

(仅作参考填写说明)

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服 务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$



备注：

- 1、以下《中小企业声明函》（货物）、《节能、环境标志产品》证明材料、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用。

中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件等 (若有，请如实填写)



4.7 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。
- 2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。
- 3、不符合上述适用情形的投标人无应提供上述声明函。
- 4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



4.8 节能、环境标志产品证明材料

(若有, 请如实填写)

1.节能产品: 应在

中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>)

国家发展改革委网站 (<http://www.ndrc.gov.cn>)

中国质量认证心网站 (<http://www.cqc.com.cn>)

2.环境标志产品: 应在

中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>)

国家环境保护部网 (<http://www.sepa.gov.cn>)

中国绿色采购网 (<http://www.cgpn.cn>)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等, 并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。



4.9 残疾人福利性单位声明函

(若有, 请如实填写)

本单位郑重声明, 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

说明: 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 残疾人福利性单位仅应提供声明函, 不应提供其他证明材料。



4.10 监狱企业声明函

(若有, 请如实填写)

本单位郑重声明, 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定, 本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

说明: 按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定, 供应商除提供此声明函外, 还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则评标时不予以认可。



本项目的特定资格要求

4.11 制造商或生产厂商、代理商或经销商应提供的资质证明

- 1、供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；
- 2、供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证；
- 3、如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。
(按要求提供证明文件)



4.12 信用情况需提供承诺书（格式自拟）

加盖公章

信用中国网 <https://www.creditchina.gov.cn>

中国政府采购网 <https://www.ccgp.gov.cn>



4.13 供应商关联企业情况表

供应商的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

供应商名称（单位公章）：_____

供应商应提供关联单位情况，包括以下内容：

1. 单位负责人为同一人的不同单位名单：

单位名称：_____

与本单位关系：_____

2. 存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

单位名称：_____

控股/管理关系说明：_____

3. 供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例（如供应商为上市公司，提供股权占公司股份总数 5% 以上的所有股东名称及相应股权比例）：

股东名称：_____

股权（出资额）比例：_____

4. 供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例：

下属企业名称：_____

持有股权（出资额）比例：_____

注：如供应商不存在以上某种情况，请在相应栏目填写“无”；不得更改要求的实质内容。供应商应如实填报

此表，否则因其响应而影响采购公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。



4.14 投标保证金交纳/电子保函证明

供应商的投标保证金须确保到账，在制作投标文件时，可将交纳证明材料的复印件粘贴在此处。(加盖公章)

5、投标人主要业绩

(1)提供投标人（2021 年至今）

新公司提供其成立以来同类或类似产品的销售业绩

项目名称：

项目编号：

采购单位 名称	设备和项目名称	采购数量	单价	合同 金额	采购单位联系人 及电话

说明：后附业绩证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件，加盖公章。如未附证明材料或证明材料不全或内容模糊不清的，其业绩将不予认定。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日



6、货物说明

货物说明包括：

- (1)产品技术参数（指标）、功能等性能描述；
- (2)产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；
- (3)配置先进合理，技术成熟，安全可靠；
- (4)货物优势介绍；
- (5)产品耐用性及使用功能安全性、采用新技术、新工艺或选用新材料情况；
- (6)投标人认为有必要提供的其他说明材料。



7、实施方案

1、技术方案：技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。

其要点和主要内容为：1.设备配置简介 2.设备技术特点说明及详细方案

2、安装调试、验收、培训方案：（格式自拟）

3、售后服务方案：售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

- ①质保期；
- ②质保期内响应时间；
- ③售后服务方案；
- ④疆内售后服务机构及人员资质；
- ⑤厂家技术支持；
- ⑥技术升级服务；
- ⑦提供备品备件服务；
- ⑧应急处理等售后计划措施；
- ⑨质保期满后的后续维修服务等内容。

8、售后服务表

项目名称：

项目编号：

服务网点名称				备注
地址				
注册资本金		其中：投标人 出资比例		提供相关证明材料 (如:营业执照或租房 合同等)
员工总人数		其中：技术人员数		
经营期限				
售后服务协议				提供相关 证明材料
售后服务内容				此部分内容做附件进 行详细说明
服务承诺				
工作业绩				提供相关 证明材料
业务咨询电话		传真		附人员身份证等相关 证件
负责人		联系电话		

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年 月 日

9、人员配置表

项目名称：项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理 人员								
技术 人员								
售后服务人员								

法定代表人或被委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

日期： 年 月 日

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。



10、投标人认为需要提供的其他资料

【招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置】



第七章、招标结束后注意事项

项目验收

1、交货、包装与组织验收

1.1 采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和投标人之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

1.2 采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

1.3 中标供应商所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，采购人有权拒收，由中标供应商负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

1.4 货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由中标供应商负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由中标供应商负责承担。

1.5 货物由中标供应商进行安装，安装后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。交货 10 日后，证明货物以及改装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。如验收不合格，中标供应商应退货，预缴押金的不予退还，一切损失由中标供应商承担。

1.6 验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.7 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

采购项目验收单

(仅供参考，以采购单位验收单为准。)

项目名称及编号					
采购人			项目负责人		
中标(成交)供应商			采购方式		
合同完成时间			项目验收时间		
中标(成交)货物					验收情况
序号	产品名称	制造商	数量	规格参数	是否合格
详见《中标（成交）通知书》采购清单					
验收小组	采购人代表				
	专业技术或使用人员				
	验收监督人员				
	项目验收意见		(是否合格)		
供应商意见：（是否属实）					
供应商单位盖章：					
供应商代表（签字）： 20 年 月 日					
采购人意见：					
(是否合格)					
采购人公章：					
20 年 月 日					

备注:1.采购人自行组织验收【采购法 87 号令第七十四条采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档】。

2.采购人视项目具体情况,应邀请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。

3.本验收单一式四联，采购人 2 联、代理机构 1 联、中标（成交）供应商 1 联



履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称) _____

_____号合同履行保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于____年____月____日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量), 即相当于合同价格的____%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动, 包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约), 无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知, 立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款, 不论这些款项是何种性质和由谁征收, 都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为, 均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称: _____

签字人姓名和职务: _____

签字人签名: _____

公章: _____



履约担保函格式

(采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

(采购人)：_____

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为
的《采购合同模版》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月
日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，
我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中
标项目分包给他人的；
2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供货物/完成工程的；

(2) _____。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元

(大写_____)，币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后
日内。如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供货物/完成工程的，由我方在保证



金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照 检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/货物全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。



2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的磋商保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本电子保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、电子保函的生效

本电子保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

履约保证金退还申请单

(中标单位如交纳履约保证金应提供此模版)

昌吉回族自治州人民医院:

我公司已按合同规定对 (单位) (项目名称) 履约完毕 (采购验收单附后), 本项目中标 (成交) 金额 元, 已交纳履约保证金 元, 现申请退还履约保证金, 请按有关规定给予办理。

收款单位:

银行账号:

开户银行全称:

退还金额(大写):

法定代表授权人:

联系电话:

中标 (成交) 投标人公章

年 月 日

项目负责人签字:

年 月 日

履约保证金收款收据原件的粘贴处

(xxxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目
标项一：昌吉回族自治州人民医院口腔种植机等【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-1

金额（大写）：陆仟捌佰元整 （小写）：¥ 6800.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目

标项二：昌吉回族自治州人民医院口腔综合治疗台等【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-2

金额（大写）：柒仟肆佰元整 (小写)：¥ 7400.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目

标项三：昌吉回族自治州人民医院脑反射治疗仪等【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-3

金额（大写）：肆仟元整 (小写)：¥ 4000.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目

标项四：昌吉回族自治州人民医院体感音波反馈系统【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-4

金额（大写）：柒仟元整 （小写）：¥ 7000.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目
标项五：昌吉回族自治州人民医院超声波清洗机【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-5

金额（大写）：肆佰元整 (小写)：¥ 400.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目
标项六：昌吉回族自治州人民医院血液透析机【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-6

金额（大写）：玖仟陆佰元整 (小写)：¥ 9600.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目
标项七：昌吉回族自治州人民医院子痫检测设备等【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-7

金额（大写）：壹万元整 （小写）：¥ 10000.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目
标项九：昌吉回族自治州人民医院磁刺激仪【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-9

金额（大写）：壹万伍仟元整 （小写）：¥ 15000.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。



政府采购评审人员廉洁自律承诺书

昌吉回族自治州人民医院:

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,本人就参加**昌吉州州直卫生健康医疗系统(昌吉回族自治州人民医院)国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台(套)医疗设备项目(项目编号:XJZC (CG) 2024-021)**评审工作,郑重承诺如下:

一、在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定,遵循公平、公正、诚实信用原则,依据采购文件规定的办法、标准和要求,客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求,不接受、不索取采购人、采购组织机构、供应商及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知晓并严格遵守政府采购工作纪律。

四、现清楚知悉参加本采购项目的所有供应商情况,并为之无任何利害关系:之前也未参加过与本项目采购需求和采购文件等的咨询、论证工作,不存在需要回避的情形。

五、如发现采购活动中存在违法违纪行为的,及时向采购人、采购组织机构或财政部门报告并加以制止。


六、如在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的,自觉接受财政部门的处罚,因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的,依法承担民事责任。

(以上利害关系包括参加评审活动前 3 年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人,曾在其中担任董事、监事,或者曾与其存在劳动关系;与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系;本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷;个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系;所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司(联营企业和合营企业)情况关系;分级代理或代销关系、管理关系、重要业务(占主营业务收入 50%以上)或重要财务往来关系(如融资)等其他实质性控制关系;配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问)。

七、根据我国个人所得税法的相关规定,对个人一次性取得或一个月内累计取得劳务报酬所得超过 800 元以上的,应自行向税务部门申报个人所得税。

评标专家签字:

2024 年 9 月 5 日





昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）

国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）

医疗设备项目

项目编号：XJZC(CG)2024-021
(标项八)

招标文件



采 购 人： 昌吉回族自治州人民医院

本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购

代理机构：新疆正成招标代理有限公司


(共同编制)

二零二四年八月

交通指引

新疆正成招标代理有限公司位于昌吉市北京南路 69 号康丽家园文化中心三楼，可采用以下交通方式：

- 1、公交：44 路 2 路 世纪花园站下车，康丽家园东门步行 100 米即可到达。
- 2、自驾：高德 腾讯 百度地图导航输入“新疆正成招标代理有限公司”。
- 3、建议将车辆停放于文化中心楼前地面停车场，来访人员 1 楼步行楼梯上 3 楼。

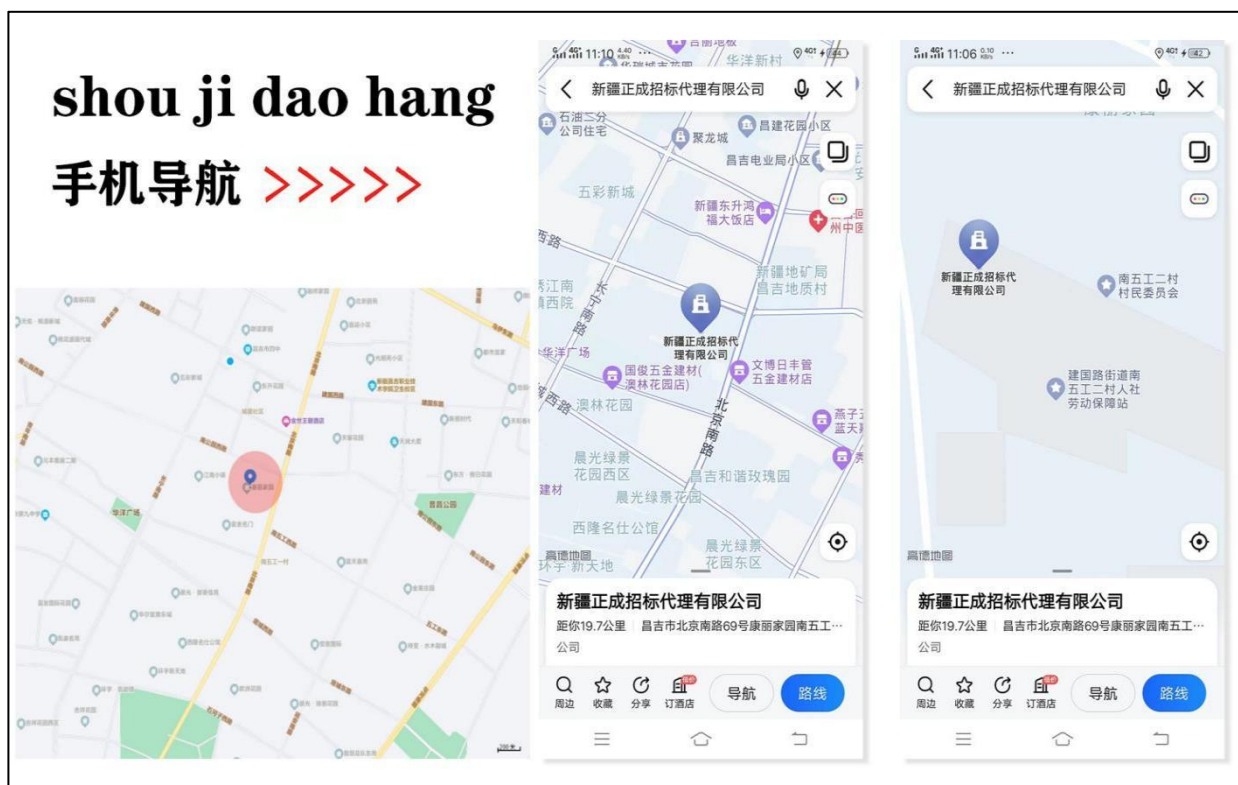



纪律要求

1.对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求,建立健全本单位政府采购内部控制制度,在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他投标人的竞争行为,不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明,法律规定允许澄清或说明的情形除外;
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (四) 对需要专业判断的主观评标因素协商评分;
- (五) 在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的;
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的,其评标意见无效,并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。



目 录

第一章 招标公告	5-14
第二章 投标须知	15-63
投标须知前附表	15-25
投标须知正文	26-63
一、总则	26-32
二、招标文件	32-33
三、投标文件	34-37
四、投标文件的提交	38-38
五、开标、评标和定标	39-52
六、评标结果信息公布与授予合同	52-62
七、其他规定	63-63
第三章 评标方法及标准	64-77
第四章 政府采购合同	78-93
第五章 采购需求	94-96
第六章 投标文件格式	97-136
一、投标文件封面格式	98-98
二、投标文件组成	99-99
三、供应商自查索引表	100-102
四、投标文件格式范本	103-136
第七章 招标结束后注意事项	137-145



第一章 招标公告

项目概况：

昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）线上获取招标文件，并于 2024 年 09 月 10 日 10:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： XJZC (CG) 2024-021

项目名称： 昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目

采购方式： 公开招标

预算金额（元）： 3820000.00

最高限价（元）： 3820000.00

采购需求：

标项一： 昌吉回族自治州人民医院口腔种植机等

数量： 3 台

预算金额（元）： 350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 口腔种植机 1 台、口腔牙片机 1 台、口腔扫描仪 1 台。



标项二：昌吉回族自治州人民医院口腔综合治疗台等

数量： 5 台

预算金额（元）： 370000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：口腔综合治疗 4 台、根管马达 1 台。

标项三：昌吉回族自治州人民医院脑反射治疗仪等

数量： 4 台

预算金额（元）： 200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：脑反射治疗仪 2 台、超声波治疗仪 2 台。

标项四：昌吉回族自治州人民医院体感音波反馈系统

数量： 1 台

预算金额（元）： 350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：体感音波反馈系统 1 台。

标项五：昌吉回族自治州人民医院超声波清洗机

数量： 1 台

预算金额（元）： 20000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声波清洗机 1 台。

标项六：昌吉回族自治州人民医院血液透析机

数量： 3 台

预算金额（元）： 480000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血液透析机 3 台。



标项七：昌吉回族自治州人民医院子痫检测设备等

数量：3 台

预算金额（元）：500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：子痫检测设备 1 台、超低温冰箱 2 台。

标项八：昌吉回族自治州人民医院心衰超滤脱水装置

数量：1 台

预算金额（元）：800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：心衰超滤脱水装置 1 台。

标项九：昌吉回族自治州人民医院磁刺激仪

数量：1 台

预算金额（元）：750000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：磁刺激仪 1 台。

合同履行期限：按照甲乙双方合同约定执行

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；**
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**
- (5) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。**



2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 标项一、标项二、标项三、标项四、标项五、标项六、标项七、标项九，专门面向中小企业，供应商应所投货物的生产厂家须为中小企业，投标时须提供《中小企业声明函》（货物）。

2.2 标项八不专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械证件：供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证，如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。（按要求提供证明文件）

(2) 信用查询：未被“信用中国”网站 <https://www.creditchina.gov.cn>、中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（需提供承诺书）

(3) 关联企业情况：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。（关联企业等情况表）。

(4) 投标保证金交纳证明：投标保证金银行转账回单/电子保函。（加盖公章）

(5) 本项目不允许转包或分包，不允许联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024 年 08 月 16 日 00 时 00 分至 2024 年 08 月 23 日 23 时 59 分（北



京时间，线上获取，法定节假日均可)

地址：新疆政府采购网政采云平台 (<https://www.zcygov.cn>)

方式：投标人登录新疆政采云平台 <https://www.zcygov.cn>/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行报名下载招标文件）。

售价（元）：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地址

提交投标文件截止时间：2024 年 09 月 10 日 10:30（北京时间）

投标地址：新疆政府采购网政采云平台 (<https://www.zcygov.cn>)

开标时间：2024 年 09 月 10 日 10:30（北京时间）

开标地址：新疆政府采购网政采云平台 (<https://www.zcygov.cn>)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜：

1、电子招投标相关要求：

关于政府采购活动办理 CA 的提示，根据国办函〔2019〕41 号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，我区政府采购云平台目前已支持包括新疆 CA、翔晟 CA 及汇信 CA 等多家 CA 的办理及使用。为进一步优化营商环境，保障政府采购市场环境公开、公平、公正，各政府采购代理机构在发布的招标公告信息中，需引导投标人通过新疆政府采购网-办理指南—投标人—CA 证书办理操作指南-进入 CA 办理界面，按需选择办理任意一家 CA 厂商的数字证书，不得违规指定厂家办理或要求投标人重复办理 CA。



1.1 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可访问通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

1.2 采用电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

1.3 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

1.4 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<https://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

1.5 投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。本项目投标文件的解密时间为30分钟内,若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。

1.6 投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。投标人钉钉群号：35547618（政采云新疆网超投标人服务二十群）（如已加入，无需重复加入，所有群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

1.7 投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一



个CA锁。

2、投标保证金

2.1、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 33 条规定，招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%。

投标保证金的金额（元）：标项一：¥6800 （大写：陆仟捌佰元整）

标项二：¥7400 （大写：柒仟肆佰元整） 标项三：¥4000 （大写：肆仟元整）

标项四：¥7000 （大写：柒仟元整） 标项五：¥400 （大写：肆佰元整）

标项六：¥9600 （大写：玖仟陆佰元整） 标项七：¥10000 （大写：壹万元整）

标项八：¥16000 （大写：壹万陆仟元整） 标项九：¥15000 （大写：壹万伍仟元整）

2.2、投标保证金的形式：应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。银行电子保函或者保险公司、担保公司电子保函应当从其基本账户开具。以投标人基本账户以外的个人、投标人的办事处、分公司、子公司名义或者其他账户转出的投标保证金无效。

2.3、提交时间：投标保证金或电子保函必须在投标截止时间（投标时间）前从潜在投标人基本账户以电汇、转账方式足额交纳至新疆正成招标代理有限公司指定账户，投标保证金是否交纳成功以银行入账为准。各投标人必须在投标截止时间前交到指定账户。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

2.4、电子保函

投标保证金还可以采用电子保函形式按以下要求办理：

(1) 电子保函按照“一标项一保函”的原则；

- (2) 电子保函须在投标截止时间前办理完成;
- (3) 保函的有效期不得少于本项目投标有效期;
- (4) 投标人通过的电子保函必须真实有效, 否则后果自负;
- (5) 投标人以电子保函形式交纳投标保证金;
- (6) 电子担保凭证需作为电子投标文件组成部分在递交投标文件时一并提交。

交纳投标保证金汇款信息如下:

户名: 新疆正成招标代理有限公司

开户银行: 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司北京南路支行

银行账号: 806020612010111586786

银行行号: 402885000320

■付款用途: 投标保证金

■汇款时备注栏附言:

XJZC(CG)2024-021-1	XJZC(CG)2024-021-2
XJZC(CG)2024-021-3	XJZC(CG)2024-021-4
XJZC(CG)2024-021-5	XJZC(CG)2024-021-6
XJZC(CG)2024-021-7	XJZC(CG)2024-021-8
XJZC(CG)2024-021-9	

经办人电话: xxx xxxx xxxx

投标保证金交纳说明:

- (1) 投标人以电汇或网银转账方式交纳投标保证金, 无需到代理机构换取投标保证金收据, 同时需要将投标保证金交纳凭证加盖公章放入投标文件中;
- (2) 投标人以支票、汇票、本票等非现金形式交纳, 需到代理机构换取投标保证金收据, 同时需要将投标保证金收据扫描件加盖公章放入投标文件中;
- (3) 投标人以金融机构、担保机构出具的保函形式交纳, 同时需要将保函扫描件加盖公章放入投标文件中;
- (4) 投标人应充分考虑投标保证金到账时间, 在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续, 投标保证金的交付时间以实际到账时间为准, 超过交纳的时限交纳投标保证金视为投标无效。



七、发布公告的媒介：

新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)

特别提示：

①、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

②、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

③、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

④、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。



八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：昌吉回族自治州人民医院

本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购

联 系 人：郭老师

联 系 方 式：189 0994 5698

2、代理机构信息

名 称：新疆正成招标代理有限公司

地 址：昌吉市北京南路 69 号康丽家园文化中心三楼

联 系 人：夏鲁梅

联 系 方 式：0994-2380033

Q Q 邮 箱：385585645@qq.com

3.项目联系方式

联 系 人：夏鲁梅

联 系 方 式：181 3904 2419

第二章 投标须知

投标须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称 项目编号	昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等22台（套）医疗设备项目 XJZC（CG）2024-021
2	招标范围	国产设备
3	项目地址	昌吉回族自治州人民医院
4	招标方式	公开招标
5	供货时间	以甲乙双方政府采购合同中约定为准
6	设备质量技术标准及包装	1.乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定。 2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。 3.设备包装应为设备生产厂原包装。
7	售后服务要求	详见第五章采购需求
8	付款情况	以甲乙双方政府采购合同中约定为准
9	所属行业	本项目的所属行业为工业（从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业）。
10	资金来源	事业单位收入



序号	条款名称	编列内容
11	预算金额 最高限价	预算金额 (元) : 3820000.00 (其中: 标项八: 800000.00) 最高限价 (元) : 3820000.00 (其中: 标项八: 800000.00) 注: 1、投标报价时每包投标报价不得超过各产品采购预算, 每包中的分项报价也不得超过分项的预算金额, 超过按废标处理。 2、报价说明: 采用公开招标, 仅对满足招标文件实质性要求的投标人, 进行一次最终报价, 报价不得高于最高限价, 否则其投标将被否决。报价应包含招标文件中所需货物报价 (含税金)、运输费、保险费用、施工、安装、调试费、验收、拆装、培训、备品备件、售后服务、税款、测试、质检、检验、行政许可及相关证书等直至给业主正常履行合同前的一切费用。 3、投标人的报价明显低于其他投标人报价或者明显低于市场价, 使得其报价可能低于其个别成本的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明, 必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会将其作为无效投标处理, 自行承担相关责任。
12	采购人	名称: 昌吉回族自治州人民医院 本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购 联系人: 郭老师 联系方式: 189 0994 5698
13	代理机构	名称: 新疆正成招标代理有限公司 地址: 昌吉市北京南路69号康丽家园文化中心三楼 联系人: 夏鲁梅 联系电话: 0994-2380033 181 3904 2419
14	资格证明文件	资格证明文件: 见招标文件资格性审查表 投标人未提供有效的资格证明文件的, 视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求, 投标无效。
15	信用查询	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号) 规定, 投标截止时间后, 采购人或代理机构将对投标人进行信用情况查询, 通过信用中国网 (https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参加本次政府采购活动。 (信用查询以代理机构开标前 1 日查询结果为准)



序号	条款名称	编列内容
16	中小企业扶持政策说明	1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6、小企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境)采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策的，依据规定给予评标优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予 10%价格扣除；以扣除后的价格参与评标，不重复享受价格扣除政策。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300 号)”等有关规定。
17	不面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准	因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予 10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。
18	偏离	不接受实质性偏离及重大偏离
19	是否接受联合体投标	不接受
20	是否允许转包或分包	不允许



序号	条款名称	编列内容
21	踏勘现场	不组织
22	投标有效期	从首次提交投标文件截止之日起，不得少于90个日历日。
23	进口产品	本项目不适用
24	投标截止时间	2024年09月10日10:30（北京时间），本项目采用电子评标，请各投标人务必制作好电子投标文件。使用CA锁提交电子投标文件，必须于投标文件截止时间前提交到“新疆政府采购云平台”逾期提交的投标文件将被拒收。
25	澄清或修改	详见招标文件
26	投标人询问	对招标公告、招标文件、招标过程、评标结果的询问可向采购人或代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：夏鲁梅 联系电话：181 3904 2419 注：采购人或代理机构只对投标人依法提出的询问作出答复。
27	投标人质疑	供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑并递交至代理机构，逾期质疑无效。 供应商应知其权益受到损害之日是指： (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日； (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确



序号	条款名称	编列内容
		凿的证据材料和注明证据的确切来源，证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。 采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。 接受的方式：现场收取纸质版质疑函 接收人：夏鲁梅 联系方式：0994-2380033 181 3904 2419 递交地址：昌吉市北京南路 69 号康丽家园文化中心三楼 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评标方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。
28	投标人投诉	质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。 投诉受理单位：昌吉州财政局政府采购办 联系电话：0994-2517760 注：根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》及其他有关规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
29	投标保证金	详见招标公告



序号	条款名称	编列内容
30	投标保证金的退还	(1) 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 (2) 采购人或者代理机构应当自中标（成交）通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标（成交）人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金或者转为中标（成交）人的履约保证金。 ★退还投标保证金须知：详见招标文件 P143。
31	不予退还投标保证金的情形	有下列情形之一的，投标保证金不予退还： (1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的； (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的； (4) 投标人与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通的； (5) 招标文件规定的其他情形。
32	财政部门指定的媒体	新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html
33	投标文件一般要求	1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。 2、投标人提交的投标文件及投标人与采购人或代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。 3、计量单位应使用我国法定计量单位。未列明时应默认为我国法定计量单位。 4、投标文件应采用电子投标形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。 5、投标人使用相同 IP 地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 6、投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。



序号	条款名称	编列内容
34	投标文件的签署	1、本采购项目电子投标文件的封面，标明所采购的项目名称、项目编号、招标范围及内容（项目包号/产品名称）、采购人名称、供应商名称、供应商地址、联系人、联系电话及传真、供应商QQ邮箱号等内容。 2、投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。
35	开标时间和地址	开标时间：2024年09月10日10:30（北京时间） 开标地址：新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn） 注：投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功提交至“新疆政府采购网政采云平台”，否则投标无效。
36	投标文件的提交地址	电子投标文件数目：电子版1套。新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn）使用新疆政府采购云平台投标文件制作工具，制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前提交至政采云平台对应位置。 纸质投标文件份数：中标供应商在评标结果1个工作日公示期结束后，将投标文件1正3副（胶装成册，投标文件厚度不超过4厘米，如厚度超出，建议双面打印或者胶装成上下2册），另以U盘形式提供全套电子版投标文件（电子版格式：投标文件正本盖章扫描生成的PDF格式）递交至新疆正成招标代理有限公司。 详细地址：使用高德地图、腾讯地图、百度地图搜索新疆正成招标代理有限公司到达指定位置，昌吉市北京南路69号康丽家园文化中心三楼303室，纸质版投标文件内容与电子版提交至新疆政采云平台的投标文件内容一致。 （接受邮寄，不接受到付）。 收件人：夏鲁梅 联系电话：181 3904 2419



序号	条款名称	编列内容
37	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人（其中：相关专业等方面的专家 4 人，业主代表 1 人）。 评标专家确定方式：新疆政府采购网评标专家库中随机抽取
38	评标方法	综合评分法 （其中：经济部分30分，商务和技术部分70分）
39	推荐的中标候选人数量	详见招标文件
40	履约保证金	招标文件要求中标供应商提交履约保证金的,投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的电子投标保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。中标人没有按照规定提交履约担保的,视为放弃中标资格,其投标保证金不予退还,由采购人与投标人在合同中约定。
41	同品牌同型号投标问题	当多家投标人所投品牌型号相同时,按照下列情形处理: 【采用综合评分法】提供同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌同型号投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由评标委员会按照下述第（2）条方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌同型号投标人不作为中标候选人。 (1)评标委员会采取随机抽取的方式确定。 (2)投标报价低的一方为中标候选人;投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人;投标报价和技术部分得分均相同时,采取随机抽取的方式确定。



序号	条款名称	编列内容
42	补充事项	①招标文件中要求：投标单位法定代表人和委托代理人的联系电话须实名制。 ②开标时《投标（响应）文件签收登记表》中联系人、联系电话须实名制并确保真实有效，第一时间可以接听，如因电话号码有误联系不上造成的投标失败等后果由投标人自行承担，《投标（响应）文件签收登记表》的邮箱号需填写无误。 ③为保证本项目产品质量及良好的售后服务，货物或产品必须符合国家标准。 ④投标单位应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，本文件中部分加粗、加黑、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标单位注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
43	中标通知书 领取	接到代理机构通知后，三个工作日内，请中标供应商凭有效身份证明证件到新疆正成招标代理有限公司领取中标通知书。若未在规定时间内领取，也无正当理由予以说明，将视为自动放弃第一中标候选人资格，投标保证金不予退还。
44	采购合同	中标单位与采购人签订合同后及时将合同扫描件（PDF 版）发送至邮箱（385585645@qq.com）或送至新疆正成招标代理有限公司。
45		自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、电子邮箱)长期有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则投标人承担由此引起的一切后果。

序号	条款名称	编列内容			
46	代理费标准	类别			
		采购额度（万元）	货物采购	服务采购	工程采购
		100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%
		100~500	1. 1%	0. 8%	0. 7%
		500~1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%
		1000~5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%
		5000~10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%
		10000~100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%
		100000 以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%
		代理服务收费标准：			
依据国家有关规定，向中标人收取中标代理服务费，同时承担所需的全部费用。参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980 号文）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号文）的收费标准计算招标代理服务费，并按收费标准额度下浮 50%后收取费用，由中标人支付。代理服务费支付方式：由中标供应商支付。					
代理服务费的支付时间：中标供应商在收到中标通知书同时向代理机构一次性支付本项目代理服务费。					

序号	条款名称	编列内容
		★缴纳代理服务费银行账户信息如下： 账户名称：新疆正成招标代理有限公司 账户号码：65050162604609888999 开户银行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行城建支行 银行行号：105885000033 基本存款账户编号：J8850004061901 付款用途：代理服务费 XJZC(CG)2024-021-8 备注：需要开具增值税专用发票，供应商需提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。如不按要求提交开票信息，一律按电子（普）发票开具，发票只开一次不予更换。
47		注：如本《投标须知前附表》相关内容与招标文件正文中相关内容表述不一致处，则以本《投标须知前附表》相关内容为准。



投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 项目名称：详见投标须知前附表；
- 项目编号：详见投标须知前附表；
- 1.2 招标范围：详见投标须知前附表；
- 1.3 项目地址：详见投标须知前附表；
- 1.4 招标方式：详见投标须知前附表；
- 1.5 供货时间：详见投标须知前附表；
- 1.6 设备质量技术标准及包装：详见投标须知前附表；
- 1.7 售后服务要求：详见投标须知前附表；
- 1.8 付款情况：详见投标须知前附表；
- 1.9 所属行业：详见投标须知前附表；

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指投标招标文件要求、参加招标采购,向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，



详见《政府采购品目分类目录》（财库[2015]189号）。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号及《政府采购进口产品管理办法》财库〔2007〕119号。

2.7 偏离

2.7.1 本条所称偏离为投标文件对招标文的偏离，即不满足招标文件的要求，偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。（商务条款不允许偏离，技术条款偏离情况在详细评标中给与相应评分）

2.7.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“特殊”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.8 若采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

2.8.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2.8.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

2.8.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

2.8.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.8.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.8.6 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者代理机构应当及时询



问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.9 采购人或者代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇：

2.9.1 就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息；

2.9.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.9.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品；

2.9.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

2.9.5 对投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

2.9.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人；

2.9.7 非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.9.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

2.10 特别说明

2.10.1 投标人在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。凡参加投标的投标人必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好；

2.10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与相关认证等必须为投标人所拥有；

2.10.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

2.10.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。



3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合招标公告中规定的申请人的资格要求。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

3.2.1 与采购人、代理机构存在利害关系；

3.2.2 受到刑事处罚或者受到较大数额以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4 使用综合评分法的采购项目，提供同品牌同型号产品且通过资格性审查、符合性审查的不同潜在投标人参加同一合同项下投标的，按一家潜在投标人计算，评标后得分最高的同品牌同型号潜在投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个潜在投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌潜在投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家潜在投标人提供的核心产品品牌型号相同的，同上处理。

4. 投标费用和知识产权

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。



4.2 投标人应保证,在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权,则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5. 授权委托书

投标人代表为投标人法定代表人的,应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的,应持有法定代表人授权书。

6. 联合体投标 (不允许)

除投标须知前附表中另有规定,本次招标采购不接受以联合体形式投标的投标人。

7. 现场考察 (不采用)

7.1 投标人应按规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察或者参加开标前答疑会。

7.2 现场考察或者参加开标前答疑会的费用由投标人自己承担,现场考察或者参加开标前答疑会期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标,投标人不得以任何借口,而提出额外补偿,或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品 (不采用)

8.1 除投标须知前附表另有规定外,本项目不允许进口产品参加招标采购活动。

8.2 本章第8.1款规定同意购买进口产品的,本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

8.3 采购人采购进口产品,必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财



政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

9. 政府采购政策支持（本项目不专门面向中小企业）

9.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

9.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

9.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.5 投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。



9.6 本项目中小企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境)采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策的，依据规定给予评标优惠；②因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评标，不重复享受价格扣除政策。

9.7 根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随评标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，本招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式



第七章 招标结束后注意事项

10.2 本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝，其风险由投标人承担。

11. 投标截止时间

11.1 投标截止时间即投标人提交投标文件的截止时间见投标须知前附表。

12. 招标文件的澄清或者修改

12.1 采购人或者代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

12.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者代理机构提出。



三、投标文件

13. 一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位。未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用电子投标形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。

13.6 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14. 投标文件的组成

投标文件包括下列内容：

供应商自查索引表

14.1 投标函

14.1.1反商业贿赂承诺书

14.2报价一览表

14.2.1投标报价明细表

14.2.2设备简要说明一览表



14.3 技术/商务响应与偏离表

14.4 资格证明文件

14.5 投标人主要业绩

14.6 货物说明

14.7 实施方案

14.8 售后服务表

14.9 人员配置表

14.10 投标人认为需要提供的其他资料

根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件均不予退还。

15. 报价

15.1 投标人应当根据招标文件的招标要求和招标范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有货物供货、运输、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3 投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件格式”填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的投标报价将被认为是非实质性响应而被拒绝。



15.5 本采购项目设定采购预算投标须知前附表，投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见投标须知前附表。

16. 投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1 投标人应提供资格证明材料，以证实各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.2 投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

16.3 投标人在货物说明中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.4 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

16.4.1 货物主要性能和参数的详细说明；

16.4.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

17. 投标保证金

17.1 投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2 潜在投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者代理机构应当自收到潜在投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因潜在投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：



- 17.3.1 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- 17.3.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 17.3.3 中标人未按招标文件规定交纳履约保证金的；
- 17.3.4 拒绝履行合同义务的。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

18.2 投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内潜在投标人撤销投标文件的，采购人或者代理机构可以不退还投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 本采购项目电子投标文件的封面，标明所采购的项目名称、项目编号、招标范围及内容（项目包号/产品名称）、采购人名称、投标人名称、投标人地址、联系人、联系电话及传真、投标人QQ邮箱号等内容。

19.2 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。



四、投标文件的提交

20. 投标文件的提交

20.1 投标文件的提交地址（详见前附表）

20.2 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

20.3 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

20.4 加密的电子投标文件应在递交截止时间前通过政采云平台提交完成。

注意：如未在规定时间内进行以上操作，将导致投标（投标）无效。

21. 当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

- （1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功提交加密电子投标文件；
- （2）投标人使用解密的 CA 数字证书与提交加密投标文件使用的 CA 数字证书不一致；
- （3）投标人解密时 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密；
- （4）加密投标文件时，CA 数字证书未过期，解密时，显示 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密；
- （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；
- （6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。

投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。



五、开标、评标和定标

22. 开标程序

22.1 宣布开标纪律；

22.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

22.3 查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

22.4 投标人根据要求在限定时间内通过新疆政府采购网政采云平台对已上传的电子投标文件开始解密；

22.5 投标人授权代表在开标记录上确认；在规定时限内未确认的，视为默认开标结果；

22.6 开标结束。

23. 开标

23.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过新疆政府采购网政采云平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

23.2 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

23.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑问，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

23.5 在评标结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，



系统不接受超时的澄清。

23.6 各投标人的评标得分与排序将在新疆政府采购网政采云平台告知。

23.7 开标时属于下列情况之一的，视为无效投标:

- (1) 未在政采云系统进行在线签到的;
- (2) 未在30分钟内完成在线解密的;
- (3) 唱标结束后**30分钟内**未完成“报价一览表”在线确认的;
- (4) 投标人未按照公开招标文件要求交纳投标保证金的;
- (5) 按照本文件规定有效证件不齐全的投标人的投标文件。

23.7.1 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7.2 潜在投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他潜在投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他潜在投标人的合法权益。

在评标过程中发现潜在投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.7.3 有下列情形之一的，视为潜在投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任:

- (1) 不同潜在投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同潜在投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同潜在投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同潜在投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同潜在投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同潜在投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 评标委员会



24.1 采购人或者代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

24.1.1 核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.1.2 宣布评标纪律；

24.1.3 公布潜在投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

24.1.4 组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长；

24.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰；

24.1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.1.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.1.8 核对评标结果，有本招标文件投标须知正文第 25.10 条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.1.9 评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

24.1.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2 要求潜在投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；



24.2.3 对投标文件进行比较和评价；

24.2.4 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家投标人为中标候选人；

24.2.5 向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3 评标委员会由采购人代表和评标专家组成,成员人数应当为 5 人以上单数,其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的,应当回避。

采购项目符合下列情形之一的,评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数:

- (一) 采购预算金额在 1000 万元以上;
- (二) 技术复杂;
- (三) 社会影响较大。

评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标,对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评标专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家情形除外。代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.4 采购人或者代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中,通过随机方式抽取评标专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评标专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家。

24.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的,采购人或者代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。



无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6 采购人委派代表参加评标委员会的，要向代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过 2 人。

24.7 评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与投标人的合法权益。

24.8 评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

25. 评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评标因素、



标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评标，评标委员会应当对符合资格的潜在投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求潜在投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

潜在投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。潜在投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件投标须知正文第 25.2 款的规定经潜在投标人确认后产生约束力，潜在投标人不确认的，其投标无效。

25.4 评标委员会认为潜在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查潜在投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；潜在投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多



数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7 本项目评标方法为综合评分法。

25.7.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与潜在投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

25.7.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个潜在投标人的投标文件进行评价，并汇总每个潜在投标人的得分。

25.7.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

25.7.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

25.8 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为排名第一的中标候选人。

25.9 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

25.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一) 分值汇总计算错误的；



- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评标,重新评标改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

潜在投标人对上述(一)~(四)项提出质疑的,采购人或者代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标,重新评标改变评标结果的,应当书面报告本级财政部门。

25.11 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容:

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地址;
- (二) 潜在投标人名单和评标委员会成员名单;
- (三) 评标方法和标准;
- (四) 开标记录和评标情况及说明,包括无效潜在投标人名单及原因;
- (五) 评标结果,确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;
- (六) 其他需要说明的情况,包括评标过程中潜在投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正,评标委员会成员的更换等。

25.12 采购人、代理机构应当采取必要措施加强评标现场管理,与评标工作无关的人员不得进入评标现场,保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外,采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为,要依法严肃处理。



有关人员对标评情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.13 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- （一）评标委员会组成不符合本招标文件规定的；
- （二）有本招标文件投标须知正文第 24.8 条第一至五项情形的；
- （三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- （四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的；
- （五）有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

25.14 评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或代理机构书面说明情况，采购人或代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或代理机构报告。

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

26. 定标

26.1 代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标



候选人为中标人。

26.2 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告评标结果，招标文件应当随评标结果同时公告。

评标结果公告内容应当包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、中标公告期限以及评标专家名单。

中标公告期限为 1 个工作日。

在公告评标结果的同时，采购人或者代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的潜在投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

26.3 采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

26.4 在确定中标供应商前，采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

26.5 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

27. 招标终止

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (一) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 潜在投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；



(四) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有潜在投标人。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

27.2 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，评标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

27.2.4 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

27.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

28. 重新评标

28.1 除本须知第25.10所述情形外，采购人或者代理机构不能以任何理由组织重新评标。采购人、代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 保密与纪律事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对投标人资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相



关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、监督人、代理机构、评标委员会及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，我公司将根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

29.2 投标人不得与采购人、代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

29.3.1 投标人直接或者间接从采购人、代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

29.3.2 采购人、代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

29.3.3 投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

29.3.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

29.3.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

29.3.6 投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

29.3.7 投标人与采购人、代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的；

29.3.8 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

29.4 投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，



并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （三）与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

29.5 投标人有下列情形之一的，依照《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有上述第一项规定情形的，中标无效。评标阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和代理机构的，处以采购金额 5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29.6 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。



29.7 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

六、评标结果信息公布与授予合同

30. 中标信息的公布

30.1 采购人或者代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告评标结果，招标文件随评标结果同时公告。

30.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

31. 询问及质疑

31.1 《中华人民共和国政府采购法》（第五十一条）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问，采购人或代理机构应当及时回复，但答复的内容不得涉及商业秘密。《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第五



十二条) 采购人或代理机构将在3个工作日内作出答复。

31.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑：

31.2.1 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

31.2.2 关于评标结果的质疑，应在评标结果信息发布后7个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

31.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

31.5 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

31.6 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。



31.7 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给磋商方。磋商方不具有法定调查、认定权限和义务。

31.8 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

31.9 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

31.10 采购人或代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。



质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：
事实依据：
.....
法律依据：
.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章): 公章:

日期:



质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人： 联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2：

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：



代理机构名称:

采购文件公告:是/否 公告期限: 采购结果公告:是/否

公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于____ 年____ 月____ 日,向..... 提出质疑, 质疑

事项为:

采购人/代理机构于 ____ 年 ____ 月 ____ 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2:

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:



投诉书说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



31.11 投标人对采购人或代理机构的答复不满意，或采购人或代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

31.12 参与政府采购活动的投标人对评标过程或者结果提出质疑的，采购人或代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致评标结果改变的，采购人或代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

32. 中标通知

32.1 中标人确定后，代理机构将以电子形式或线下纸质版向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变评标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.2 中标人在收到代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

32.3 招标文件要求中标投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的电子投标保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，由采购人与投标人在合同中约定。

32.4 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

33. 签订合同

33.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。



33.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地址和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

33.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

33.4 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他潜在投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的潜在投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

33.6 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

33.7 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

33.7.1 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

33.7.2 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

33.7.3 拒绝履行合同义务的；

33.7.4 违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.8 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者



终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

33.9 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。



七、其他规定

35. 代理服务费

35.1 中标人应按投标须知前附表规定缴纳代理服务费。

35.1.1 中标人在收到中标通知书同时向代理机构一次性支付本项目代理服务费。

35.1.2 依据国家有关规定，向中标人收取中标代理服务费，同时承担所需的全部费用。参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号文）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号文）的收费标准计算招标代理服务费，并按收费标准额度下浮 50%后收取费用，由中标人支付。

36. 其他规定

36.1 采购人、代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

36.2 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

36.3 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆正成招标代理有限公司。

36.3 参与本次招标的投标人应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。



第三章 评标方法及标准

一、总则

1. 评标委员会

1.1 资格性检查由资格审查小组负责。

1.2 评标由依法组成的评标委员会负责,其组成方式详见前附表。

2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为**综合评分法**。

2.1.1 综合评分法,是投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为中标候选人的评标方法。评标因素的设定与潜在投标人所提供货物服务的质量相关,包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

2.1.2 评标时,评标委员会各成员应当独立对每个潜在投标人的投标文件进行评价,并汇总每个潜在投标人的得分。

2.1.3 评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4 因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列,得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为排名第一的中标候选人。

3. 评标原则



3.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 评标纪律

3.3.1 采购人委派代表参加评标委员会的，要向代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过2人。采购人需要在评标前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2 评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.3 评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、



评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

3.3.4 评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.3.5 采购人、代理机构要加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为，要依法严肃处理。

3.4 评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1 评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标。遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2 要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有投标人的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性审查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价。

3.4.3 对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4 评标委员会如需要投标人对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予投标人必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文



件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。

3.4.5 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评标结果推荐中标候选人。

3.4.6 评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

二、评标程序

4. 投标文件的初步评标

4.1 初步评标分为资格性审查和符合性审查。

4.1.1 资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购人授权代理机构对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性审查表

序号	检查因素	检查内容		
一	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：	(1)具有独立承担民事责任的能力； 提供投标人营业执照彩扫描件，以及投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。		
		(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 提供2022年度或2023年度的审计报告（成立不足1年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、利润表、现金流量表）（提供彩扫描件）。		
		(3)具有履行合同所必需的设备和技术能力； 提供履行本合同所必需的设备清单和具有专业技术的人员清单或承诺书。		
		(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 提供2024年第一季度完税证明及相关人员近6个月任意1个月的社保缴纳证明；加盖投标人电子公章；投标人依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商电子公章。		
		(5)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 提供声明函。		
		(6)法律、行政法规规定的其他条件。 提供声明函或承诺。		
二	本项目的特定资格要求：	(1)提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械证件 供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证，如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。（按要求提供证明文件）		
		(2) 信用查询 无需自行提供查询结果，但需要在投标文件中包含 1 份承诺书，承诺未被列入相关失信名单。		
		(3) 关联企业情况 准备1份供应商关联企业情况表，详细列出与本单位存在关联关系的企业信息。		
		(4) 投标保证金交纳证明 提供投标保证金银行转账回单/电子保函。（加盖公章）		
结论	是否通过审查，进入下一阶段。			
①.“是否通过并进入下一阶段评标”一栏应写“通过”或“不通过”。				
②.出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评标。				
③.若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评标。				

4.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出投标。评标委员会评标投标文件的投标性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.3 投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

序号	评审因素		评审标准
1	商务	投标文件签署	投标文件的签字、盖章符合招标文件规定。
2		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。
3		投标方案	每个标项只能有一个方案投标
4		供货范围（服务内容）	对招标文件规定的供货范围（服务内容）全部作出响应。
5		交货期(完成期限)	满足招标文件要求
6		质保期及售后服务	满足招标文件要求
7		投标有效期	满足招标文件规定
8		付款方式	投标文件承诺的付款方式满足招标文件要求
9		其他	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
10	报价	报价唯一	其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。
11	技术	质量技术	满足招标文件提出的技术和功能要求。



4.2有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的;
- (2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的。

4.3 废标后,除采购任务取消情形外,招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5. 澄清有关问题

5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求潜在投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

潜在投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。潜在投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 投标人不得对下列内容进行澄清或补充:

- (1) 投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。
- (2) 不满足第二章投标须知第3款规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3 投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:



(一) 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表 的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经潜在投标人确认后产生约束力，潜在投标人不确认的，其投标无效。

5.4 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。



问题澄清通知

(投标人名称) : _ _ _ _ _

(招标项目名称) 招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

1、

2、

评标委员会成员（签字）：

日期： 年 月 日



问题的澄清、说明或补正

评标委员会： _ _ _ _ _

(招标项目名称) 的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1、

2、

单位公章：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日



5.5 评标委员会认为潜在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查潜在投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；潜在投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 投标文件的详细评标

6.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.3 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4 评分标准:各投标人的总评分: $A(\text{含E、F价格折扣})+B+C+D=100$ 分，具体评分细则如下：

综合评分表

(经济部分占 30 分，商务和技术得分占 70 分)

项目		分值	评审内容及规则	得分
经济部分	价格	30 (国产)	采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100。	
商务部分	相关业绩	2	提供投标方（2021 年至今）新成立公司提供成立以来同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得 1 分，最高得 2 分，不提供不得分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖投标单位公章）。	
	服务能力	16	1、售后服务体系完备，设备出现故障 1 小时内到达现场处理解决故障得 5 分，设备出现故障 2 小时内到达现场处理解决故障得 2 分，2 小时以上到达现场处理解决故障不得分，评审时以提供服务承诺和相关证明材料为准（提供具有维修招标设备的人员资质证明）。 2、提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得 1 分，不提供不得分。 3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的优秀得 5 分、一般得 2 分、不合理或不提供不得分。质保服务期三年的得 3 分，四年的得 4 分，五年及以上的得 5 分。质保期低于招标要求的，不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）	



技术部分	核心参数 * ★	15	关键（核心）技术参数完全满足得 15 分，不完全满足不得分。 (评审时以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准〔包括：检验报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、食药局备案过的产品说明书或生产厂家产品说明书、生产厂家技术白皮书〕，证明材料需加盖生产厂家公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。)	
	其他技术指标	32	1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得 20 分；由专家逐条确认是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣 2 分，扣完为止。 2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（影响产品质量实质性参数）（包括核心参数）高于招标文件中技术参数和性能，优于一般参数得 1 分/项，优于核心参数得 2 分/项，最多得 12 分。 (评审时以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准〔包括：检验报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、食药局备案过的产品说明书或生产厂家产品说明书、生产厂家技术白皮书〕，证明材料需加盖生产厂家公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。)	
	安装技术水平	5	1.有专门项目负责人，配备 2 名及以上安装技术人员得 2 分。 2.设备安装技术负责人员有相应安装经验、有培训方案，同时提供 3 项及以上安装调试业绩得 3 分，提供 2 项安装调试业绩得 1 分，提供 1 项安装调试业绩得 0.5 分，不提供不得分。评审时以相关证明材料为准。（相关证明材料：提供使用单位的验收单和培训证明，并加盖投标单位公章。）	
其他	加减分项		1、不专门面向中小企业采购的项目：提供“中小企业声明函”对小微企业给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、不专门面向中小企业采购的项目：提供监狱企业、残疾人福利企业、节约能源保护环境企业，持政府相关部门认定文件给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。不重复享受价格扣除政策。 3、按其他规定、不良行为需要加分、减分的。	
总得分 100 分		技术参数中标注“*”或“★”号的为关键（核心）参数		

备注：当多家投标人所投品牌型号相同时，按照下列情形处理：

【采用综合评分法】提供同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照下述第（2）条方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌同型号投标人不作为中标候选人。

(1)评标委员会采取随机抽取的方式确定。

(2)投标报价低的一方为中标候选人；投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人；投标报价和技术部分得分均相同时，采取随机抽取的方式确定。



7. 推荐中标候选人名单

7.1 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的潜在投标人为排名第一的中标候选人。

7.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

潜在投标人对上述(一)~(四)提出质疑的，采购人或者代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地址；
- (二) 潜在投标人名单和评标委员会成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效潜在投标人名单及原因；
- (五) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中潜在投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4 本次招标采购推荐的中标候选人数量详见招标文件26.3。



第四章 政府采购合同（货物类）

(此合同样本仅供参考,合同具体条款以双方最终签订为准.)

合同条款甲乙双方根据实际情况进行签订，签订内容不得违反国家法规政策，不得违反招标文件及投标文件的约定。(说明:本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。)

昌吉回族自治州人民医院医疗设备采购合同

合同编号：

采购方（以下简称甲方）：昌吉回族自治州人民医院

地址：昌吉市延安北路303号

电话：0994-2350409

邮编：831100

供货方（以下简称乙方）：

地址：

电话：

邮编：

甲方通过公开招标方式购买一批医疗设备（昌吉州州直卫生健康医疗系统医疗XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目）（招标文件编号：XXXX，招标项目名称：昌吉州卫生健康系统XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目（第XX包））。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就设备的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款，共同信守。

一、经甲方同意，乙方向甲方供应完全符合以下要求的设备（设备配置明细等附后）。

序号	设备名称	型号、品牌	产地	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1							
2							
合计金额：小写 ¥xxxxxx 元， 大写：人民币 xxxx 元整（含税）							

设备的易耗配件必须在合同附件（附件1：设备配置清单、附件2：设备备品备件耗材清单、附件3：设备零配件消耗品购买价格清单）中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。



二、售后服务及质量保证：

1、设备（货物）验收合格后，自使用之日起由乙方免费保修____年，如乙方不具备自行维修的资质，可指定厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方履行质保义务。保修期后仍由乙方负责终身维修，乙方可委托厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方提供维保服务。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，人为损坏不在保修范围内；免费保修期后仍由乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）负责终身维修，免费保修期满以后乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）履行保修义务只收取甲方材料费，其他费用予以免除。乙方指定的售后维保商（或厂家）未按照本合同约定履行质保义务的，视为乙方违约，乙方应根据本合同的约定承担违约责任。

2.乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）自收到甲方维修要求（电话、微信、QQ、电子邮件、传真等不限）后应当在30分钟内响应，2小时内提出解决方案并开始进行维修。乙方在甲方提出维修要求24小时内不能维修到位的，则自24小时届满，乙方即有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。乙方为甲方出具一份维修承诺函，乙方一切按照承诺函进行维修。

3.质保期内计算机系统乙方负责免费升级。其中系统中使用的厂家自主知识产权的系统软件，由乙方负责联系厂家进行终身免费升级和保修。除正常维修外，乙方应定期派工程师进行设备检查和维护。

4.乙方在中国国内设有维护部门和零备件库，保证对合同设备所需的零备件长期（本设备使用年限）供应。

三、安装、验收及培训：



1.乙方将设备送达甲方指定地点后，甲、乙双方对设备进行现场验收，并出具验收证明。若在验收时发现设备数量、规格、品种、参数、外观等不符合规定，甲方有权拒收货物，因此产生的相关费用均由乙方负担。

验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告上签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方负担。

2. 乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

3.如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

四、设备质量技术标准及包装：

1.乙方保证所供设备的相关资质证书齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资质证复印件作为本合同附件。

2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。

3.设备包装应为设备生产厂原包装。

五、付款方式：

甲方与乙方签订合同后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方预付第一笔设



备款，合同总金额30%，计 XXX 元；机器到现场安装，进行临床使用人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第二笔设备款，合同款总额的30%，计 XXX 元；机器安装到位后进行维修人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第三笔设备款，合同款总额的30%，计 XXX 元；所有人员培训合格后，达到临床使用标准及要求，甲方收到乙方的项目付款审批单、收据、乙方开票信息等齐全的付款资料后30个工作日内向乙方支付第四笔设备款，合同款总额的10%，计 XXX 元。

甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

六、设备交付：

1.乙方应在合同签订之日起30个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

2.设备的配置详见附件设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单。设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单表是本合同的附件部分。乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

七、合同有效期：为本合同的履行期。

八、公证：如需公证的，公证费用由提出公证需求的一方承担。



九、违约责任：

1.乙方逾期供货或者逾期完成验收、人员培训的，每逾期一日，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2.乙方逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

3.如乙方交付的设备在验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，视为乙方根本违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的交付义务。

4. 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第二条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同二.2约定从乙方最后一笔款项中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付2000元的违约金。

5.如乙方未按本合同二.4的约定，不能保证本合同项下机器设备备件长期供应的，乙方应按照合同二.2的约定提供备用机，该备用机必须是全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的设备；如乙方不能提供符合要求的备用机的，本合同项下设备无法正常使用的，乙方应当按照当时的折旧后的价格予以回购，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括甲方主张权利的诉讼费、律师费、差旅费、调查取证等相关费用）。

6. 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增



加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

7.如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿责任的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

8.甲方如迟延付款的，每迟延一日应向乙方支付应付款总金额万分之一的违约金，该违约金累计达到合同总金额1%封顶。

9.乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。

10.若到货设备参数与招标文件参数响应不一致，视为虚假应标，合同立即终止。给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿责任的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

十、争议解决方法：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、其他：

1.合同变更须经双方书面同意。

2.招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。若合同与标书有冲突之处，以标书为准。



3.本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉诉讼法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲 方（盖章）：昌吉回族自治州人民医院 乙 方（盖章）：

开户行：中国建设银行昌吉分行文化东路支行 开户行：

账 号：65001620300050001465 账 号：

法人代表： 法人代表：

签约代表： 签约代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件1：

设备配置清单

序号	货物名称	品牌	型号	制造商 (产地)	数量	单位
1						
2						
3						

附件 2：

设备零配件、消耗品、耗材（试剂）购买价格清单

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价(元)	对应的投标 设备名称	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							



附件 3：设备零配件、消耗品、耗材（试剂）最低价承诺书

最低价承诺书

我司参加“昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备项目”的招标项目，项目编号:XXXX,我公司中标设备 XXXX,对该设备使用的耗材价格做出如下承诺：提供零配件和耗材，价格为同等级医院的全疆最低价。

承诺单位法定代表人（签字）：
承诺单位（盖章）：

日期：__年__月__日



附件 4：招投标参数正负偏离表盖公章



附件 5：法人授权书盖公章

法人代表授权书

本授权书声明：注册于 (XXXX) 的 (XXX 有限公司)，在下面签字的法人代表 (XX、总经理)，代表本公司授权在下面签字的 (XXX、销售经理) 为本公司的合法代理人，就 (昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）XXX 项目) 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 XXX 年 XX 月 XX 日签字生效，特此声明。

注：被授权人与法人身份证（正反面）扫描件

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公 章：

授权日期：XXX 年 XX 月 XX 日



附件 6：服务承诺书盖章（需提供厂家售后服务承诺书）

服务承诺书

- 1、提供整机免费全保三年（从验收合格之日起开始计算）终身免费维护。
- 2、 系统软件免费升级，需要时与医院各系统无条件免费连接。
- 3、 维修响应时间：维修响应时间 2 小时，接到故障报告后在 4 小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过 2 个工作日，否则乙方需提供备用机供临床使用。
- 4、 提供保修期后无偿技术支持。
- 5、 提供维修、检测和报错系统软件。
- 6、 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。
- 7、 国内有 800 免费电话、维修系统，并提供 7*24 小时服务，提供详细电话号码。
- 8、 配件服务：保修期以外维修配件的价格，我公司承诺按产品的成本价供货。
- 9、 对所提供的产品中在质保期内如有质量问题，可免费更换新品。

承诺单位法定代表人（签字）：

承诺单位（盖章）：

日期： 年 月 日



附件 7：反商业贿赂承诺书盖公章

反商业贿赂承诺书

我单位办理了编号为：_____的招标文件（项目编号：XXXXX）。为确保质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

杜绝任何形式的商业贿赂行为。在设备招采、合同签订及设备验收环节不给医院有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。严格按投标承诺履行合同，如有违反，用户有权依照相关法律追究相应责任。

我们将认真履行以上承诺，并接受监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人（签字）：
承诺单位（盖章）：XXXX

日期：__年__X月__X日



附件 8：中标通知书复印件加盖公章

第五章 采购需求

2024年第二批国产医疗设备购置分包

序号	项目名称	数量	单位	预算单价 (万元)	预算总价 (万元)	分包
1	口腔种植机	1	台	15	15	1
2	口腔牙片机	1	台	5	5	
3	口腔扫描仪	1	台	15	15	
4	口腔综合治疗台	4	台	8	32	2
5	根管马达	1	台	5	5	
6	脑反射治疗仪	2	台	5	10	3
7	超声波治疗仪	2	台	5	10	
8	体感音波反馈系统	1	台	35	35	4
9	超声波清洗机	1	台	2	2	5
10	血液透析机	3	台	16	48	6
11	子痫检测设备	1	台	40	40	7
12	超低温冰箱	2	台	5	10	
13	心衰超滤脱水装置	1	台	80	80	8
14	磁刺激仪	1	台	75	75	9
合计		22			382	

第八包 13. 心衰超滤脱水装置

设备选型：心衰超滤脱水装置 产地：国产 数量 1 套

一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

- ★1、血泵速度为 5mL/min-50mL/min。
- 2、超滤泵速度 $\leq 600\text{ml/h}$ ，脱水精度 $\pm 30\text{mL/h}$ ，累计脱水量误差优于 $\pm 200\text{mL}$ 。
- 3、血泵和超滤泵运动控制为独立 CPU 单元，从主控 CPU 单元分离出来，避免关联故障。
- 4、超滤量和超滤速度实时监测。超滤速度偏离设定的速度时，报警提示。
- ★5、可匹配使用 $\leq 8\text{F}$ 双腔管经中心静脉建立体外循环，或匹配使用两个 $\geq 18\text{G}$ 静脉留置针经外周浅表静脉建立体外循环。
- ★6、可匹配使用体外循环通路：管路内径 $\leq 4\text{mm}$ ；滤器膜面积 $\leq 1\text{m}^2$ ；总血容积 $\leq 65\text{ml}$ 。
- ★7、无需配合透析、置换液使用，不影响电解质平衡和酸碱平衡；无需要监测血钾、钠、氯和血气分析。
- 8、漏血检测：环境光免疫光电检测技术。检测精度为 1‰（1ml 血+1000ml 生理盐水）。
- 9、有滤器前压检测单元，测定范围： $-100\text{mmHg} \sim 400\text{mmHg}$ 。滤器凝血双重检测：连续检测跨膜压和滤器压降，及时准确发现滤器中空纤维内的血凝阻塞状态。
- 10、气泡检测：超声检测法，检测精度 100 μL 。
- 11、具备管路排气和气泡捕获功能。
- 12、其他压力监测

压力检测	范围	误差
动脉压	$-400\text{mmHg} \sim 100\text{mmHg}$	$\pm 10\text{mmHg}$
静脉压	$-100\text{mmHg} \sim 400\text{mmHg}$	$\pm 10\text{mmHg}$
超滤压	$-400\text{mmHg} \sim$	$\pm 10\text{mmHg}$

	100mmHg	
--	---------	--

二、其他：

- 1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表
- 2、提供设备配置的详细清单
- ★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。
- ★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。
- ★5、出现故障不能解决则提供备用机
- 6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修 3 年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 2 小时内，到达现场进行维修，24 小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。



第六章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。



一、投标文件封面格式

正本/副本

昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院） 国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目

项目编号： XJZC(CG)2024-021

(标项八)

投标文件

投标人名称： （全称并加盖公章）

投标人法定代表人： 电话（座机）：

总经理/项目负责人： 手机（实名）：

投标人授权代表人： 手机（实名）：

投标人授权代表人身份证号：

投标人QQ邮箱号：

邮 政 编 码：

日期：2024年__月__日



二、投标文件组成：（按此顺序编写目录）

供应商自查索引表

1、 投标函

1.1、反商业贿赂承诺书

2、 报价一览表

2.1、投标报价明细表

2.2、设备简要说明一览表

3、 商务/技术响应与偏离表

4、 资格证明文件

5、 投标人主要业绩

6、 货物说明

7、 实施方案

8、 售后服务表

9、 人员配置表

10、 投标人认为应提供的其它资料

注：招标文件的内容包括但不限于上述内容，如有不足请自行补充。

三、 供应商自查索引表

3-1 资格审查索引表

序号	审查内容	自查结论	详见 投标文件
1	投标人营业执照彩扫描件，以及投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
2	2022 年度或 2023 年度的审计报告（成立不足 1 年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、利润表、现金流量表）（提供彩扫描件）。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
3	履行本合同所必需的设备清单和具有专业技术的人员清单或承诺书。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
4	提供 2024 年第一季度完税证明及相关人员近 6 个月任意 1 个月的社保缴纳证明；投标人依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商电子公章。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
5	提供没有重大违法记录声明函。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
6	提供法律、行政法规规定的其他条件的书面声明或承诺。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
7	供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证，如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。（按要求提供证明文件）	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
8	信用情况承诺书。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
9	供应商关联企业情况表。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
10	按招标文件规定交纳投标保证金/电子保函。（加盖公章）	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。			

3-2 符合性审查索引表

序号	审查内容	自查结论	详见投标文件
1	投标文件的签字、盖章是否符合招标文件规定。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
2	法定代表人身份证明及授权委托书有效是否符合招标文件规定的格式。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
3	每个标项是否只有一个方案投标。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
4	对招标文件规定的供货范围（服务内容）是否全部作出响应。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
5	交货期(完成期限)是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
6	质保期及售后服务是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
7	投标有效期是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
8	投标文件承诺的付款方式是否满足招标文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
9	投标文件是否附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
10	其报价是否超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页
11	质量技术是否满足招标文件提出的技术和功能要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	第__页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

3-3 综合评分索引表

序号	评分因素	评标标准	详见投标文件
1			第__页
2			第__页
3			第__页
4			第__页
5			第__页
6			第__页
7			第__页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的口打“√”。



四、投标文件格式范本：

1、投标函

昌吉回族自治州人民医院：

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址 _____ 我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的(招标项目名称) (编号为 _____)的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为 90 日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日期： 年 月 日



1.1反商业贿赂承诺书

在（项目名称：_____、项目编号：_____）磋商活动中，我公司承诺如下：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假磋商、陪标、串通磋商，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次磋商权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招标投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日期： 年 月 日

2.1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	标项名称	总报价（元）
1		小写：_____； 大写：_____。
供货时间：		

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

- 注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。
- 2.投标报价为完成本次采购项目内的所有内容的一切相关费用。可根据需要附报价明细。
- 3.投标总价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。
- 4.本表中“投标总价”须与《报价明细表》中的“投标总价”保持一致，如不一致，以《报价一览表》为准。

2.2 投标报价明细表

(设备、材料、系统费用及其他费用)

项目名称：

项目编号：

序号	标的名称	品牌	规格 型号	注册 证号	数量	单位	单价	总价	产地	生产 厂家	备注
	...										
其他费用											
合计总报价（小写）：											
合计总报价（大写）：											

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

注: 1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果报价一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。

4.合计总报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

上述报价包含一切由供方承担的费用。

2.3 设备简要说明一览表

项目名称：

项目编号：

序号	设备名称	规格型号及 主要技术参数	性能说明	供货 厂(商)
1				
2				
3				
...				

注：此表需详列投标的每种设备。

备品、备件清单

序号	备品、备件 名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	合计
1							
2							
3							
...							

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

3、商务 / 技术响应与偏离表

序号	招标文件 条目号或 页码	招标文件要求	投标响应内容	偏离 情况	说明	投标文件 页码
商务响应与偏离						
1						
2						
3						
4						
技术（采购需求）响应与偏离						
1						
2						
3						
4						
5						
.....						

注：1.对招标文件中的所有商务、技术（采购需求）要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.商务条款包括投标有效期、交货期、供货范围、质保期等。

3.需在偏离表页码栏中明确标注技术参数相对应的技术支持资料的页码，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离。

4.核心技术参数、其他技术指标（一般技术参数）对应的相关证明材料以第三方技术支持资料为准包括：（①检验报告；②医疗器械注册证附件——产品技术要求；③食药局备案过的产品说明书或生产厂家产品说明书；④生产厂家技术白皮书）为准。

5.证明材料需加盖生产厂家公章。

6.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日



4、资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1 具有独立承担民事责任的能力

4.1.1 投标人营业执照彩扫描件

4.1.2 法定代表人身份证明

昌吉回族自治州人民医院:

供应商名称: _____

注 册 号: _____

注册地 址: _____

成 立 时 间: ____年____月____日

经 营 期 限: _____

经 营 范 围: _____主营: _____兼营: _____

姓 名: _____, 性 别: _____, 年 龄: _____系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面:



投标人名称 (盖单位章): _____

法定代表人或其委托代理人签字: _____

日期: ____年____月____日



4.1.3法定代表人授权委托书

昌吉回族自治州人民医院:

本人(姓名、职务)系(供应商名称)的法定代表人,现授权(代理人姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义:(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交项目名称: _____ 项目编号: _____ 投标文件及报价;(2)签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: _____。

代理人无转委托权。本授权书于____年____月____日签字生效,特此声明。

代理人情况

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

身份证号码: _____ 电话(实名制): _____

附: 法定代表人身份证正反面: 委托代理人身份证正反面:



供应商名称(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人签字:

日期: 年 月 日



4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2022 年度或 2023 年度的审计报告（成立不足 1 年的提供成立至今的财务报表，
包含资产负债表、利润表、现金流量表）（提供彩扫描件）加盖公章；



4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

履行本合同所必需的设备清单和具有专业技术的人员清单或承诺书

承诺书

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日



4.4 有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录

(提供 2024 年第一季度完税证明及相关人员近 6 个月任意 1 个月的社保缴纳证明;

加盖投标人电子公章; 投标人依法享受缓缴、免缴税收, 免缴社会保障资金的提供证明

材料加盖投标人电子公章;)



4.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录提供声明函

声明函

一、我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人_____、组织机构代码证或统一社会信用代码_____；②法定代表人_____、身份证号码_____；③项目负责人_____、身份证号码_____）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在新疆政府采购网上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

四、我方承诺不存在直接控股或管理关系的投标人同时参加同一合同项下的采购活动的情形。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（印章）：

年 月 日



4.6 法律、行政法规规定的其他条件

提供书面声明或承诺加盖公章

政府采购诚信承诺书

(采购人)：

我公司_____（投标人名称）已详细阅读了项目_____（项目编号：_____）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标；

三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（印章）：

年 月 日



落实政府采购政策需满足的资格要求

投标人声明其所投货物的生产厂家须为中小企业，投标时提供《中小企业声明函》（货物）。

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日



中小企业划型标准规定 (仅作参考填写说明)

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、**本规定适用的行业包括:**农、林、牧、渔业, **工业**(包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 500 万元及以上的为中型企业,营业收入 50 万元及以上的为小型企业,营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元 以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 6000 万元 及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。



(六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入



入 100 万元以下或资产总 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 30 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。

个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

中小微企业划型标准

(仅作参考填写说明)

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$



备注：

- 1、以下《中小企业声明函》（货物）、《节能、环境标志产品》证明材料、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用。

中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件等 (若有，请如实填写)



4.7 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。
- 2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。
- 3、不符合上述适用情形的投标人无应提供上述声明函。
- 4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



4.8 节能、环境标志产品证明材料

(若有, 请如实填写)

1.节能产品: 应在

中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>)

国家发展改革委网站 (<http://www.ndrc.gov.cn>)

中国质量认证心网站 (<http://www.cqc.com.cn>)

2.环境标志产品: 应在

中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>)

国家环境保护部网 (<http://www.sepa.gov.cn>)

中国绿色采购网 (<http://www.cgpn.cn>)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等, 并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。



4.9 残疾人福利性单位声明函

(若有, 请如实填写)

本单位郑重声明, 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

说明: 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 残疾人福利性单位仅应提供声明函, 不应提供其他证明材料。



4.10 监狱企业声明函

(若有, 请如实填写)

本单位郑重声明, 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定, 本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

说明: 按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定, 供应商除提供此声明函外, 还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则评标时不予以认可。



本项目的特定资格要求

4.11 制造商或生产厂商、代理商或经销商应提供的资质证明

- 1、供应商如为所投产品的制造商或生产商，应依法取得《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；
- 2、供应商如为所投产品的代理商或经销商，应依法取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证；
- 3、如投标产品不属于上述医疗器械管理范围的，可提供声明函。
(按要求提供证明文件)



4.12 信用情况需提供承诺书（格式自拟）

加盖公章

信用中国网 <https://www.creditchina.gov.cn>

中国政府采购网 <https://www.ccgp.gov.cn>



4.13 供应商关联企业情况表

供应商的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

供应商名称（单位公章）：_____

供应商应提供关联单位情况，包括以下内容：

1. 单位负责人为同一人的不同单位名单：

单位名称：_____

与本单位关系：_____

2. 存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

单位名称：_____

控股/管理关系说明：_____

3. 供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例（如供应商为上市公司，提供股权占公司股份总数 5% 以上的所有股东名称及相应股权比例）：

股东名称：_____

股权（出资额）比例：_____

4. 供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例：

下属企业名称：_____

持有股权（出资额）比例：_____

注：如供应商不存在以上某种情况，请在相应栏目填写“无”；不得更改要求的实质内容。供应商应如实填报

此表，否则因其响应而影响采购公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。



4.14 投标保证金交纳/电子保函证明

供应商的投标保证金须确保到账，在制作投标文件时，可将交纳证明材料的复印件粘贴在此处。(加盖公章)

5、投标人主要业绩

(1)提供投标人（2021 年至今）

新公司提供其成立以来同类或类似产品的销售业绩

项目名称：

项目编号：

采购单位 名称	设备和项目名称	采购数量	单价	合同 金额	采购单位联系人 及电话

说明：后附业绩证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件，加盖公章。如未附证明材料或证明材料不全或内容模糊不清的，其业绩将不予认定。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日



6、货物说明

货物说明包括：

- (1)产品技术参数（指标）、功能等性能描述；
- (2)产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；
- (3)配置先进合理，技术成熟，安全可靠；
- (4)货物优势介绍；
- (5)产品耐用性及使用功能安全性、采用新技术、新工艺或选用新材料情况；
- (6)投标人认为有必要提供的其他说明材料。



7、实施方案

1、技术方案：技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。

其要点和主要内容为：1.设备配置简介 2.设备技术特点说明及详细方案

2、安装调试、验收、培训方案：（格式自拟）

3、售后服务方案：售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

- ①质保期；
- ②质保期内响应时间；
- ③售后服务方案；
- ④疆内售后服务机构及人员资质；
- ⑤厂家技术支持；
- ⑥技术升级服务；
- ⑦提供备品备件服务；
- ⑧应急处理等售后计划措施；
- ⑨质保期满后的后续维修服务等内容。

8、售后服务表

项目名称：

项目编号：

服务网点名称				备注
地址				
注册资本金		其中：投标人 出资比例		提供相关证明材料 (如:营业执照或租房 合同等)
员工总人数		其中：技术人员数		
经营期限				
售后服务协议				提供相关 证明材料
售后服务内容				此部分内容做附件进 行详细说明
服务承诺				
工作业绩				提供相关 证明材料
业务咨询电话		传真		附人员身份证等相关 证件
负责人		联系电话		

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年 月 日

9、人员配置表

项目名称：项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理 人员								
技术 人员								
售后服务人员								

法定代表人或被委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

日期： 年 月 日

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。



10、投标人认为需要提供的其他资料

【招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置】



第七章、招标结束后注意事项

项目验收

1、交货、包装与组织验收

1.1 采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和投标人之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

1.2 采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

1.3 中标供应商所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，采购人有权拒收，由中标供应商负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

1.4 货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由中标供应商负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由中标供应商负责承担。

1.5 货物由中标供应商进行安装，安装后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。交货 10 日后，证明货物以及改装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。如验收不合格，中标供应商应退货，预缴押金的不予退还，一切损失由中标供应商承担。

1.6 验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.7 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

采购项目验收单

(仅供参考，以采购单位验收单为准。)

项目名称及编号					
采购人				项目负责人	
中标(成交)供应商				采购方式	
合同完成时间				项目验收时间	
中标(成交)货物				验收情况	
序号	产品名称	制造商	数量	规格参数	是否合格
详见《中标（成交）通知书》采购清单					
验收小组	采购人代表				
	专业技术或使用人员				
	验收监督人员				
	项目验收意见		(是否合格)		
供应商意见：（是否属实）					
供应商单位盖章：					
供应商代表（签字）： 20 年 月 日					
采购人意见：					
(是否合格)					
采购人公章：					
20 年 月 日					

备注:1.采购人自行组织验收【采购法 87 号令第七十四条采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档】。

2.采购人视项目具体情况,应邀请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。

3.本验收单一式四联，采购人 2 联、代理机构 1 联、中标（成交）供应商 1 联



履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称) _____

_____号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于____年____月____日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的____%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为,均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称: _____

签字人姓名和职务: _____

签字人签名: _____

公章: _____



履约担保函格式

(采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函 (项目用)

编号:

(采购人): _____

鉴于你方与_____ (以下简称供应商) 于____年____月____日签定编号为
的《采购合同模版》(以下简称主合同), 且依据该合同的约定, 供应商应在____年____月
日前向你方交纳履约保证金, 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请,
我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 将中标项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经采购招标机构人同意, 将中
标项目分包给他人的;
2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供货物/完成工程的;

(2) _____。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元

(大写_____), 币种为_____。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后
日内。 如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供货物/完成工程的, 由我方在保证



金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照 检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/货物全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。



2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的磋商保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本电子保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、电子保函的生效

本电子保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

履约保证金退还申请单

(中标单位如交纳履约保证金应提供此模版)

昌吉回族自治州人民医院:

我公司已按合同规定对 (单位) (项目名称) 履约完毕 (采购验收单附后), 本项目中标 (成交) 金额 _____ 元, 已交纳履约保证金 _____ 元, 现申请退还履约保证金, 请按有关规定给予办理。

收款单位:

银行账号:

开户银行全称:

退还金额(大写):

法定代表授权人:

联系电话:

中标 (成交) 投标人公章

年 月 日

项目负责人签字:

年 月 日

履约保证金收款收据原件的粘贴处

(xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函 (模版)

日 期：2024 年 月 日

今收到：新疆正成招标代理有限公司

事 由：退还昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）
国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目
标项八：昌吉回族自治州人民心衰超滤脱水装置【投标保证金】

项目编号：XJZC(CG)2024-021-8

金额（大写）：壹万陆仟元整 （小写）：¥ 16000.00 元

收款单位（财务章）★：XXXXXXXXXX

联系电话（经办人）★：XXX XXXX XXXX

退还投标保证金须知：自中标结果发布之日起 1 个工作日公示期满。

- 1.未中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；上述提供的附件加盖公章扫描件（PDF 版）发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 5 个工作日内退还未中标单位的投标保证金。
- 2.中标的供应商需提供附件如下：①.投标保证金银行汇款凭证；②.企业银行开户许可证或基本存款账户信息；③. (xxxxxx 企业) 退还投标保证金的函请将退款信息填写无误；④.提供签订的采购合同扫描件（PDF 版），发送至指定邮箱 385585645@qq.com, 合同备案完成后 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。
- 3.供应商未及时提供符合要求的退还投标保证金的函，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，造成逾期退还投标保证金的，由供应商自行承担。
- 4.综上所述供应商提供附件①、②代理机构审核完成后，以电汇或网银的方式予以退还，请供应商注意查收。供应商因自身原因导致逾期未办理退还手续，因所产生的后果供应商自行承担。



政府采购评审人员廉洁自律承诺书

昌吉回族自治州人民医院:

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,本人就参加**昌吉州州直卫生健康医疗系统(昌吉回族自治州人民医院)国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台(套)医疗设备项目(项目编号:XJZC (CG) 2024-021)**评审工作,郑重承诺如下:

一、在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定,遵循公平、公正、诚实信用原则,依据采购文件规定的办法、标准和要求,客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求,不接受、不索取采购人、采购组织机构、供应商及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知晓并严格遵守政府采购工作纪律。

四、现清楚知悉参加本采购项目的所有供应商情况,并为之无任何利害关系:之前也未参加过与本项目采购需求和采购文件等的咨询、论证工作,不存在需要回避的情形。

五、如发现采购活动中存在违法违纪行为的,及时向采购人、采购组织机构或财政部门报告并加以制止。

六、如在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的,自觉接受财政部门的处罚,因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的,依法承担民事责任。

(以上利害关系包括参加评审活动前 3 年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人,曾在其中担任董事、监事,或者曾与其存在劳动关系;与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系;本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷;个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系;所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司(联营企业和合营企业)情况关系;分级代理或代销关系、管理关系、重要业务(占主营业务收入 50%以上)或重要财务往来关系(如融资)等其他实质性控制关系;配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问)。

七、根据我国个人所得税法的相关规定,对个人一次性取得或一个月内累计取得劳务报酬所得超过 800 元以上的,应自行向税务部门申报个人所得税。

评标专家签字:

2024 年 9 月 5 日

