

## 绍兴市柯桥区医疗机构医疗设备购销合同

购买方：(医疗单位) 绍兴市中心医院医共体总院 (以下称甲方)

销售方：(供货企业) 北京中维康达医疗设备贸易有限公司 (以下称乙方)

为保证医疗设备的质量，提高社会效益和经济效益，经公开招标(项目编号：绍柯采[2024]2589号-1)，确定甲、乙双方医疗设备的购销关系，并协商订立如下合同：

## 一、产品项目

| 产品名称                     | 规格型号          | 生产企业          | 计量单位 | 数量 | 单价(元)   | 总金额(元)     | 备注 |
|--------------------------|---------------|---------------|------|----|---------|------------|----|
| 医用血管造影X射线系统              | Azurion 7 M20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 套    | 1  | 8220000 | 8220000    | /  |
| 合计人民币金额(大写)：人民币 捌佰贰拾贰万元整 |               |               |      |    |         | ¥8220000 元 |    |

## 二、交货时间、地点

合同签订后根据医院机房建设进度，在收到医院通知 30 天内由乙方按招标文件要求将产品免费送到绍兴市中心医院医共体总院，并安装调试完毕。逾期超过约定日期 20 个工作日不能交货的，甲方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

## 三、质量保证及售后服务

1、乙方所提供的产品应当符合产品的国家标准、标文要求和技术参数、功能指标等，乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方单方面解除合同。

2、乙方所提供的产品，必须按质保单，保修项目和保修期限及承诺进行保修及售后服务。保修期为 2 年，保修期的期限应以甲乙双方验收合格之日起计算，保修期内免费维修、保养、更换零配件及免工时费、差旅费。乙方在保修期内应确保开机率为 95% 以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。过保修期后免收服务费，只收零配件费用(零配件费用清单详见附件)。乙方在接到甲方要求服务通知，报修响应时间 2 小时，到场时间 24 小时(不可抗拒力量下除外)。72 个小时不能修复的，则无偿提供替代物品供甲方使用。如果乙方违反维修保养义务应向甲方支付合同总金额 10% 的违约金。

3、中标人、供货人名称必须一致。如出现转包等问题，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

## 四、验收及付款方式

1、乙方在签订合同时，应向甲方提交产品技术文档(进口货物必须提供中、英文版)一份。  
2、甲方要协助乙方做好安装调试工作，及时验收并签字盖章。  
3、验收标准：符合国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书文件(详见附件及招标文件)一致。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。乙方负责免费培

训甲方的使用操作人员及维修技术人员。

4、合同签订后 30 个工作日内支付合同总金额的 40%，装机验收合格并正常使用 3 个月内支付合同总金额的 60%。

5、甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在 7 个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。如因乙方责任导致推迟，每推迟一天，按合同总价的 0.1% 的违约金给甲方。设备到货后 5 个月因乙方原因仍不能验收合格，甲方有权解除合同，乙方需向甲方按照合同总金额的 10% 支付违约金并赔偿其它损失。

五、严格遵守廉政承诺制度，经销公司要诚信经营，不弄虚作假，不向甲方单位和个人给予回扣，发现有不良行为的，中止合同，禁止参加投标活动，甲方应维护乙方的合法权益，不收受各种回扣，杜绝商业贿赂行为。

六、提供的资质材料及相关数据，如有虚假，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。招标文件、投标文件及承诺书等作为合同附件与合同正本具有同等法律效力。

七、不可抗力事件处理。

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4. 中标结果公示期满后 7 个工作日内遇有效第三方对本次招标结果提出质疑投诉的，且招标人答疑之后未能通过政府部门对本招标结果的最终认可，则已签合同自行作废，招标人不承担对中标人的任何经济补偿。如政府部门对本招标结果裁定认可的，中标人供货期可自政府部门裁定之日起计算。

八、双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

九、其它补充约定：

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方壹份。本合同双方签名并加盖单位公章后生效。如因质疑投诉乙方导致项目废标、合同解除或无效而产生的后果，由乙方自行承担。

甲方（盖章）：绍兴市柯桥区中心医院医共体总院

地址：绍兴市柯桥区华宇路 1 号

电话：0575-85580090

法定（授权）代表人（签字）

开户行：中行柯桥支行

帐号：405248833700

乙方（盖章）：北京中维康达医疗设备贸易有限公司

地址：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 C0043 室

电话：/

法定（授权）代表人（签字）

开户行：宁波银行股份有限公司北京分行营业部

帐号：77010122001758169

2025 年 6 月 30 日

2025 年 6 月 30 日


## 合同配置清单

设备名称：医用血管造影 X 射线系统

| 序号 | 部件编号<br>P / N        | 名称<br>DESCRIPTION         | 单位 | 数量<br>QTY | 单价<br>(元) | 备注         |
|----|----------------------|---------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 1  | Azurion 7 M20        | 医用血管造影 X 射线系统             | 套  | 1         | 8220000   |            |
| 2  | 飞利浦 DFM100           | 除颤监护仪（带起搏）                | 套  | 1         |           |            |
| 3  | 飞利浦 MX550            | DSA 专用双屏显示监护仪             | 套  | 1         |           |            |
| 4  | 拜尔<br>Mark7 Arterion | DSA 专用高压注射器（双屏<br>双控）     | 套  | 1         |           |            |
| 5  | 顾斯博士                 | 防护用品（包括铅衣、铅围<br>脖、铅帽、盖巾等） | 套  | 2         |           |            |
| 6  | /                    | 脑医汇<br>LINK 数字全景系统 V3.4.0 | 套  | 1         |           |            |
| 7  | /                    | 双向对讲系统                    | 套  | 1         |           |            |
| 8  | /                    | 红外遥控器                     | 个  | 2         |           |            |
| 9  | /                    | 头托                        | 个  | 1         |           |            |
| 10 | /                    | 悬吊式手术灯                    | 套  | 1         |           |            |
| 11 | /                    | 输液器吊架                     | 套  | 1         |           |            |
| 12 | /                    | 双侧臂托                      | 对  | 1         |           |            |
| 13 | /                    | 桡动脉穿刺臂托                   | 个  | 1         |           |            |
| 14 | /                    | 悬吊式射线防护屏及床旁<br>射线防护帘      | 套  | 1         |           |            |
| 15 | /                    | 多功能脚闸                     | 套  | 1         |           | 可控制<br>手术灯 |
| 合计 |                      |                           |    | 17        | 8220000   |            |

敬呈：绍兴市中心医院医共体总院

医用血管造影系统行业第一品牌-PHILIPS  
Azurion 系列单向全兼容悬吊大平板 7M20 R2

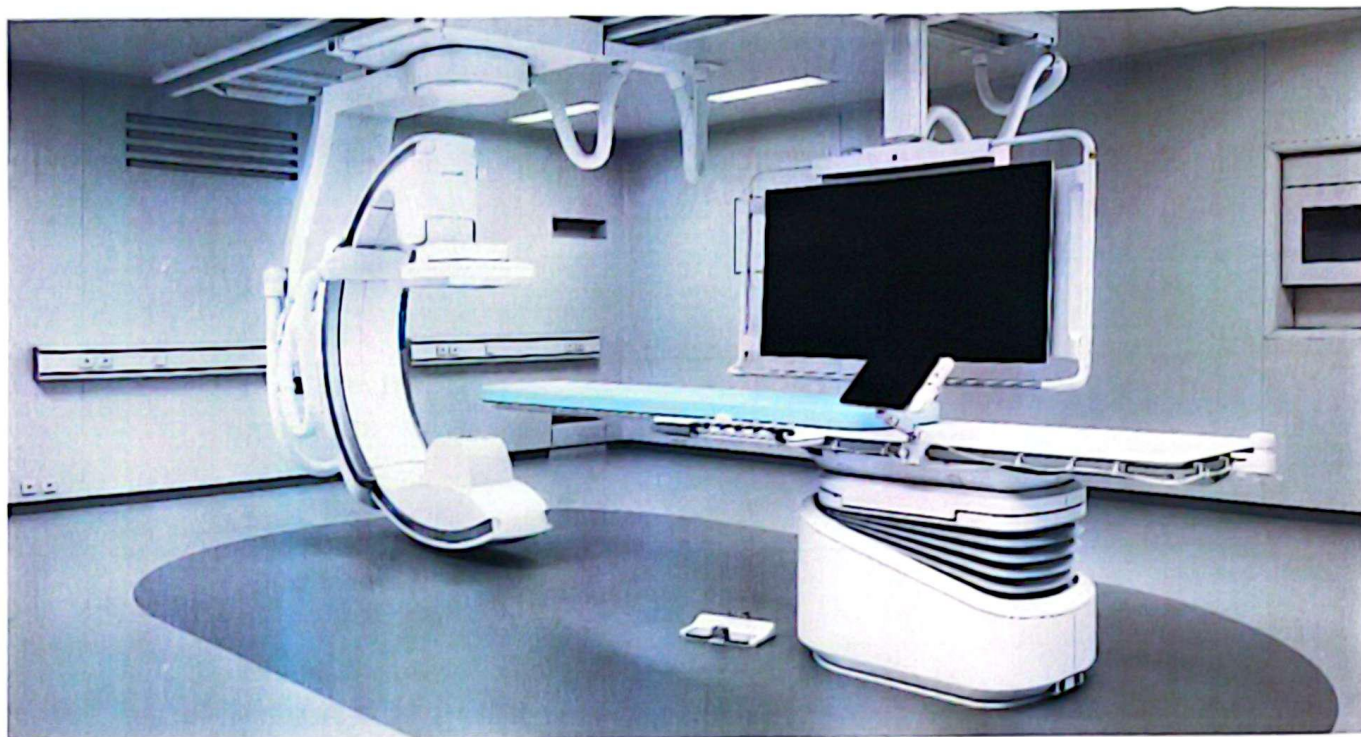

飞利浦医疗科技  
Philips Healthcare

## 第一部分：系统配置

|     |   |                                               |
|-----|---|-----------------------------------------------|
| 1.  | 1 | Azurion 7M20 system<br>Azurion 7M20 系统        |
| 2.  | 1 | Connect OS<br>多点云工作平台（飞利浦独有系统）                |
| 3.  | 1 | 100kHz X-ray Generatio<br>100k 赫兹 X 线发生器      |
| 4.  | 1 | 6.4 MHU X-ray Tube<br>6.4 兆 X 线球管             |
| 5.  | 1 | 20 Inch Dynamic Flat Detector<br>20 英寸动态平板探测器 |
| 6.  | 1 | User Interface<br>用户操作界面系统                    |
| 7.  | 1 | Control module<br>控制面板                        |
| 8.  | 1 | Win10 System<br>Window 10 操作系统                |
| 9.  | 1 | DICOM Interface<br>DICOM 接口                   |
| 10. | 1 | Print preview<br>DICOM 打印                     |
| 11. | 1 | RIS_CIS Interface<br>RIS_CIS 接口               |
| 12. | 1 | Chinese/English interface<br>中/英文操作界面         |
| 13. | 1 | Ceiling Suspended Geometry<br>悬吊式机架           |
| 14. | 1 | The Xper Table Standard<br>标准型导管床             |
| 15. | 1 | Table pivot option<br>床面旋转功能                  |
| 16. | 1 | Extend to 4 F MCS in ER<br>手术间四架位显示器吊架        |
| 17. | 2 | 24 Inch LCD Monitors in CR<br>控制间 24 英寸监视器    |
| 18. | 1 | Exam light<br>手术灯                             |

|     |   |                                          |
|-----|---|------------------------------------------|
| 19. | 1 | Viewpad<br>红外遥控器                         |
| 20. | 1 | Intercom<br>双向对讲系统                       |
| 21. | 1 | Foot switch monoplane in ER<br>手术室脚闸（单向） |
| 22. | 1 | hand switch monoplane in CR<br>控制室手闸（单向） |
| 23. | 1 | Arm support board<br>桡动脉穿刺用臂托            |
| 24. | 1 | Set of elbow support<br>双侧手臂托架           |
| 25. | 1 | Head support<br>头托                       |
| 26. | 1 | Drip Stand<br>输液架                        |
| 27. | 1 | Matress<br>床垫                            |
| 28. | 1 | Patient straps<br>病人束带                   |
| 29. | 1 | Table accessory rail clamps<br>导管床轨道夹    |
| 30. | 1 | Video WCB<br>视频隔离连接盒                     |
| 31. | 1 | Radiation shield<br>悬吊铅屏风                |
| 32. | 1 | Radiation shield bracket<br>悬吊铅屏风吊架      |
| 33. | 1 | Table mounted radiation shield<br>床旁辐射防护 |
| 34. | 1 | Touch screen module<br>触摸屏面板             |
| 35. | 1 | TSM Chinese operating system<br>中文触屏操作系统 |

## 第二部分 高级配置

|     |   |                                             |
|-----|---|---------------------------------------------|
| 1.  | 1 | FlexVision XL<br>检查室 58 吋超大 LCD 监视器         |
| 2.  | 1 | Quantitative Coronary Analysis<br>冠脉定量分析软件  |
| 3.  | 1 | Left Ventricular Analysis<br>左心室分析软件        |
| 4.  | 1 | Procedure Cards<br>程序卡片（飞利浦独有系统）            |
| 5.  | 1 | Zero Dose Positioning<br>零剂量定位（飞利浦独有系统）     |
| 6.  | 1 | Combined Mask<br>组合蒙片（飞利浦独有功能）              |
| 7.  | 1 | Roadmap Pro<br>智能路图（飞利浦独有功能）                |
| 8.  | 1 | Unsubtract roadmap<br>非减影路图                 |
| 9.  | 1 | Oncoblue<br>介入低剂量成像                         |
| 10. | 1 | Instant Parallel Working<br>实时并行工作          |
| 11. | 1 | Table tilt option<br>床面头足倾斜功能               |
| 12. | 1 | Table cradle option<br>床面左右摇篮功能             |
| 13. | 1 | Rotational scan<br>旋转采集                     |
| 14. | 1 | IW hardware<br>高级三维工作站                      |
| 15. | 1 | Smart CT angio Acquisition<br>三维采集          |
| 16. | 1 | SmartCT Vessel Analysis<br>SmartCT血管分析功能    |
| 17. | 1 | Smart CT Soft Tissue Acquisition<br>超清类CT采集 |

绍兴市柯桥区医疗机构医疗设备购销合同

|     |   |                                                                                   |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | 1 | SmartCT Metal Artifact Reduction software package<br>SmartCT金属伪影抑制(MAR) CT成像应用技术包 |
| 19. | 1 | SmartCT Roadmap<br>三维路图                                                           |
| 20. | 1 | StentBoost Live<br>实时支架精晰显示                                                       |