

采购合同

采购项目名称：医疗设备采购项目（高频电刀、病人保温系统）（标项一）

合同编号：2023S0502

采购单位（甲方）：桂林医学院附属医院 采购计划号：广西政采[2023]23658号-002

供应商（乙方）：广东益升健康科技有限公司 项目编号：GXZC2023-G1-004645-GSZX

签订地点：桂林医学院附属医院 签订时间：2024年1月30日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表：货物名称、品牌、型号、规格、厂家、数量、金额（其中：货物名称、品牌、型号、规格、厂家须与医疗器械注册证或备案证一致）。

产品名称	器材注册证号	品牌型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）
高频电刀	国械注准 20153011796	延陵、 POWER-42 0FX	常州市延陵电 子设备有限公司	台	26	¥76500.00	¥1989000.00

合计金额人民币（大写）：壹佰玖拾捌万玖仟元整 小写：¥ 1989000.00 元

（合计金额包括但不限于货物货款、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位和安装、调试、培训、保修等的费用。如招标文件另有规定的，从其规定）

对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

二、付款条件及期限：

1. 接甲方供货通知后，在交货期限内将货物送到甲方指定地点；
2. 货物安装调试完成，验收合格后，中标供应商开具全额税务发票，采购人在验收合格并无故障运行，走院内付款流程后转账支付合同款的95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【中标供应商承诺质保期（免

费保修、维护、升级期)满1年】且不存在争议的,三个月内转账支付(无息)。采购人付款前,中标供应商未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的,采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

3. 票据要求: 中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现中标供应商提供虚假税务发票,除须向采购人补开合法的税务发票外,须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金,且采购人有权终止合同,供应商不得提出异议,因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装,以保证货物安全无损的输到达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内交付甲方。

3. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点,并负责清理回收甲方抛弃的相关大件包装,不另收任何费用。货到甲方前48小时,由乙方通知甲方,但在验收前甲方原则上不负责接收货物。

四、质量要求

1. 乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至36个月止(按投标文件中生产厂家或授权代理商承诺的最长保修期为准)。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费修理和无条件更换,并按售后服务承诺书(附件),延长保修期。

3. 保修期内,如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后按承诺的时间(4小时)内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理,每次扣除合同款的1%,总金额不超过合同款的5%,否则按本合同第九条第2款追究法律责任。

4. 保修期外维修应同样提供免费咨询服务,需上门维修的不收取维修费,仅收取材料费。

五、货物的验收

1. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出配置清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

2. 甲方对乙方所交货物依照国家有关标准及配置清单进行现场验收,全部货物及附随配件、软件全部清点无误且能达到技术要求的给予签收,验收不合格不予签收,后果由乙方负责。乙方承诺安装调试完毕,达到医院正常使用状态,安装调试完毕,达到验收合格标准的时间最长不超过30天,超过此期限者,视为验收不合格,甲方有权拒绝付款,并要求乙方承担由此造成的损失。

3. 乙方应在货到指定地点安装、调试完毕，确保正常使用，并按甲方通知时间配合验收。

六、交货期及交货方式

1. 交货期：自合同签订之后，接甲方通知之日起60个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。

2. 交货方式：现场免费安装调试、培训、全部货物及附随配件、软件、信息化网络端口连接等全部清点无误且正常使用，达到甲方使用功能要求，验收合格。

3. 交货地点：甲方指定地点。

七、售后服务条款

1. 交钥匙工程：本项目为交钥匙项目。乙方负责产品的安装调试及人员培训。在保修期内，乙方必须保证甲方能够合法应用该器械/服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同/协议价格中。在此过程中，甲方应当提供必要支持。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

2. 易损零配件和专机专用试剂耗材价格表：本项目合同/协议中，应附易损零配件和专机专用试剂耗材价格表。

3. 维修技术支持：乙方一次性免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，否则不予验收。保修期外，无偿提供维修密码及软件在该项目中的使用权，按合同约定价格提供零部件，以及快速响应的技术支持。保修期外，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场处理。

4. 相关人员培训：标的已包含医护人员及工程人员的培训计划费用，其中医护人员省区内专项操作培训2人次；工程人员省区内/省区外专项维保培训0人次。

5. 乙方无偿保证甲方获得合同约定范围内所有软件功能，终生单机软件使用权。不得限制硬件配件采购，并在甲方自主更换配件后，无偿帮助甲方恢复原有的软件及系统，使甲方能够正常使用该器械/设备、项目。

6. 乙方承诺保修期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

7. 在设备规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。并承诺过保修期后的维修及配件更换不需预付款，按照医院正常付款流程办理。

8. 其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

9. 售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

八、争议解决

本合同履行期间发生争议的，由甲方住所地人民法院管辖

九、违约责任：

1. 乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同标的 0.3% 支付违约金。

2. 乙方逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，并有权要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失，以及维权产生的相关费用（包括但不限于：律师费、案件受理费、保全费、保单保函保险费、交通费、误工费、鉴定评估费等）

3. 乙方提供的投标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总额 30% 的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

4. 乙方提供的货物不符合本合同第四条质量要求的，甲方有权要求乙方无条件换货或者退货，甲方换货的，相关的运费及损失由乙方承担；甲方退货的，乙方应在甲方发出退货通知之日起三日内，将所收取的款项全额予以退回，乙方应向甲方支付合同总额 30% 的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

5. 乙方不能按本合同第五条货物的验收要求交付验收的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额 30% 的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

6. 乙方未履行约定售后维修维护责任，每发生一次应按合同价款 1% 支付违约金，该违约金甲方有权直接从未付货款中抵扣；乙方累计发生 5 次，或者造成甲方无法正常使用或声誉受损的严重后果的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额 30% 的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。乙方应向甲方支付合同总额 30% 的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失，并追究乙方相关法律责任。

十、本合同记载地址视为送达地址，送达地址变更需采用书面形式

本合同尾部及《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》载明的乙方地址及联系人用于接收往来函件及诉讼法律文书，且适用于因本合同履行相关的一切纠纷处理程序（如仲裁、诉讼、执行等）的送达。如有变更，乙方需以书面方式通知甲方，未书面通知变更的，凡向合同记载地址或联系方式、联系人发送的文件及信息，无论是否实际收到，均视为有效送达。

十一、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。如甲乙双方合同条款内容不一致者，以在甲方存档者为正本。

十二、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十三、附件：（设备（系统）必须提供配置清单）

附件 1：本设备适用耗材、试剂的价格表

附件 2：本设备易损零配件的价格表

附件 3: 投标报价细表

附件 4: 本项目设备（系统）配置清单

附件 5: 备品备件清单及易损件的优惠报价清单附件 6: 投标货物或产品的质量说明

附件 7: 售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级(含省级)以上代理商的盖章]

附件 8: 商务、技术要求响应表

附件 9: 医疗器械注册证及附件



附件 10: 制造商授权书

附件 11: 供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证

附件 12: 中标通知书

甲方（章）：桂林医学院附属医院 2024年1月30日	乙方（章）：广东益升健康科技有限公司 2024年1月30日
单位地址：桂林市秀峰区乐群路15号	单位地址：广州市天河区黄埔大道西128号1912房
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
电话：0773-2802050 招标办	电话：020-37636268
电子邮箱：	电子邮箱：yishengjiankang812@163.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州东环支行
账号：	账号：44050149120100001583
邮政编码：	邮政编码：510632

合同附件

<p>1. 供应商承诺具体事项:</p> <p>详见附件 6</p>	
<p>2. 售后服务具体事项:</p> <p>详见附件 7</p>	
<p>3. 设备如有低值易耗品及维修配件、检验试剂, 请填写参考供货价格; 如需使用, 按桂林医学院附属医院内控制度执行。</p> <p>无</p>	
<p>4. 其他具体事项:</p> <p>4.1. 设备科只负责设备到货验收, 不负责接收货物。设备的外包装(木箱、纸皮等)由供货商或工程师负责拆除并自行作院外处理, 不得堆放在院内, 但可委托我院后勤部协助处理(需付费)。一经发现在院内, 院方有权不予验收该设备并从设备货款中扣除 200-1000 元作为垃圾处理费。</p> <p>4.2. 进口设备供应商应在到货验收时提供报关单, 如无报关单该设备将不予验收及付款, 并按违约处理。</p> <p>4.3. 递交发票时请附: 发票及合同复印件、验收单、培训单原件、进口设备报关单各一份。合同有分期付款的, 请供应商在每次递交催款通知单时附上合同复印件一份, 并注明本次付款为第几笔款, 以便核对。</p>	
<p>甲方(章): 桂林医学院附属医院</p> 	<p>乙方(章): 广东益升健康科技有限公司</p> 

附件 1：本设备适用耗材、试剂的价格表

耗材、试剂名称	产品注册证号	型号规格	生产厂家及品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
/	/	/	/	/	/	/	/

附件 2：本设备易损零配件的价格表

易损配件名称	产品注册证号	型号规格	生产厂家及品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
负极板连线	/	/	常州市延陵电子设备有限公司	根	1	120	120
随弃式导电粘胶极板	苏械注准 20172011401	详见注册证	常州市延陵电子设备有限公司	片	1	17	17
随弃式导电粘胶极板(普通)	苏械注准 20172011401	详见注册证	常州市延陵电子设备有限公司	片	1	7	7
一次性使用高频电刀笔	苏械注准 20152010472	详见注册证	常州市延陵电子设备有限公司	支	1	26	26

附件3 投标报价细表

2. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：医疗设备采购项目（高频电刀、病人保温系统）

项目编号：GXZC2023-G1-004645-GSZX 分标：标项一

投标人名称：广东益升健康科技有限公司 单位：元

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量/ 单位 ①	单价(元)②	合价(元) ③=①×②	备注
1	高频电刀	POWER-420FX	延陵	26 台	¥76500.00	¥1989000.00	无
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币壹佰玖拾捌万玖仟元整（¥1989000.00元）							
验收标准：与招标文件要求的验收标准一致							
优惠及其它：无							

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，涂改处须加盖公章，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。


4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物名称”一栏中，填写具体货物。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。
注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：
投标人（盖公章）：广东益升健康科技有限公司

日期：2024年01月04日

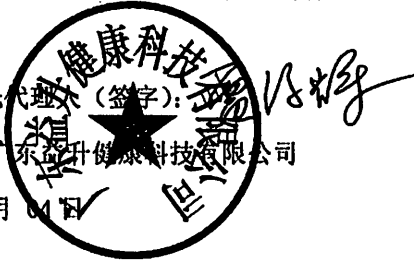

附件 4: 本项目设备 (系统) 配置清单

序号	部件编号	名称	注册证号	规格型号	生产厂家及品牌	单位	数量	总价 (元)	备注
1	/	高频电刀	国械注准 20153011796	POWER-42 0FX	常州市延陵 电子设备有 限公司、延陵	台	26	¥1989000.00	配置明细见 后附配置清 单

附件：1.2. 配置明细清单

高频电刀 POWER-420FX

配置清单

高频电刀主机	一台
电源线	一根
一次性可伸缩电刀笔	五把
双极镊子	一套
防水双脚踏开关	一只
防水单脚踏开关	一只
负极板连线	二根
绝缘容器	一只
随弃式导电粘胶极板	十片
万能转换头	一个
台车	一台
合格证	一份
使用说明书	一份
保修卡	一份
安装调试单	一份



常州市延陵电子设备有限公司

1. 设备性能配置清单

设备性能配置清单

所投分标：标项一分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	高频电刀	26 台	延陵	POWER-420FX	常州市延陵电子设备有限公司	江苏常州	见附件技术参数和配置明细清单、技术偏离表


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无或描述清楚，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：广东德升源科技有限公司

日期：2024年01月04日

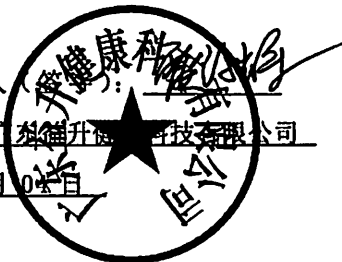

附件：1.1 技术参数

POWER-420FX 技术参数

一、产品使用范围：

设备可用于手术室全部外科手术使用，也可用于泌外、妇科等用于单极前列腺电切或宫腔镜电切治疗使用。

二、产品主要特点：

1. 多微处理器协同工作，功率控制软件双重控制，功率输出更加符合临床需求。完善的设备自我检测、自我诊断技术，技术反映设备的各种异常情况，设备更加安全可靠，是具有电脑控制、组织密度即时反馈技术的高频电刀
2. 功能齐全，单、双极具备，使用范围广，从小儿手术、精细手术以至于大型手术，低电压特性尤其适合宫腔、腹腔镜及电切汽化镜手术；因较小的热损伤，同时也降低了手术中的烟雾。
3. 采用实时阻抗响应技术，较小的纯切功率即可满足汽化电切手术要求。较小的混切功率设定即可满足普通手术，而不必作频繁的功率调节。
4. 电凝具备多种不同的输出，可在前列腺汽化电切及肿瘤手术时提供喷凝功能。满足临床的各种需求。
5. 控制方式：单极即可手控，也可脚控输出。输出端口采用机械连锁装置，有效防止手术中的误操作。手术过程中不必进行单、双极模式转换。
6. 安全：采用双片极板质量型监控系统，杜绝患者与中性极板接触不良而引起的烫伤，自我判断极板类型，杜绝单片极板误用为双片极板。功率输出双处理器实时监控和控制，即使在机器发生单一故障的情况下，依然可以保证患者和使用者的安全。
7. 主电路采用软开关开关电源技术，功率输出效率更高，并且整机采用双重绝缘，充分保证了医务人员的安全。
8. 双刀笔输出控制技术，可分别进行单极电切操作；可同时进行单极电凝操作。
9. 配盘气流量仪可升级为氩气刀，适用于消化内科和肝胆外科手术。
10. 运用实时阻抗响应技术和质量型中性极板安全技术，切效率高，凝血可靠。
11. 即时反馈技术系统：主机通过电脑控制，该系统可依据密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节，而不必认为调节

三、产品工作模式：

1. 三种切割模式：


- 1.1. 低压切割：适用于整形、小儿、颌面外科等精细组织切割。
- 1.2. 纯切：适用于任何组织精细无损伤切割，如整形、烧伤切齿等。
- 1.3. 混切适用于任何组织，在切割的同时提供很好的凝血的效果。

2. 四种凝血模式：

- 2.1. 干燥：适用于腹腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血。
- 2.2. 电灼：适用于大部分手术的浅表凝血。
- 2.3. 适用于大部分手术的浅凝血以及腹腔镜手术。
- 2.4. 喷凝：适用于大面积的组织渗血，而只造成非常浅表的组织热损伤。


3. 两种双极输出模式：

- 3.1. 精确双极：用于神经外科和显微外科。
- 3.2. 精准防粘：用于神经外科和显微外科电凝手术。即当镊子中间的组织或血管已经凝固而电阻大到100欧姆时，输出功率直线下降，从而有效防止镊子的粘连和对组织的过烫灼伤。
- 3.3. 安全双极：用于现代腹腔镜手术，即腹腔镜中使用的双极切割和双极凝血。

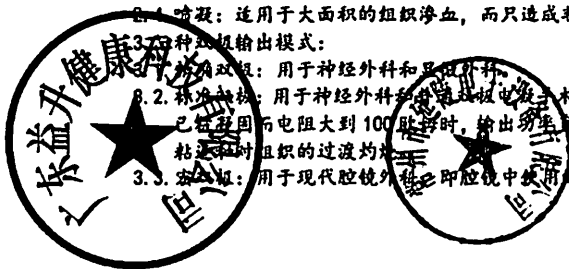

三、产品主要技术参数:

- ★设备类型: 1类CF型, 防除颤普通设备
- 具有REM安全系统保护装置。
- 工作方式: 间隙加载连续运行, 暂载率10S/30S
- 功率设定: 通过主机面板上按键调节, 数码管指示。
- 功率输出
纯切 300W ★低压切 300W 混切 200W
干燥 120W 电灼 120W ★低压电灼 120W 喷雾 120W
精确双极 70W 标准双极 70W 宏双极 70W
- 电源: 单相交流 220V±22V, 50Hz±1Hz, 最大电流≤4A
- 电压技术要求: 具备低电压工作技术性能, 所有模式中, 最大峰值电压≤5500V。
- 电效率: 整机效率≥58%, 开关电源≥80%, 高频功放≥68%
- 冷却方式: 无风扇, 自然对流冷却。
- 外形尺寸: 460×360×130; 包装外形尺寸: 605×530×255
- 自重: 主机 9kg, 脚踏开关 3.2kg; 整机毛重 16kg。
- 使用条件: 环境温度 5°C~40°C, 湿度≤80%RH, 大气压力 860hpa~1060hpa
- 运输和贮存条件: 环境温度 -40°C~55°C, 湿度≤95%RH, 大气压力 860hpa~1060hpa



常州延陵电子设备有限公司

附件 5:备品备件清单及易损件的优惠报价清单

无

附件 6:投标货物或产品的质量保证金说明

在该项目实施过程中，我公司对本项目投标产品做以下质量保证承诺：

1、所提供的产品为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由我方负责承担全部赔偿责任。

2、产品在开始使用前的安装、调试过程中，将派专人对现场有关人员进行协助、指导、并对使用方指定的人员进行相关培训。

3、保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致，采购方在产品运行使用期间，应按操作规程和安装使用说明书规定的方法操作。

4、质保期：整机保修 3 年。

5、在使用过程中出现故障，30 分钟内响应，4 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 48 小时修复，其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

6、本公司质量及交货期违背合同规定造成损失，按合同条款和有关法律规定承担相应的经济责任。

7、我方于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出的响应均真实、有效。

供应商盖章：广东益升健康科技有限公司

日期：2024 年 01 月 15 日

附件 7:售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级(含省级)以上代理商的盖章]

4. 售后服务承诺书

售后服务承诺书

我方郑重承诺如下:

1、提供厂家正规渠道全新的、无侵权的、原厂生产的原装货物,保证完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2、将设备安全无损地运抵指定地点并按照合同约定承担设备的运费、保险费等费用及运输、装卸等过程中的一切安全责任及义务。

3、安装调试及培训:免费送货上门,货物到达日将会有专业工程师跟进卸货及安装,并签订设备安装完成确认函。等调试完成后,看医院科室的时间安排,进行免费的临床培训和使用操作,以及保养维修,同时会按相关要求提供所有设备的文档及全部有关本次采购项目的资料,如使用说明书等。

4、验收:等全部的货物都完成安装调试并培训后,进行统一验收,验收标准与招标文件要求一致,并提供相应所需的文件资料给用户。

5、设备到达现场后双方进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有外观质量、技术等问题,将按照投标要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

6、质保期:整机全保 3 年(含整机及所有零配件以及第三方产品等),按国家有关产品三包规定执行“三包”,保修期内免费上门维护,软件免费升级。


7、响应时限:在使用过程中出现故障,30 分钟内响应,4 小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过 24 小时修复,重大故障处理时限不超过 48 小时修复,其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

8、其他售后服务按厂家售后服务执行。

后附:厂家的《产品及质量承诺书》及《培训技术方案》

投标人(盖公章): 广东益升健康科技有限公司

2024 年 01 月 04 日



产品及服务质量承诺

本公司提供的 POWER-420 系列高频手术器(包括附件 POWER420-NP 系列随弃式导电粘胶极板、YLDZ 一次性使用高频电刀笔、一次性水冷不沾电凝镊、电刀清洁片等)、AST-1 自动气压止血带、上、下肢关节康复器均已取得国家(或市级)药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册证》，其质量技术指标符合相关质量技术标准(详见注册证所示)。

本公司已通过了由 CMD 根据 ISO9001-2000 和 ISO13485-1996 标准的质量管理体系的认证。因此，我们提供的上述产品均按医疗器械质量管理体系标准相关条款、法律法规要求和企业产品技术标准在出厂前进行了严格检验，(有完整详细的产品调试、检测报告)。为了对用户负责，本公司对所提供的产品作出如下承诺：

- 一、 本公司生产的高频手术器、自动气压止血带、高频 LEEP 电刀及其附件的质量技术指标、产品质量责任、售后服务均由本公司负责。
- 二、 对 POWER420-NP 系列随弃式导电粘胶极板、YLDZ 一次性使用高频电刀笔、一次性水冷不沾电凝镊、电刀清洁片等耗材产品，用户在使用过程中如发现产品质量问题，我公司负责退换。
- 三、 本公司承诺对使用本公司一次性产品的用户确保有充足的货源(公司确保有一定数量产品的库存周转量)，满足用户需要。
- 四、 本公司对所提供产品的主机保修 3 年(含整机及所有零配件以及第三方产品等)，保修期内维修保养，软件免费升级。并负责终身维护，每年定期回访维护 1-2 次。
- 五、 本公司保证用户设备使用质量可靠的原装零配件及其附件，备件库存足以保证设备的配件正常使用；对设备进行维护时，不收人工费，只按维修配件成本价收取合理费用。
- 六、 公司在接到用户投诉时，保证 1 小时内有明确答复，2 个工作日内有处理结果。公司为了更好的服务客户，在广西南宁设有办事处，有专职工程在职岗位，本公司在接到用户设备故障需维修要求后，30 分钟内响应，4 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 48 小时修复(48 小时未解决问题提供免费备用机使用)无法迅速解决的问题应在一周内解决。

常州市延陵电子设备有限公司



培训技术方案

装机和培训：

常州市延陵电子设备有限公司为最终售后服务单位，其指定办事处工程师在接到装机通知之日起5个工作日内(节假日除外)到达现场或远程以及电话进行免费装机及操作培训，直到该设备技术指标完全符合合同要求。


(1) 办事处工程师会在最短时间内与终端用户制定出装机时间与方案；通过技术服务和培训，使客户能熟练掌握设备的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容。保证每个操作人员能独立对设备进行操作和使用；

(2) 工程师会根据用户需求，制定培训计划和方案，免费对使用科室操作人员提供不少于3人3天的操作培训；对医学工程技术人员提供不少于3人3天的维修技术培训；免费提供操作和维修培训；

免费提供软件升级；

培训内容：设备的构造、基本原理、安装、调试、检测、操作、一般保养、维护及易损件更换、设备升级、常见故障检测、日常保养和使用注意事项排除故障、安全有效的使用设备等知识。

常州市延陵电子设备有限公司




附件 8:商务、技术要求响应表

3. 商务要求偏离表

所投分标: 标项一 分标

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求,详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
▲一、质量保质期	▲按国家有关产品三包规定执行“三包”,质保期:整机全保≥3年(含整机及所有零配件以及第三方产品等),保修期内维修保养,软件免费升级。若厂家免费质保期超过此年限的,合同履行过程中按厂家规定执行。	▲按国家有关产品三包规定执行“三包”,质保期:整机全保3年(含整机及所有零配件以及第三方产品等),保修期内维修保养,软件免费升级。若厂家免费质保期超过此年限的,合同履行过程中按厂家规定执行。	无偏离
▲二、售后服务要求	▲(1)按国家有关规定实行产品“三包”;	▲(1)按国家有关规定实行产品“三包”;	无偏离
	▲(2)负责免费送货上门,负责免费安装、调试合格。	▲(2)负责免费送货上门,负责免费安装、调试合格。	无偏离
	▲(3)免费提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备的各种功能,终身提供免费技术支持。	▲(3)免费提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备的各种功能,终身提供免费技术支持。	无偏离
	▲(4)质保期内免费上门维护,提供免费保修电话,提供400或其它专线免费保修电话号码。	▲(4)质保期内免费上门维护,提供免费保修电话,提供400或其它专线免费保修电话号码。	无偏离
	▲(5)在使用过程中出现故障,30分钟内响应,4小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复,重大故障处理时限不超过48小时修复,其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。	▲(5)在使用过程中出现故障,30分钟内响应,4小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复,重大故障处理时限不超过48小时修复,其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。	无偏离
	▲(6)备件供应:国内有备件仓库。	▲(6)备件供应:国内有备件仓库。	无偏离
	▲(7)维修工程师:有专职维修工程师。	▲(7)维修工程师:有专职维修工程师。	无偏离
	▲(8)定期回访。	▲(8)定期回访。	无偏离
	▲(9)设备自带软件的在免费保修期内免费升级;	▲(9)设备自带软件的在免费保修期内免费升级;	无偏离
	▲(10)其余按投标人承诺进行。	▲(10)其余按投标人承诺进行。	无偏离



▲三、交货时间	▲自合同签订之后,接甲方通知之日起 60 个日历日内完成供货、安装、调试,验收合格并投入使用。	▲自合同签订之后,接甲方通知之日起 60 个日历日内完成供货、安装、调试,验收合格并投入使用。	无偏离
▲四、交货地点	▲桂林医学院附属医院(采购人指定地点)。	▲桂林医学院附属医院(采购人指定地点)。	无偏离
▲五、签订合同日期	▲自中标通知书发出之日起 25 天内。	▲自中标通知书发出之日起 25 天内。	无偏离
▲六、付款条件	▲1、接甲方供货通知后,在交货期限内将货物送到甲方指定地点;	▲1、接甲方供货通知后,在交货期限内将货物送到甲方指定地点;	无偏离
	▲2、货物安装调试完成,验收合格后,中标供应商开具全额税务发票,采购人在验收合格并无故障运行,走院内付款流程后转账支付合同款的 95% (无息),可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的 5%待履行完合同约定的权利义务事项后【中标供应商承诺质保期(免费保修、维护、升级期)满 1 年】且不存在争议的,三个月内转账支付(无息)。采购人付款前,中标供应商未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的,采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。	▲2、货物安装调试完成,验收合格后,中标供应商开具全额税务发票,采购人在验收合格并无故障运行,走院内付款流程后转账支付合同款的 95%(无息),可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的 5%待履行完合同约定的权利义务事项后【中标供应商承诺质保期(免费保修、维护、升级期)满 1 年】且不存在争议的,三个月内转账支付(无息)。采购人付款前,中标供应商未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的,采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。	无偏离
其他	▲1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第 4 号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章。	▲1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第 4 号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章。	无偏离
	▲2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号(注:如为定制、非标产品填无或描述清楚),如不填写视为不满足。	▲2、投标人在投标文件中已明确提供投标产品的品牌和型号	无偏离

注:1.表格内容均需按要求填写并盖章,否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时,投标文件承诺不得直接复制招标文件需求,投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。


3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”的条款,也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

法定代表人或者委托代理人

投标人盖章: 广东康自健康科技股份有限公司


日期: 2024 年 01 月 04 日

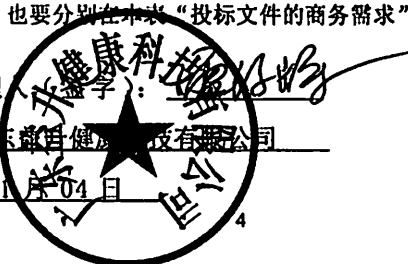

2. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数及性能配置要求填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。



招标文件 货物参数		投标响应	偏离说明
1	高频电刀	数量及单位：26 台	无偏离
	1、功能齐全，单、双极具备，使用范围广，从小儿手术、精细手术以至于大型手术，低电压特性尤其适合宫腔、腹腔镜及电切汽化镜手术；	1、功能齐全，单、双极具备，使用范围广，从小儿手术、精细手术以至于大型手术，低电压特性尤其适合宫腔、腹腔镜及电切汽化镜手术；	无偏离
	2、采用实时阻抗响应技术，使用较小的纯切功率即可满足汽化电切手术要求。使用较小的混切功率设定即可满足普通手术；	2、采用实时阻抗响应技术，使用较小的纯切功率即可满足汽化电切手术要求。使用较小的混切功率设定即可满足普通手术；	无偏离
	3、电凝具备多种不同的输出，可在前列腺汽化电切及肿瘤手术时提供喷凝功能。满足临床的各种需求；	3、电凝具备多种不同的输出，可在前列腺汽化电切及肿瘤手术时提供喷凝功能。满足临床的各种需求；	无偏离
	4、单极即可手控，也可脚控输出。输出端口采用机械连锁装置，有效防止手术中的误操作。手术过程中不必进行单、双极模式转换；	4、单极即可手控，也可脚控输出。输出端口采用机械连锁装置，有效防止手术中的误操作。手术过程中不必进行单、双极模式转换；	无偏离
	5、双刀笔输出控制技术，可分别进行单极电切操作；可同时进行单极电凝操作；	5、双刀笔输出控制技术，可分别进行单极电切操作；可同时进行单极电凝操作；	无偏离

1	高频电刀	▲6、可兼容目前国内的常用一次性耗材，如电刀笔、负极板等。	▲6、可兼容目前国内的常用一次性耗材，如电刀笔、负极板等。	无偏离(投标文件74-76)
		7、留可配”氩气流量仪“的端口，可配氩气流量仪，可升级为氩气刀，适用于消化内科和肝胆外科手术；	7、留可配”氩气流量仪“的端口，可配氩气流量仪，可升级为氩气刀，适用于消化内科和肝胆外科手术；	无偏离

注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。


3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

法定代表人或者委托代理人签字

投标人（盖公章）：广东益升健康科技有限公司

日期：2024年01月04日

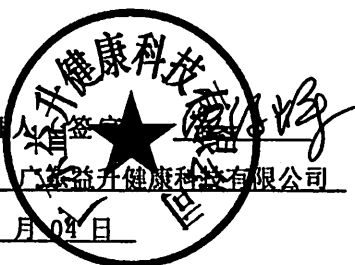

附件 9:医疗器械注册证及附件



6. 除招标文件规定必须提供以外,投标人认为需要提供的其他证明材料(投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料)。

6.1 产品医疗器械注册证

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号: 国械注准20153011796

注册人名称	常州市延陵电子设备有限公司
注册人住所	江苏武进经济开发区稻香路23号
生产地址	常州市郑陆和平工业园区恒安路
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	高频电刀
型号、规格	POWER-420FX、POWER-420F、POWER-420FC、POWER-420FB
结构及组成	该产品由高频主机、脚控电刀笔YL99FX、双极镊子FC01、中性电极VLSP、极板夹头LI01、脚踏开关(YLFS-01双脚踏开关、YLFS-02单脚踏开关)组成。
适用范围	该产品适用于对生物组织进行电切、电凝或两者兼用的手术中。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号为: 国械注准20153251796



审批部门: 国家药品监督管理局

批准日期: 二〇一〇年二月二十七日



有效期至: 二〇二五年二月二十七日



中华人民共和国


医疗器械注册变更文件

注册证编号：国械注准20153011796

产品名称	高频电刀
变更内容	 “生产地址：常州市郑陆和平工业园区恒安路”变更为“生产地址：常州市郑陆和平工业园区恒安路；天宁区团结路11号内1号楼一层、二层、五层，2号楼五层，3号楼四层、五层”。
备注	按新《分类目录》，该产品分类编码为01，管理类别为第三类。 本文件与“国械注准20153011796”注册证共同使用。 

注册证编号：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二一年十一月十九日





7.5 耗材的注册证，如电刀笔、负极板等

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：苏械注准 20152010472


注册人名称	常州市延陵电子设备有限公司
注册人住所	江苏武进经济开发区稻香路 23 号
生产地址	常州市郑陆和平工业园区恒安路
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	一次性使用高频电刀笔
型号、规格	YLDB-01-38、YLDB-01-60、YLDB-01-65、YLDB-01-80、YLDB-02-38、YLDB-02-60、YLDB-02-65、YLDB-02-90、YLDB-02-85、YLDB-02-100、YLDB-02-130、YLDB-03-38、YLDB-03-60、YLDB-03-65、YLDB-03-80、YLDB-03-85、YLDB-03-100、YLDB-03-130、YLDB-04-68、YLDB-04-98、YLDB-05-38、YLDB-05-60、YLDB-05-65、YLDB-05-80、YLDB-05-85、YLDB-05-100、YLDB-05-130、YLDB-06-38、YLDB-06-60、YLDB-06-65、YLDB-06-80
结构及组成	脚控电刀笔由刀头、刀柄外壳、电极电缆、一芯插头组成；手控电刀笔由刀头、刀柄外壳、手控按钮、电极电缆、三芯插头组成；吸刮手控电刀笔由刀头、推管、刀柄外壳、手控按钮、推移滑板、电极电缆、三芯插头以及吸引导管组成；分体式手控电刀笔由刀头、刀柄外壳、手控按钮组成；分体式脚控电刀笔由刀头、刀柄外壳组成。其中分体式手控电刀笔和分体式脚控电刀笔实际使用时必须与相应的分体式电缆组件配合使用，分体式手控刀笔电缆组件由三芯插头、电极电缆、刀笔插头三部分组成；分体式脚控刀笔电缆组件由一芯插头、电极电缆、刀笔插头三部分组成。
适用范围	与高频手术器（高频电刀）配套使用，用于普外科、骨科、心脏科、妇科、泌尿科、神经外科、皮肤科、腹腔科进行切割、凝血或两者兼用的手术。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	原医疗器械注册证编号：苏械注准 20152250472



审批部门：江苏省药品监督管理局

批准日期：2020 年 04 月 14 日

有效期至：2025 年 04 月 13 日



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：苏械注准 20172011401

注册人名称	常州市延陵电子设备有限公司
注册人住所	江苏武进经济开发区
生产地址	常州市郑陆和平工业园区恒安路、天宁区团结路 11 号内 1 号楼一层、五层，2 号楼五层，3 号楼四层、五层
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	随弃式导电粘胶极板
型号、规格	POWER420-NP1s、POWER420-NP1d、POWER420-NP2s、POWER420-NP3s、 POWER420-NP3d、POWER420-NP4s、POWER420-NP5s、POWER420-NP5d、 POWER420-NP1Cs、POWER420-NP1Cd、POWER420-NP3Cs、POWER420-NP3Cd
结构及组成	离子型极板由离型材料、压敏胶、铝箔、极板基衬四部分组成；离子型带连线极板由离型材料、压敏胶、铝箔、极板基衬、极板电缆五部分组成；电容型极板由压敏胶、铝箔、极板基衬三部分组成。
适用范围	在外科手术中与高频电刀配用；也可与射频仪配用。
附件	产品技术要求
其他内容	
	原注册证号：苏械注准 20172251401



江苏省药品监督管理局

批准日期：2022 年 04 月 22 日

生效日期：2022 年 07 月 21 日

有效期至：2027 年 07 月 20 日

6.2 厂家及代理商授权书和供货证明

授权委托书

编号: 2023 委 2533 号

常州市延陵电子设备有限公司是医用高频电刀（包括附件：随弃式导电粘胶极板、一次性使用高频电刀笔、一次性使用水冷不沾电凝镊、一次性使用双极电凝镊、一次性电刀清洁片、一次性使用组织闭合器械、双极镊子）、一次性使用组织闭合器械、妇科利普刀、骨科全自动气压止血带及上、下肢关节康复器等医疗器械的专业生产经营企业。

为了进一步拓展销售市场、竭诚为顾客服务以取得良好的社会效益和经济效益，今决定有且唯一授权桂林谨德医疗器械有限责任公司用高频电刀参加桂林医学院附属医院，项目名称：医疗设备采购项目（高频电刀、病人保温系统），项目编号：GXZG2023-G1-004645-GSZX的投标及相关销售、售后服务事宜。

特此授权！

有效期限为 2023 年 12 月 15 日至本次招标结束



常州市延陵电子设备有限公司

签字:

盖章:

2023 年 12 月 15 日



产品授权书

致：桂林医学院附属医院/广西桂水工程咨询有限公司

桂林谨德医疗器械有限责任公司作为常州市延陵高频电刀的代理商，在此授权广东益升健康科技有限公司用高频电刀参加桂林医学院附属医院，项目名称：医疗设备采购项目（高频电刀、病人保温系统）递交投标文件，且广东益升健康科技有限公司以其自己的名义处理后续的商业谈判和签署合同并独立承担责任。

本授权的有效期 2023 年 12 月 22 日至本次招标结束




桂林谨德医疗器械有限责任公司



厂家供货证明

致：桂林医学院附属医院


兹证明：常州市延陵电子设备有限公司授权桂林谨德医疗器械有限责任公司提供予贵单位在桂林医学院附属医院，项目名称：医疗设备采购项目（高频电刀、病人保温系统）、项目编号：GXZC2023-G1-004645-GSZX的高频电刀产品为原装的、全新的，未经开箱的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，并享受原厂商产品质量保证及技术服务。我司保证自签订合同之日起，7个工作日内向贵公司提供生产日期不超6个月的高频电刀，同时货源充足，能满足项目所需。



常州市延陵电子设备有限公司

盖章：

2023年12月15日





编号: S0612021035986G(1-1)
统一社会信用代码
91440101MA9X0G9M41

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东益升健康科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 贾绍辉
注册资本 肆仟伍佰万元(人民币)
成立日期 2021年03月15日
住所 广州市天河区黄埔大道西128号1912房

经营范围 科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)




登记机关

2023 年 06 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



医疗器械经营许可证

许可证编号：粤穗药监械经营许20231070号
 企业名称：广东益升健康科技有限公司
 住所：广州市天河区黄埔大道西128号1912房
 经营场所：广州市天河区黄埔大道西128号1912房
 库房地址：广州市天河区黄埔大道西128号1912房

统一社会信用代码：91440101MA9X0G9M41
 法定代表人：贾绍辉
 企业负责人：贾绍辉
 经营方式：批发

经营范围：
 2002年分类目录：6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6820, 6821, 6822 (角膜接触镜及其护理用液除外), 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840 (体外诊断试剂除外), 6841, 6845, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6865, 6866, 6870**
 2017年分类目录：01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16 (角膜接触镜及其护理液除外), 17, 18, 20, 21, 22**

许可期限：自 2023 年 08 月 07 日 至 2028 年 08 月 06 日
 发证部门：广州市市场监督管理局
 发证日期：2023 年 08 月 07 日



第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号： 粤穗药监械经营备20235470号

企业名称	广东益升健康科技有限公司
统一社会信用代码	91440101MA9X0G9M41
法定代表人	贾绍辉
企业负责人	贾绍辉
住 所	广州市天河区黄埔大道西128号1912房
经营方式	批发
经营场所	广州市天河区黄埔大道西128号1912房
库房地址	广州市天河区黄埔大道西128号1912房
经营范围	2002年分类目录： 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840（体外诊断试剂除外）， 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877** 2017年分类目录： 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22**

备案部门（公章）：

备案日期：



附件 12:中标通知书

中标(成交)通知书

广东益升健康科技有限公司:

经评定,编号为GXZC2023-G1-004645-GSZX采购文件中的医疗设备采购项目(高频电刀、病人保温系统)-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为1989000元。

自此通知书发出之日起25天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:蒋欢欢

电话:0773-2802050

代理机构联系人:韦柳利

电话:0771-5501160

邮箱:403219686@qq.com



医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

(含设备、耗材、后勤物资、基建工程、行业服务等)

甲方（医疗卫生机构）：桂林医学院附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：广东益升健康科技有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材试剂等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定贾绍辉 13312817861 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，如甲乙双方合同条款内容不一致者，以在甲方存档者为正本。

甲方（盖章）：桂林医学院附属医院

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

签订日期：2024年 / 月 / 日



乙方（盖章）：广东益升健康科技有限公司

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

签订日期：2024年 / 月 / 日

