

疏附县人民医院手麻科设备采购需求



一、项目基本情况介绍

结合我院实际发展需求，现需采购手麻科设备一批，预算金额 25 万元。

二、货物需求及技术需求

1. 采购内容：采购自体血回输机等设备一批。

备注：具体数量及技术参数详见参数需求(以上产品技术参数为参照或相当于需求最低配置要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各潜在投标人可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代)

三、项目要求

1. 供应商资质要求：应提供以下资质证件的原件或同等法律效力的证明文件。

(1) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(2) 投标人必须具有与本项目采购货物相应的必须提供《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》原件；

2. 提供近两年同类型业绩证明（合同或中标通知书）；

3. 投标人报价时需按明细提供物品的品名、规格、参数、厂家、产地、数量、单价、总价及交货日期制作报价单；

4. 提供售后服务承诺书；

5. 提供技术偏离表；

6. 产品彩页；

四、供货要求

1. 合同签订后 5 日内完成供货、组装、调试、培训并交付验收合格。除双方对推迟工期书面达成一致外，2 日内安装调试完毕。（采购需求内特殊要求供货时间，需按照采购要求供货）

2. 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3. 中标人必须保证货物的来源合法，中标人供货时原件或原厂供货确认函，在货物验收的同时必须提供生产合格证书和商检证明，并提供成交货物齐全资料。

4. 所有费用（运输保险费、安装调试费、培训费、检测费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等）均含在报价单中。

五、质保及售后

1. 质保期：三年

2. 中标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，所有设备按照厂家规定的产品包装，附使用说明、合格证、随机标准附件。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求、相关行业管理规定。

3. 从验收合格之日起三年内，采购人所购设备各部件发生非人为故障，投标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，费用包含在本项目的投标报价内。

4. 采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在 4 小时内派员上门现场维护，并在 24 小时内解决问题，

在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于原档次的零部件给采购人代用，在投标文件中提交书面承诺函。

5. 保修期间，非易损件一个月内连续 2 次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件，在投标文件中提交书面承诺函。

6. 质保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。

六、付款方式

1、具体付款方式已最终合同签订为准。


七、诚信履约

1. 投标报价比本项目最高限价低 25%（含 25%）以上，评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。




设备采购参数清单


序号	产品名称	数量	单位 (台/套)	技术参数及要求
1	自体血回输机	1	台	<p>1. ≥四种操作模式：自动模式、手动模式、紧急模式、应急模式可相互转换</p> <p>2. 界面显示：≥7英寸大屏幕液晶显示屏，图文数据显示</p> <p>3. 操作方式：一体化智能显示终端，多种功能性触键，反应迅速灵敏，触摸屏操作，中文操作界面</p> <p>4. 三个蠕动泵设计结构，分别为进血泵、清洗泵、清空泵</p> <p>5. 全血回收的三泵自体血液回收机控制系统，并提供相关证书证明</p> <p>6. 内置常见故障排除系统</p> <p>7. 自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期</p> <p>8. 紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输</p> <p>9. 断电保护功能</p> <p>10. 数据存储功能，可将离心机转速、三个蠕动泵转速、总进血量、总清洗量、总回收血量、报警开关状态等参数进行记忆</p> <p>11. 打印输出功能，设备内置打印机可将总进血量、总清洗量、总回收血量等手术信息打印留存</p> <p>12. 防红细胞流失调节功能</p> <p>13. 红细胞回收率：≥90%</p> <p>14. 回收后血球压积：≥65%</p>

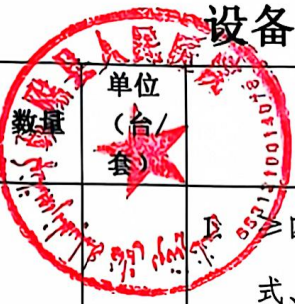


			<ol style="list-style-type: none"> 15. 肝素清洗率：≥98% 16. 离心机转速最高≥5650 转/分，分级可调 17. 蠕动泵流量：50-1000ml/分 18. 血液成分分离功能 19. 全血回输功能 20. 气泡检测功能 21. 红细胞血层检测功能 22. 自动启动进血功能（有上称重传感器自动启动系统） 23. 离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护 24. 血液洗净度检测功能 25. 离心井盖锁检测功能 26. 一次性使用血液回收耗材（分离杯、连接管路、血袋、废液袋、贮血器、双管）10 套 27. 过床器 8 套 28. 深部拉钩 300×38，S 形，板式 6 个 29. 子宫颈钳 250 ， 2×3 齿，侧弯 6 个 30. 海绵钳 250×10，弯有齿 6 个 31. 会阴剪 180，侧弯 6 个 32. 精细剪 120，直，尖头 4 个 33. 精细剪 120，弯，尖头 4 个 34. 眼科镊，100×0.6，直，有钩 4 个 35. 止血钳，125，弯蚊，全齿，精细 4 个 36. 持针钳，125，直，精细 4 个 37. 手术刀柄，200，3#，3 个
--	--	--	---

			 <p>38. 鼻骨膜剥离器, 200×4.5×4.5, 双头, 弯 1 个 39. 鼻骨膜剥离器, 170×4.2, 弯, 单头 1 个 40. 鼻骨膜剥离器, 180×5×5, 双头, 弯 1 个 41. 吸球 30 个 42. 胎心探头 5 个 (需与现有机型匹配: 理邦 F6Express) 43. 新生儿婴幼儿呼吸机可重复消毒管路 1 套 (需与现有机型匹配: 菲萍 FABIAN HFO) 44. 轮椅 10 个 (承重≥100KG; 铝合金)</p>
	对接车	5 辆	<p>1. 床面板采用 ABS 材料一次注塑成型, 床面有透气孔, 前后有四个弧形推手洞; 担架两边安装有 ABS 注塑成型的活动护栏</p> <p>2. 底座为钢结构, 金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术: 环氧树脂保护膜+树脂粉末涂层</p> <p>3. 漆粉采用优质漆粉, 厚度均达≥75 μm, 防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀</p> <p>4. 摇杆系统: 采用进口高强度 45#钢。极限保护螺杆: 传动力度≥190kg</p> <p>5. 脚轮 6 寸双面中控脚轮, 内置全封闭自润滑轴承; 中控刹车系统具有两侧刹车开关功能, 颜色红绿区分, 刹车外部 4mm 厚钢制刹车装置</p> <p>6. 双页式 PP 护栏, 上下升降, 护栏转动柄上有暗开关, 控制上升下降, 下降收缩时平齐床面</p> <p>7. 床面旁对角有二个点滴架插孔</p> <p>8. 工字型加重底架, 中控制动, 前后对角中控制动</p>

			<p>刹车</p> <p>9. 头部床面下有氧气瓶固定座</p> <p>10. 两节式 PP 护栏 1 付、豪华脚轮、不锈钢输液架 1 支、床垫 1 张</p>
	喉镜		<p>1. 分体式（手柄和窥视片能分开）</p> <p>2. 麻醉咽喉镜由窥视片、手柄和光源组成</p> <p>3. 喉镜采用 LED 冷光源设计，光源手柄内置，光纤传导，配合高亮度 LED 灯泡（LED 灯泡照度不小于 8000 lx）</p> <p>4. 手柄接头与窥视片接头连接后的间隙$\leq 0.3\text{mm}$</p> <p>5. 标配：手柄 1 个、窥视片 3 个/套</p> <p>6. 手柄：</p> <p>6.1 H62 黄铜材质制造；滚花网纹设计</p> <p>6.2 内部电源</p> <p>6.3 中号手柄（单位：mm）150×30（H 高×L 长）</p> <p>6.4 小号手柄（单位：mm）145×20（H 高×L 长）</p> <p>6.5 防护等级：IPX2</p> <p>7. 光纤喉镜窥视片</p> <p>7.1 医用级 304 不锈钢</p> <p>7.2 可更换光纤导管设计，前端的光照强度$\geq 7001\text{x}$</p> <p>7.3 132℃ 高温高压进行≥ 3000 次消毒</p> <p>7.4 窥视片：00 号--儿童直（41×10.5×11mm）、0 号--儿童直（53×10.5×11mm）、1 号--儿童直（77×10.5×11mm）、1 号--儿童弯（67×33×9.5mm）2 号--少年（87×35×11.5mm）、3 号--成人（105×40</p>

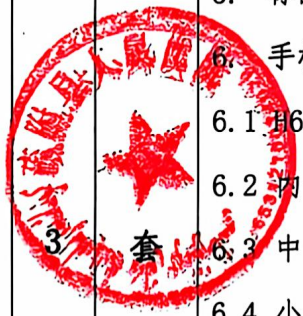

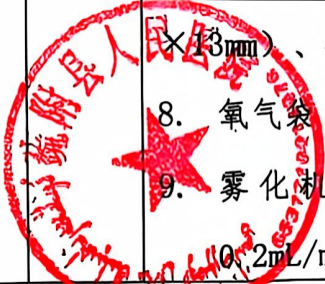			 <p>×13mm)、4号--成人+ (132×58×13.5mm)</p> <p>8. 氧气袋 30 个</p> <p>9. 雾化机 3 个 (噪音 ≤ 60dB; 最大雾化率 ≥ 0.2mL/min; 药液残留量 ≤ 1.0mL)</p>
--	--	--	--