



全自动微生物鉴定及药敏分析系统维修配件参数

一、设备外观

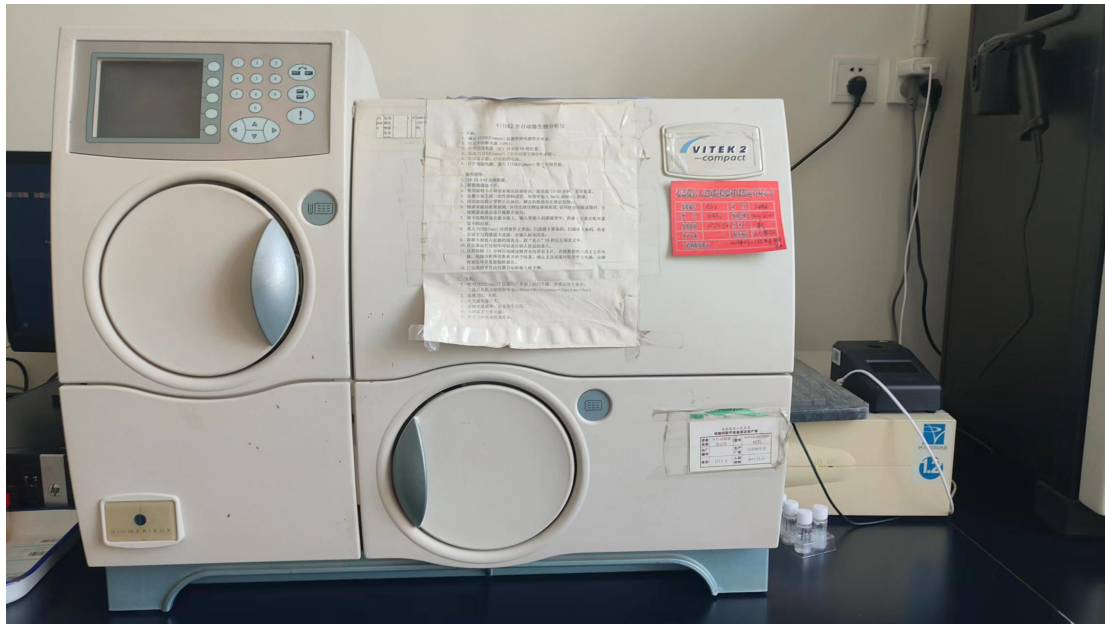

二、设备铭牌

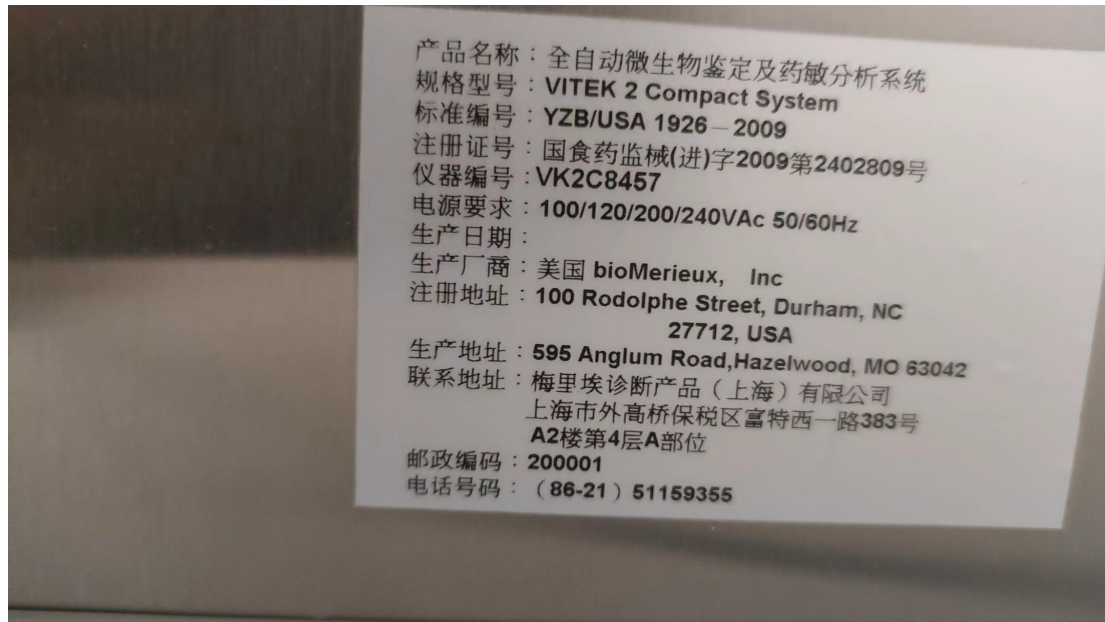


设备出厂编号：VK2C8457

设备生产日期：2010 年

三、设备显示屏及控制面板外观



四、控制面板主板外观

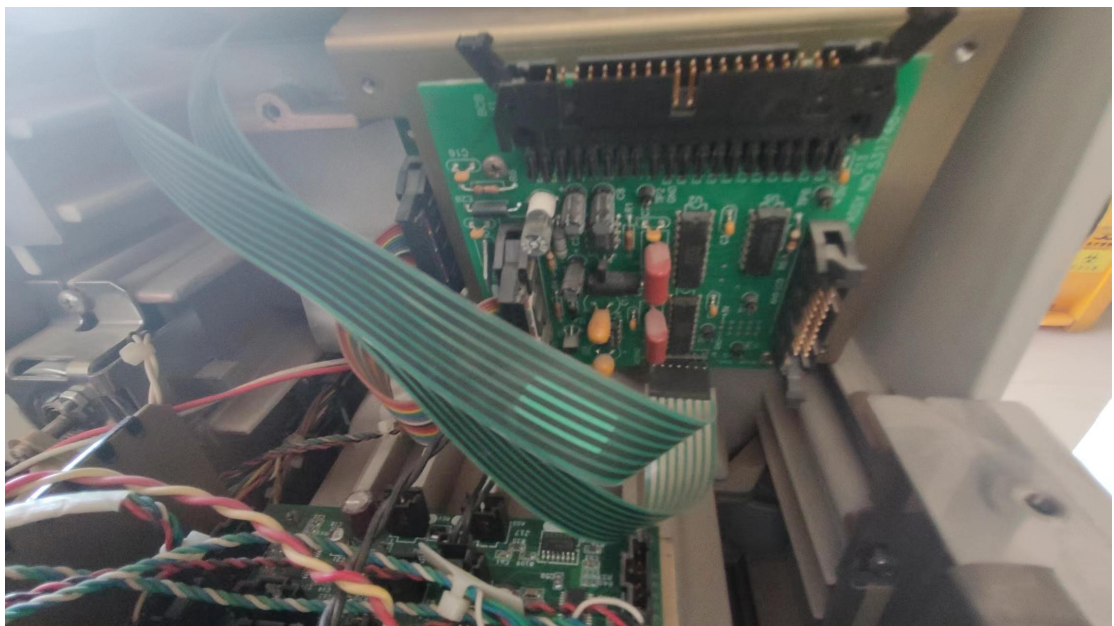

五、采购需求

- 1、显示屏 1 块；
- 2、控制面板 + 控制面板主板 1 块

六、售后要求

需工程师上门安装调试；更换的零配件提供 1 年质保服务。